

Pack de Histerectomía Radical HOSPITEN

Ref. 97095566



Características del Envasado:

- La caja externa de transporte es reforzada, resistente e incluye información sobre: denominación del producto, referencia comercial, código EAN, origen, número de lote y fecha de caducidad.
- La Bolsa Unitaria es plástico robusto con alta resistencia a las perforaciones, con sistema de apertura con pestaña de 15cm y Sistema de ventilación de OE (TIVEK®) en la parte superior del envase, que permite una adecuada aireación después de su esterilización.
- La Etiqueta Interna insertada en la bolsa unitaria es auto-adhesiva e incluye información sobre: denominación, composición, referencia comercial, código EAN, origen, método de esterilización, número de lote y fecha de caducidad.
- Cada etiqueta interna incluye Etiquetas Adhesivas con información sobre: código EAN, fecha de caducidad y número de lote.
- Método de esterilización: Óxido de Etileno. Único método que asegura la íntegra esterilización de dispositivos de diferentes masas y densidades.

*Las unidades por caja son orientativas y pueden servir como referencia pero se recomienda no utilizarla como unidad de pedido, será definitiva cuando se lleve a cabo la producción tras contrato.

Componentes	Unid.
Cubremeras Estándar 150x190cm, Absorc. 75x190cm	1
Toallas de manos 47x38cm	2
Bata Quirúrgica Universal Talla L	1
Toallas de manos 47x38cm	4
Bata Quirúrgica Universal Talla L	2
Funda de Cámara 18x250 cm, Punta Elástica	1
Cinta adhesiva 9x49cm	1
Apósito Post-quirúrgico 9x10cm Mepore	3
Bolsa de Plástico transp. 20cm, 30cm Ziplock	1
Hoja de bisturí nº10	1
Hoja de bisturí nº11	1
Bisturí Eléctrico 320cm con botones	1
Compresa gasa 10x10cm 17h 8p RX blanca 5pc	10
Compresa abd 45x45cm 17h 4p RX 5pc blanca	5
Sistema succión/irrigación - punta doble OD 5mm 33cm	1
Bandeja 28x25x5cm 3150ml Azul Polipropileno	1
Trocar punta dilatadora s/cuchilla 11mm/100mm Canula Transp.	1
Trocar punta dilatadora s/cuchilla 5mm/100mm Canula Transp.	1
Cánula trocar universal 5mm/100mm transp.	1
Trocar Hasson con balón 12mm/100mm	1
Toalla Secado de Campo 18x25cm blanca	4
Bolsa papel blanca 30x61x12.5cm	1
Paño envolvente 100x100cm verde	1
Tijera monopolar 5mm /33cm Metzenbaum	1
Fórceps sujec.recta trinq fenestr 5mm/33cm	1
Pinza agarre fenestrada c/control cremallera 5mm/33cm	1
Paño adhesivo 75x75cm	1
Sábana Laparoscopia 250/175/270x260cm, ab.adh.25x30cm y 13x24cm perianal, con bolsas laterales, zona de refuerzo y perneras	1

Unidades por caja*: 6

Más información en www.molnlycke.es

Mölnlycke Health Care, Avenida de la Vega 15, Edif. 3 - 3ª Planta, Alcobendas (Madrid). Tel: 91 484 13 20
Mölnlycke® es una marca, nombre y logotipo registrado globalmente por una o más empresas del grupo Mölnlycke Health Care. © 2017. Mölnlycke Health Care AB. Todos los derechos reservados.

Mölnlycke®




INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE



REFERENCIA	5200460-08
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Cubremesas Estandar 150x190cm, Absorc. 75x190cm
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	CUBREMESAS ESTANDAR 150X190CM
PROVEEDOR	Mölnlycke Health Care Klinipro
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
Nº DE FABRICANTE	5200460
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	I
PESO NETO	192
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO TESTADO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	15.9.2018



INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

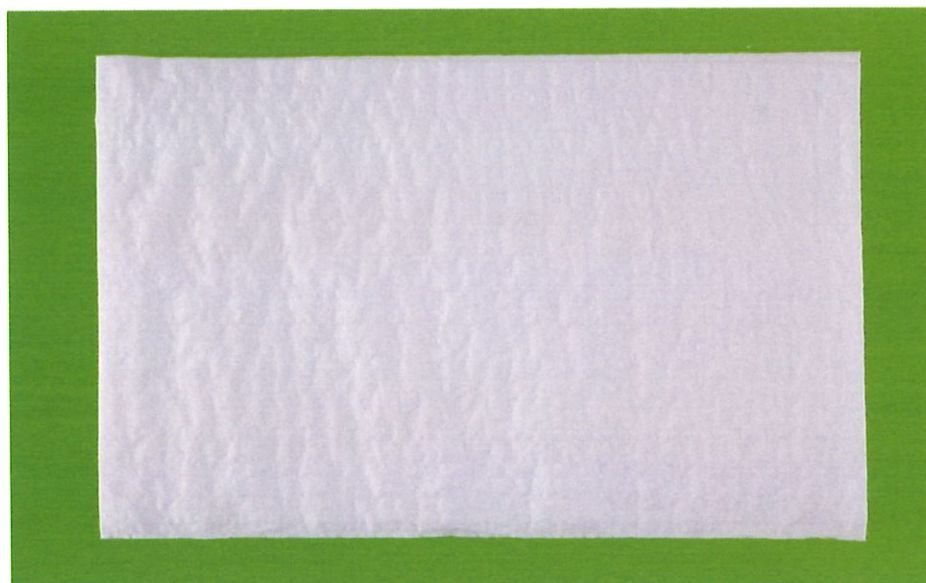

REFERENCIA	2308641-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Toallas de manos 47x38cm
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	TOALLAS DE MANOS 47x38CM
PROVEEDOR	IPS Converters Ltd.
FABRICANTE	IPS
Nº DE FABRICANTE	S003
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	I
PESO NETO	16,5
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	06.07.2017
ISO 13485	
ISO 9001	17.06.2018



INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE



REFERENCIA	63000621-01
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Bata Quirúrgica Universal Talla L
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	BATA QUIRURGICA UNIVERSAL L
PROVEEDOR	Copioumed International Inc.
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
Nº DE FABRICANTE	63000621
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	I
PESO NETO	123,107
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	DESCONOCIDO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	15.09.2018



INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE



REFERENCIA	2308641-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Toallas de manos 47x38cm
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	TOALLAS DE MANOS 47x38CM
PROVEEDOR	IPS Converters Ltd.
FABRICANTE	IPS
Nº DE FABRICANTE	S003
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	I
PESO NETO	16,5
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	06.07.2017
ISO 13485	
ISO 9001	17.06.2018




INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE



REFERENCIA	63000621-01
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Bata Quirúrgica Universal Talla L
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	BATA QUIRURGICA UNIVERSAL L
PROVEEDOR	Copioumed International Inc.
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
Nº DE FABRICANTE	63000621
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	I
PESO NETO	123,107
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	DESCONOCIDO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	15.09.2018

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

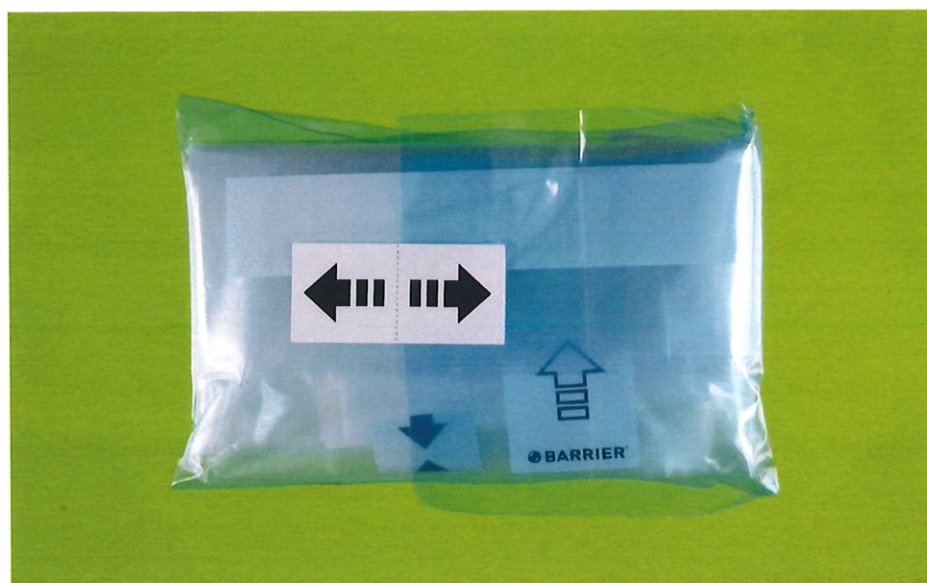

REFERENCIA	815333-14
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Funda de Cámara 18x250 cm, Punta Elástico
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	FUNDA DE CÁMARA 18X250 CM, PUNTA ELÁSTIC
PROVEEDOR	Mölnlycke Health Care (Thailand)
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
Nº DE FABRICANTE	815333
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	I
PESO NETO	46,5
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	DESCONOCIDO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	15.9.2018



INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE



REFERENCIA	911500-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Cinta adhesiva 9x49cm
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	CINTA ADHESIVA 9X49CM
PROVEEDOR	Mölnlycke Health Care Klinipro
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
Nº DE FABRICANTE	381035, 381045
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	I
PESO NETO	7,833
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO TESTADO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	15.9.2018



INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE



REFERENCIA	670900-14
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Apósito Post-quirúrgico 9x10cm Mepore
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	APÓSITO POST-QUIR. 9X10CM MEPORE
PROVEEDOR	Mölnlycke Health Care AB
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
Nº DE FABRICANTE	670900
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	Ila
PESO NETO	1,775
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	15.9.2018

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE




REFERENCIA	2300929-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Bolsa de Plástico transp. 20cm, 30cm Zip
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	BOLSA PLÁSTICO 20X30CM C/CIERRE ZIP
PROVEEDOR	TART, s.r.o.
FABRICANTE	TART, s.r.o.
Nº DE FABRICANTE	SÁČEK SE ZIPLOCKEM 20 X 30 CM
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	NON MEDICAL DEVICE
PESO NETO	1,1
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	DESCONOCIDO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	
ISO 9001	20.03.2020

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE




REFERENCIA	2300036-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Hoja de bisturí nº10
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	HOJA DE BISTURÍ N°10
PROVEEDOR	SWANN MORTON LTD
FABRICANTE	Swann Morton LTD
Nº DE FABRICANTE	201
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	Ila
PESO NETO	1
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO TESTADO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	20.09.2017
ISO 13485	28.02.2019
ISO 9001	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

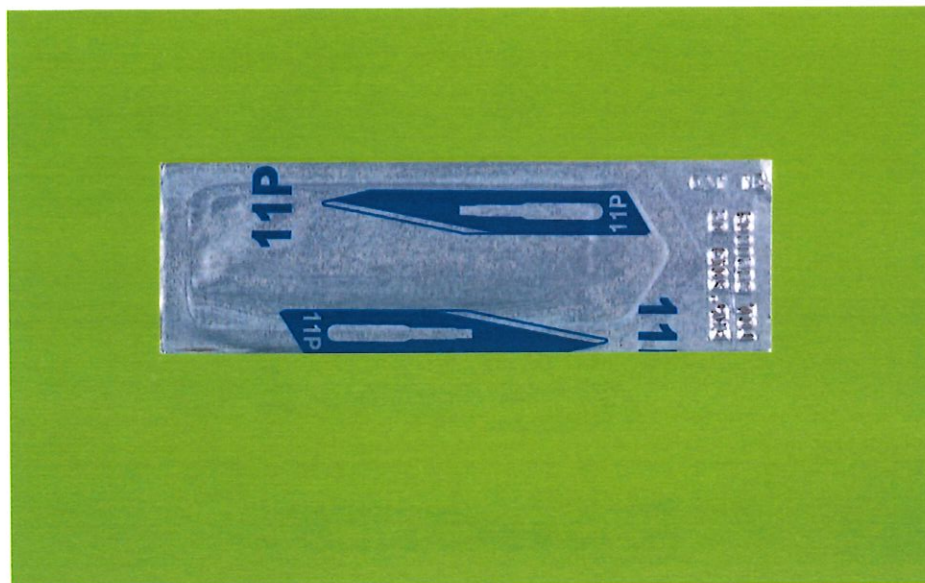

REFERENCIA	2301455-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Hoja de bisturi nº11
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	HOJA DE BISTURÍ N°11
PROVEEDOR	SWANN MORTON LTD
FABRICANTE	Swann Morton LTD
Nº DE FABRICANTE	291
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	Ila
PESO NETO	0,8
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO TESTADO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	20.09.2017
ISO 13485	28.02.2019
ISO 9001	


INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

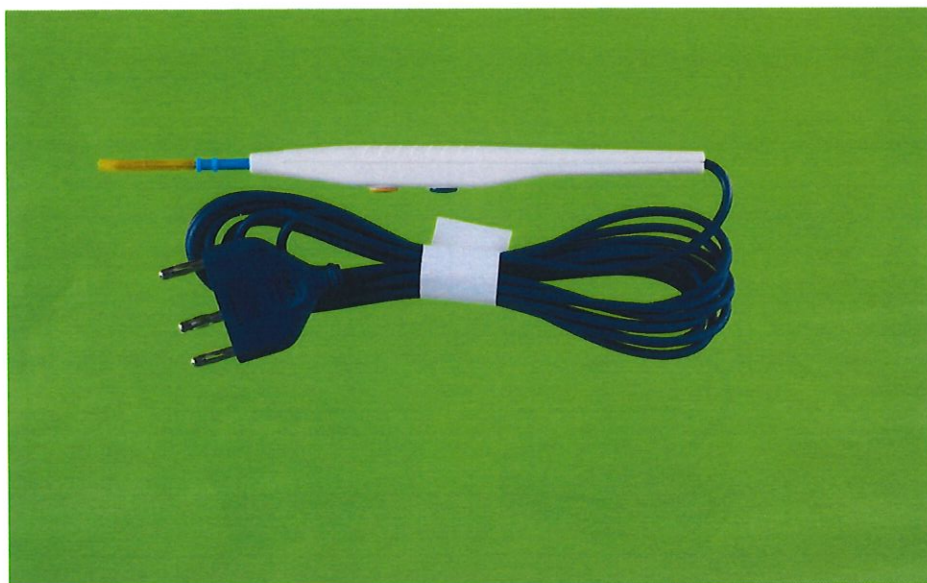

REFERENCIA	2302324-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Bisturí Eléctrico 320cm con botones
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	BISTURÍ ELÉCTRICO 320CM PUNTA PLANA
PROVEEDOR	FIAB SpA
FABRICANTE	Fiab SPA
Nº DE FABRICANTE	F4798B/BULK
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	IIb
PESO NETO	66,8
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	SI
FTALATOS	SI
PIROGÉNICO	NO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	SI
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	31.07.2018
ISO 9001	



INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

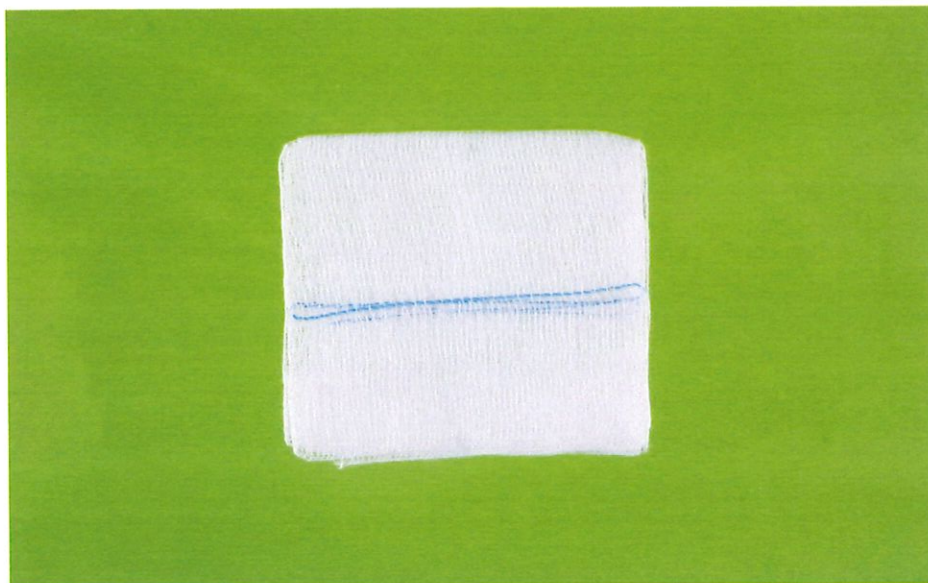

REFERENCIA	2313034-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Compresa gasa 10x10cm 17h 8p RX blanca
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	COMPRESA 10X10CM 8P XRD
PROVEEDOR	WINNER MEDICAL Co., Ltd. (CY)
FABRICANTE	Winner
Nº DE FABRICANTE	601-010502
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	Ila
PESO NETO	2
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	25.07.2017
ISO 13485	31.05.2020
ISO 9001	




INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE



REFERENCIA	2313039-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Compresa abd 45x45cm 17h 4p RX blanca
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	COMPRESA ABD 45X45CM 17H 4P RX
PROVEEDOR	WINNER MEDICAL Co., Ltd.
FABRICANTE	Winner
Nº DE FABRICANTE	601-010479
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	Ila
PESO NETO	19,4
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	25.07.2017
ISO 13485	31.05.2020
ISO 9001	




INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

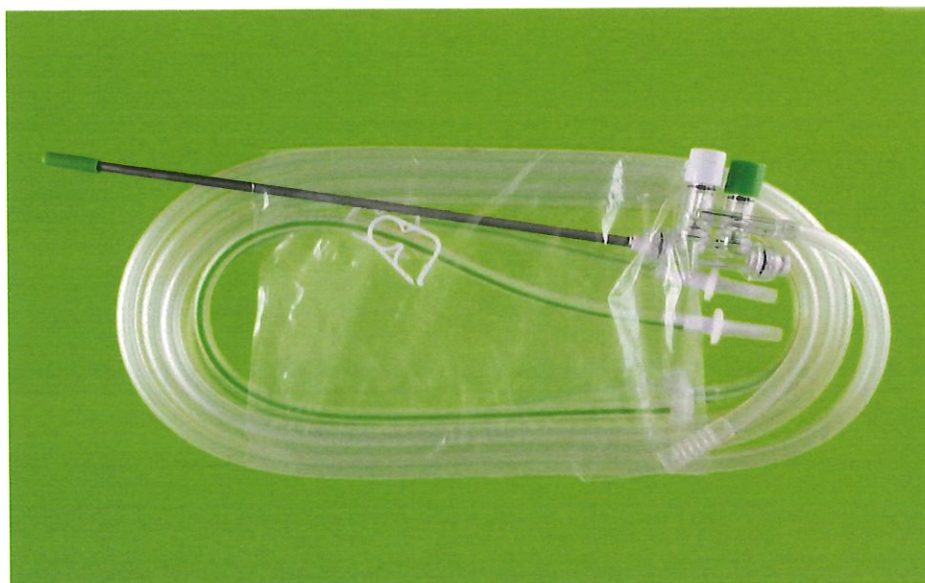


REFERENCIA	2319493-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Sistema succión/irrigación - punta doble OD 5mm 33cm
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	SIST.SUCCIÓN/IRRIG. P.DOBLE 5MM 33CM
PROVEEDOR	Unimax Medical System Inc.
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
Nº DE FABRICANTE	899107(FSI13305Z)
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	Ila
PESO NETO	470
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	SI
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO TESTADO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	SI
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

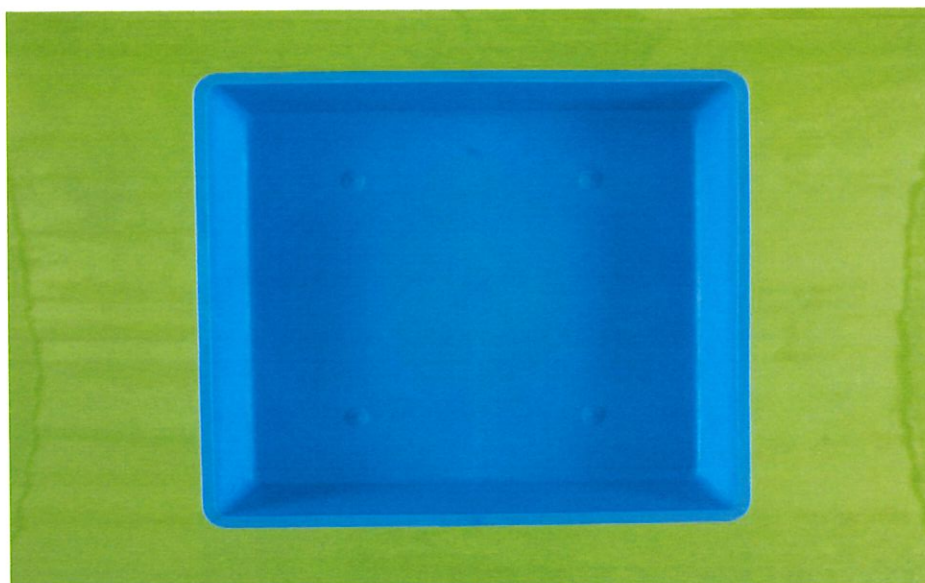

REFERENCIA	2314202-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Bandeja 28x25x5cm 3150ml Azul Polipropileno
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	BANDEJA 28X25X5CM 3150ML AZUL POLIPROPIL
PROVEEDOR	GRI-Alleset Limited B.V.
FABRICANTE	GRI Medical & Electronic Techn
Nº DE FABRICANTE	15-0911
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	I
PESO NETO	71,4
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO TESTADO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	ALLESET HEALTHCARE SOLUTIONS
ISO 13485	31.08.2020
ISO 9001	


INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

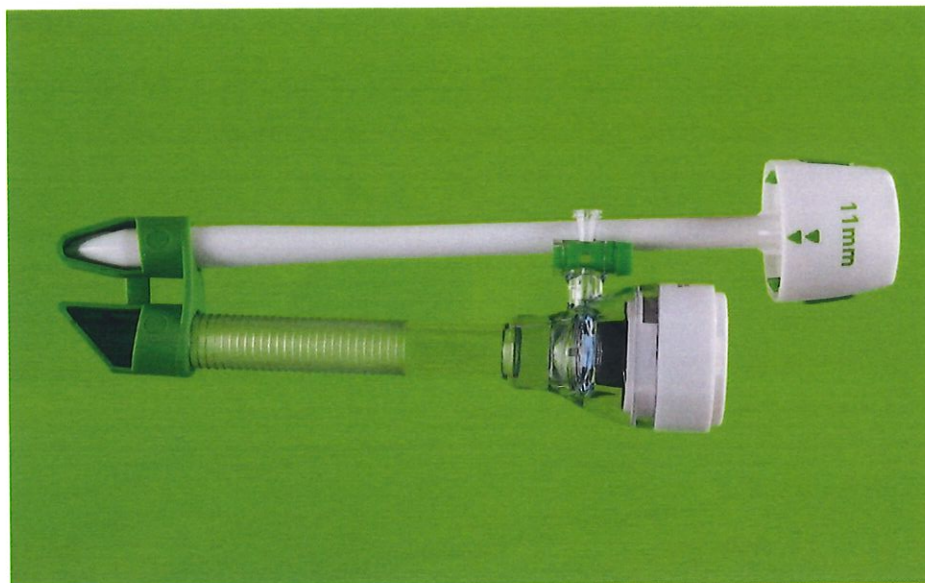

REFERENCIA	2319408-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Trocar punta dilatadora s/cuchilla 11mm/100mm Canula Transp.
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	TROCAR PUNTA DILAT. S/UCHILLA 11/100MM
PROVEEDOR	Unimax Medical System Inc.
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
N° DE FABRICANTE	899310(1PTD1010Z)
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	Ila
PESO NETO	75,1
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO TESTADO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	SI
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	




INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

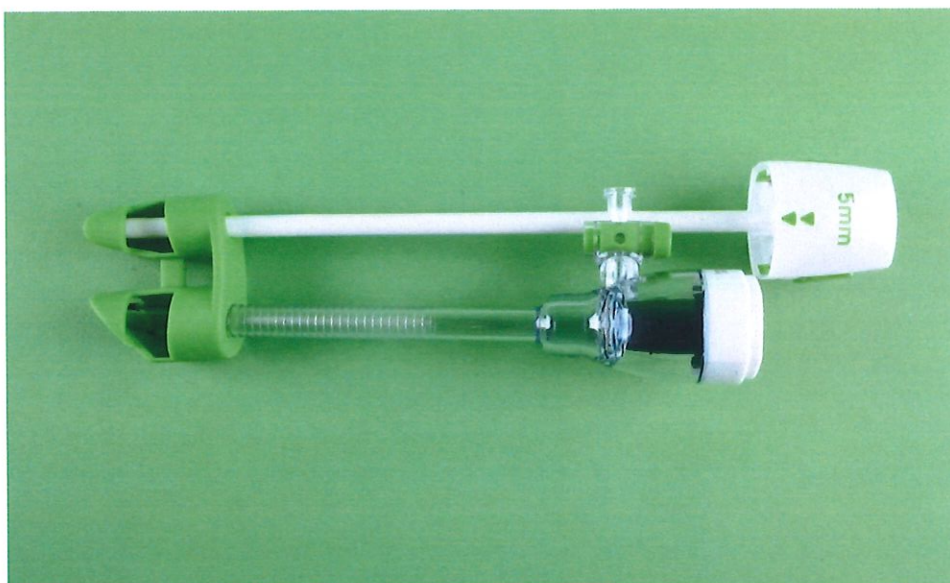

REFERENCIA	2319426-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Trocar punta dilatadora s/cuchilla 5mm/100mm Canula Transp.
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	TROCAR PUNTA DILAT.S/CUCHILLA 5MM/100MM
PROVEEDOR	Unimax Medical System Inc.
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
Nº DE FABRICANTE	899309(1PTD0510Z)
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	Ila
PESO NETO	39,6
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO TESTADO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	SI
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	



INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

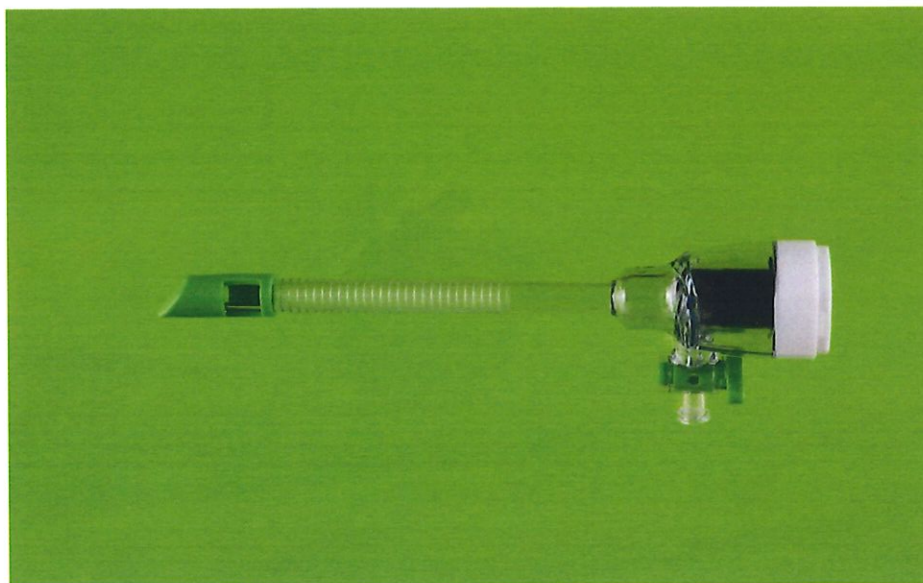

REFERENCIA	2319465-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Cánula trocar universal 5mm/100mm transp
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	CÁNULA TROCAR UNIVERSAL 5MM/100MM
PROVEEDOR	Unimax Medical System Inc.
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
Nº DE FABRICANTE	899321(1TCD0510Z)
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	Ila
PESO NETO	20
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO TESTADO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	




INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE



REFERENCIA	2321466-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Trocar Hasson con balón 12mm/100mm
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	TROCAR HASSON CON BALÓN 12MM/100MM
PROVEEDOR	Unimax Medical System Inc.
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
Nº DE FABRICANTE	1BT71210Z
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	Ila
PESO NETO	111,3
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	SI
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	SI
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	SI
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	15.09.2018


INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

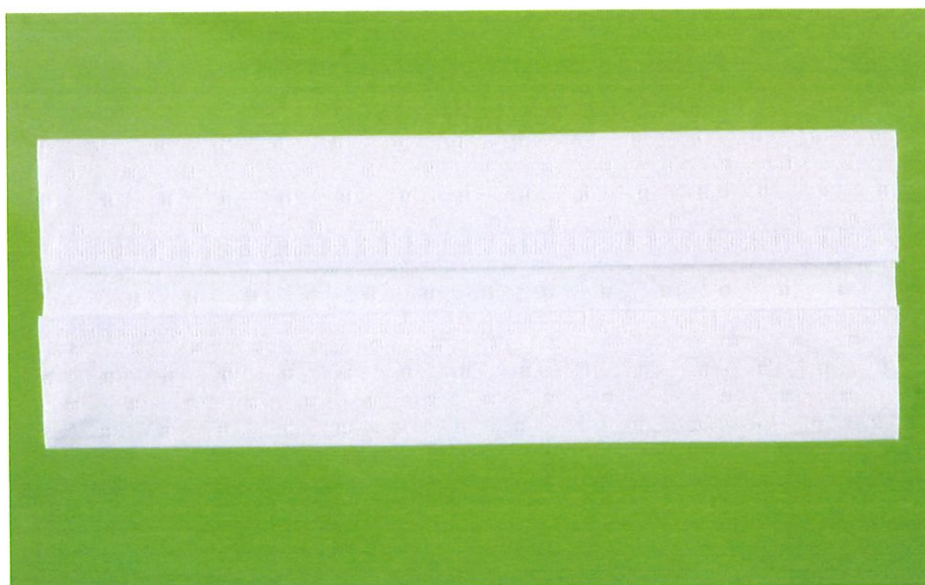

REFERENCIA	26153-20
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Toalla Secado de Campo 18x25cm blanca
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	TOALLA SECADO DE CAMPO 18X25CM BLANCA
PROVEEDOR	Finess Hygiene AB
FABRICANTE	Finess Hygiene
Nº DE FABRICANTE	71359
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	I
PESO NETO	5,4
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LÁTEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	DESCONOCIDO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	22.08.2017
ISO 13485	07.08.2017
ISO 9001	31.12.2017




INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

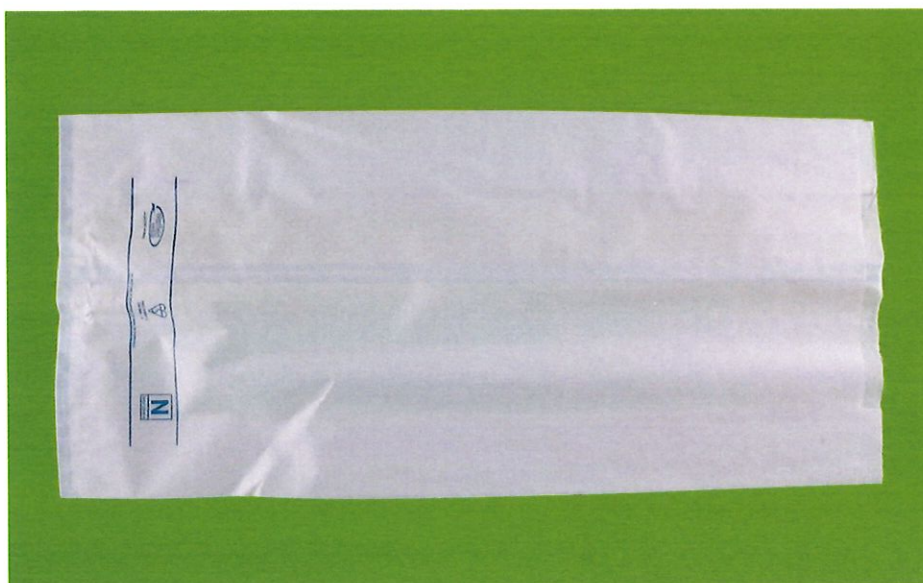

REFERENCIA	2305516-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Bolsa papel blanca 30x61x12.5cm
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	BOLSA PAPEL BLANCA 30X61X12.5CM
PROVEEDOR	Westfield Medical Ltd
FABRICANTE	Westfield Medical Ltd
Nº DE FABRICANTE	NPC
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	I
PESO NETO	32,3
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	20.11.2017
ISO 13485	13.01.2019
ISO 9001	20.07.2018


INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

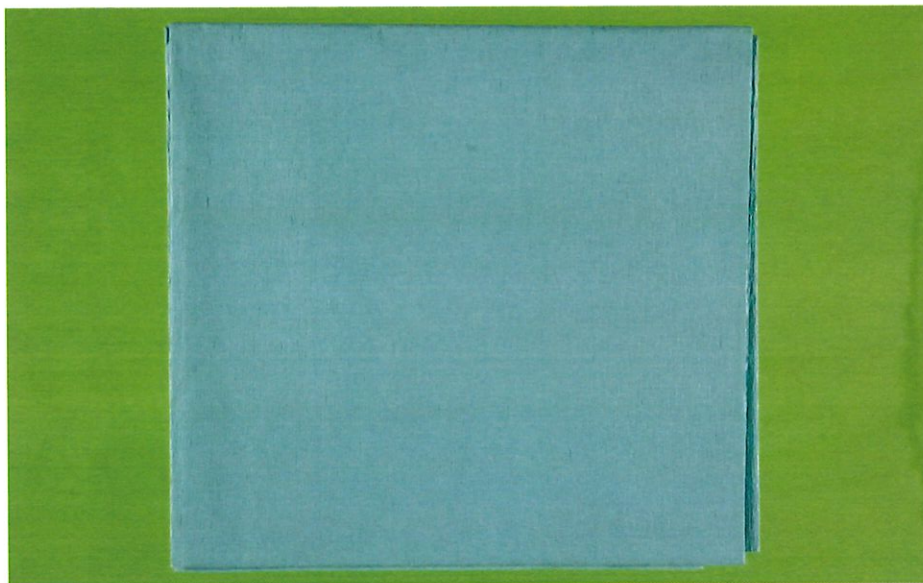

REFERENCIA	2313944-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Paño envolvente 100x100cm verde
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	PAÑO ENVOLVENTE 100X100CM VERDE
PROVEEDOR	Westfield Medical Ltd
FABRICANTE	Westfield Medical Ltd
Nº DE FABRICANTE	SDG1010
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	I
PESO NETO	57,8
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	20.11.2017
ISO 13485	13.01.2019
ISO 9001	20.07.2018




INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

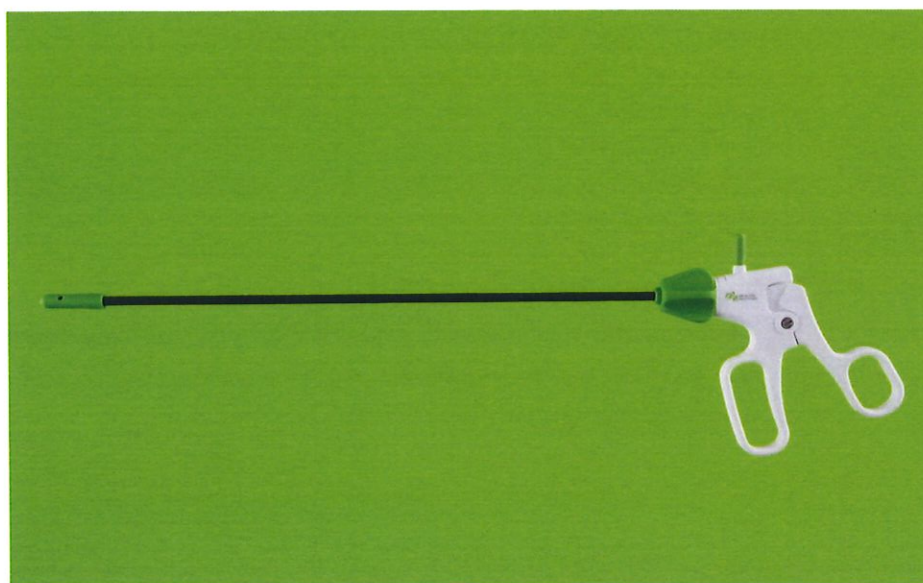

REFERENCIA	2319456-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Tijera monopolar 5mm /33cm Metzenbaum
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	TIJERA MONOPOLAR 5MM/33CM METZENBAUM
PROVEEDOR	Unimax Medical System Inc.
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
Nº DE FABRICANTE	899216(1MS53305Z)
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	IIb
PESO NETO	89,5
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO TESTADO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	SI
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	


INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

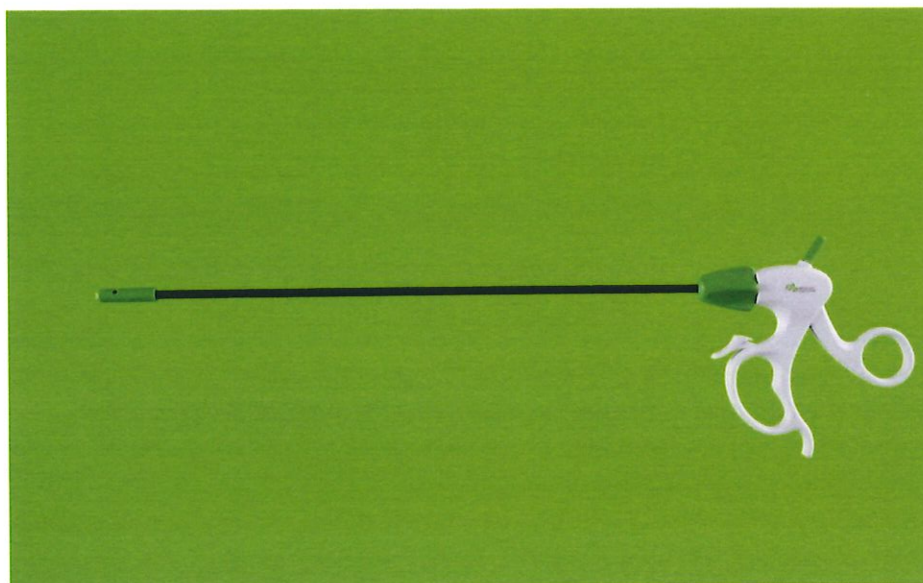

REFERENCIA	2319480-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Fórceps sujec. recta trinq fenestr 5mm/33cm
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	FORCEPS SUJ.RECTA 5MM/33CM TRINQ
PROVEEDOR	Unimax Medical System Inc.
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
Nº DE FABRICANTE	899207(1EJ53305Y)
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	IIb
PESO NETO	75,7
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO TESTADO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	SI
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	



INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

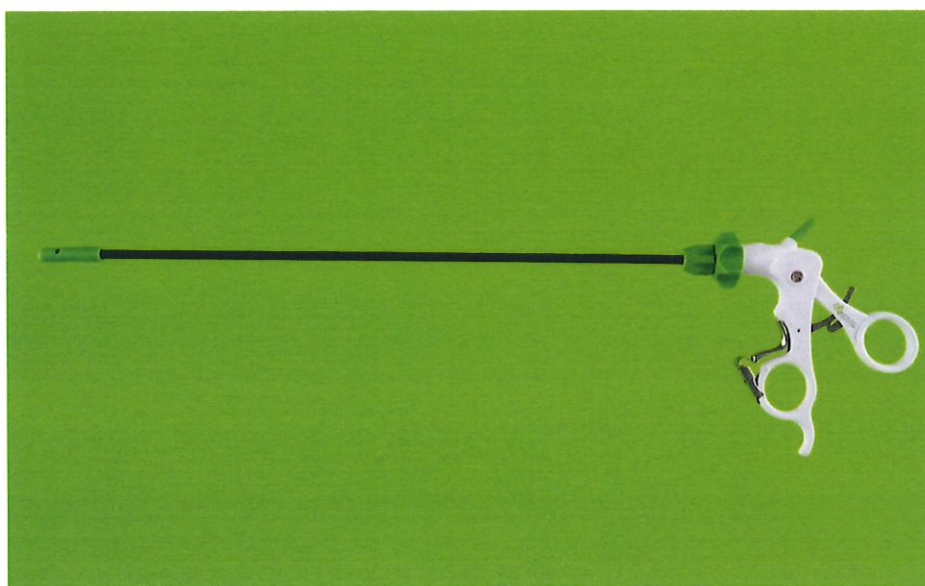

REFERENCIA	2319500-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Pinza agarre fenestrada c/control cremallera 5mm/33cm
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	PINZA AGARRE FENEST. CONTROL 5MM/33CM
PROVEEDOR	Unimax Medical System Inc.
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
Nº DE FABRICANTE	899215(1EJ73305Y)
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	IIb
PESO NETO	92,6
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LÁTEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO TESTADO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	SI
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	




INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE



REFERENCIA	910598-07
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Paño adhesivo 75x75cm
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	PAÑO ADHESIVO 75X75CM
PROVEEDOR	Mölnlycke Health Care S.A.
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
Nº DE FABRICANTE	706500
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	I
PESO NETO	44,351
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO TESTADO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	16.11.2017
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	15.9.2018



INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

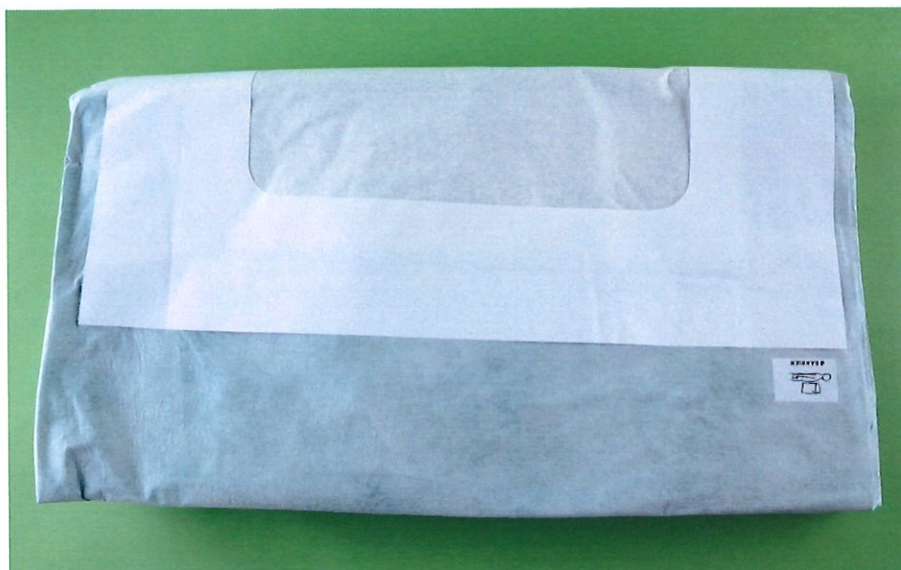

REFERENCIA	944200-07
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Sábana Laparoscopia 250/175/270x260cm, ab.adh.25x30cm y 13x24cm perianal, con bolsas laterales, zona de refuerzo y perneras
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	SÁBANA LAPAROSCOPIA 250/175/270x260CM
PROVEEDOR	Mölnlycke Health Care (Thailand)
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
Nº DE FABRICANTE	694240
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	I
PESO NETO	915,714
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO TESTADO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	15.11.2017
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	15.9.2018