

2024-1042

Centro Solicitante: HOSPITEN SUR/RAMBLA/BELLEVUE Y LANZAROTE

SAP	DENOMINACION ANTIGUA	DENOMINACION NUEVA	ANTIGUA		NUEVA		PROPIETA INCLUSION		
			RFA	RFA	RFA	RFA	CAJA	COSTE	UNIDAD
925216	ELECTRODO 20193-070	ELECTRODO C/ LENGÜETA DE CONTACTO 85CM	20193-070	20193-070	20193-082	50	110,00 €		2,20 €

VIGENCIA TARIFA 31/12/2024
PRECIOS SIN EL 3% DE IGIC

Observaciones:
EL CODIGO SAP 925216 CAMBIA SU REFERENCIA POR DEJAR DE FABRICARSE Y LA PROPIA MARCA NOS INDICA CUAL ES EL ELECTRODO ALTERNATIVO SIN CAMBIO DE COSTE DE MATERIAL

A rellenar por el centro, Marcar con una X si el Material Sanitario es NO facturable.	
Amb.	ADESLAS
Hosp.	DIK
	SANTAS

El Centro Hospitalario se responsabilizará que dicho material sea facturado al paciente y/o Entidad Aseguradora Pública o Privada, con especial atención a pacientes de Entidades Aseguradoras las cuales requieran consentimiento y autorización previa antes de su uso o aplicación.
Si el paciente es asegurado de entidades quienes tienen acuerdos con proveedores, previamente la Dirección o Administración del Hospital deberá verificar las marcas y/o proveedores homologados por la Entidad.
En caso que el paciente pertenezca a Entidades Aseguradora Públicas o Privadas con quienes tengamos "Tarifa de Prestación Cerrada", antes de dar conformidad la Dirección del hospital deberá analizar el coste del material junto con la tarifa de prestación.

GRUPO: RE (Material Registro).
CLASE: RE01 (Registro).
CARACTERISTICAS: RE0101 (Electrodos).

Informe y/o Gestión realizada por:
Gara fernandez Hernandez

20/10/2024

PROVEEDOR	SAP DENOMINACION	USO ACTUAL			NUEVA RFA	PREST	PROPUESTA INCLUSION		
		MEDICAL CANARIA COSTE	CAJA	UNIDAD			MEDICAL CANARIA COSTE	CAJA	UNIDAD
925216	ELECTRODO 20193-070	20193-070	110,00 €	50	20193-082	50	110,00 €	2,20 €	

[Handwritten signature]
 12/06/2014

Gara Fernández Hernández

De: Jose Manuel Jorge Pérez
Enviado el: lunes, 3 de junio de 2024 14:52
Para: Inmaculada Bolaños; María Isabel Alonso Rodríguez
CC: Susana Aguilar Castellano; Gara Fernández Hernández; Víctor Rodríguez González
Asunto: RV: Cambio de referencia- Se mantiene el precio
Datos adjuntos: _ERBE_XX_Declaration_of_Conformity_D031892.pdf;
_ERBE_XX_ERBE_NESSY_Omega_Plates_D009976.pdf; 20193-082.pdf; 85800-307
_ERBE_ES_Folleto_de_NESSY_D056509.pdf

Buenas tardes,
Isabel, por favor pongámonos con esta gestión.

Registro Número 2024/1042.

Gracias.

Saludos Cordiales
Responsable Fungibles y Prótesis.

Jose Manuel Jorge Pérez
Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department



Somos más de 5.000
profesionales trabajando
juntos para ti



Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Inmaculada Bolaños <inmaculada.bolanos@hospiten.com>
Enviado: lunes, 3 de junio de 2024 13:59
Para: Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>; Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>
Cc: Susana Aguilar Castellano <saguilar@hospiten.com>
Asunto: RV: Cambio de referencia- Se mantiene el precio

Buenas tardes,
Remito cambio en referencia, cod SAP 925216.
Saludos,

Inmaculada Bolaños
Aux de compras


Electodo 20193-070

20193-070

1106 / 50
2'20

Somos más de 5.000
profesionales trabajando
juntos para ti



 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Medical Canarias <medical-tf@medicalcanarias.com>

Enviado: lunes, 3 de junio de 2024 12:04

Para: Inmaculada Bolaños <inmaculada.bolanos@hospiten.com>; Susana Aguilar Castellano <saguilar@hospiten.com>; Víctor Rodríguez González <victor.rodriguez@hospiten.com>

Asunto: Cambio de referencia- Se mantiene el precio

AVISO: Este correo es externo a la organización. No acceda a enlaces o descargue adjuntos salvo que conozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

Buenos días:

Por la presente comunicamos actualización de referencia. El fabricante nos remite mejora del producto. Con un cambio de referencia.

Código interno: 925216. Referencia fabricante 20193-070 . ELECTRODOS Nessy

Nos deben pedir la referencia 20193-082. Placa de electrodo Nessy Omega. Se remite ficha técnica , marcado CE.

Por favor modificar en los pedidos de Hospiten Rambla 4500816389 y de Hospiten Lanzarote 4502578201.

Stock en plaza.

Nieves Reyes

MEDICAL CANARIAS S.A.

TELF: +34 922 544853

FAX : +34 922 544953

E-mail: medical-tf@medicalcanarias.com

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier dato adjunto es para uso exclusivo del destinatario y puede contener información privilegiada y confidencial. Si el receptor de este mensaje no es el destinatario previsto o un representante autorizado del destinatario previsto, queda informado por este medio que cualquier difusión, distribución, utilización o comunicación pública, de todo o parte de esta comunicación está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifiquenoslo inmediatamente por correo electrónico, y proceda al borrado del mensaje y cualquier archivo adjunto de su sistema de correo electrónico de manera definitiva.

PROTECCIÓN DE DATOS: MEDICAL CANARIAS S.A le informa que el tratamiento de los datos personales de contacto se realiza con la finalidad de gestión, desarrollo, seguimiento y cumplimiento de las relaciones existentes con MEDICAL CANARIAS S.A, envío de información general y comercial, gestión de agenda de contactos profesionales, siendo conservadas las mismas mientras exista un Interés general mutuo para ello. La base que legitima el tratamiento es la existencia de una relación precontractual o contractual vigente con MEDICAL CANARIAS S.A o, en su caso, el consentimiento. Sus datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal o para alcanzar el fin antes expuesto. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos desarrollados por la normativa de protección de datos ante MEDICAL CANARIAS S.A en la dirección: C/ Olof Palme nº31 bajo 35010 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) o en medical-ip@medicalcanarias.com. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es.

B

NO. 20193-082

NESSY® OMEGA, split

Erbe NESSY Ω , split, VIO, ICC, ACC, contact surface 85 cm²

- Split-pad effective contact surface 85 cm² + equipotential ring 23 cm²
- High current densities and partial warming are largely avoided
- Can be applied irrespective of the direction of the operative site
- Can be used to treat both adults and children
- Electrode is well tolerated by the skin (bio-compatible)
- With its thin, flexible material the plate adapts itself well to the shape of the body



Technical characteristics

Packaging unit	50 ST
Cable length	without connection cable
Compatibility	VIO, ICC, ACC
Single-use product	Yes
Contact area	85 CM2



erbe
power your performance.



Sistema VIO® NESSY®
y NESSY Ω®

Aplicación segura de los
electrodos neutros

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	03
EL FLUJO DE CORRIENTE EN LA ELECTROCIRUGÍA MONOPOLAR	04
SEGURIDAD INTEGRADA EN EL SISTEMA	05
EL CONCEPTO DE SEGURIDAD NESSY- Ω [®]	06
LISTA DE COMPROBACIÓN	07



Nota importante

Erbe Elektromedizin GmbH ha elaborado este folleto de recomendaciones de ajuste con la máxima diligencia posible. No obstante, no es posible excluir por completo posibles errores. La información y las indicaciones incluidas en las recomendaciones de ajuste no darán lugar a ningún derecho contra Erbe Elektromedizin GmbH. En caso de darse una posible responsabilidad por motivos legales imperativos, ésta se limitará a dolo y negligencia grave.

Las indicaciones sobre recomendaciones de ajuste, puntos de aplicación, duración de la aplicación y uso del instrumental se basan en experiencias clínicas, por lo que determinados centros y médicos prefieren otros ajustes independientemente de las recomendaciones indicadas. Se trata únicamente de valores orientativos cuya aplicabilidad deberá ser comprobada por el cirujano. En función de las circunstancias individuales puede ser necesario desviarse de las indicaciones de este folleto.

La medicina experimenta un continuo desarrollo debido a la investigación y a la experiencia clínica. También por ello puede resultar útil alejarse de las indicaciones aquí incluidas.




La electrocirugía es la técnica quirúrgica que se utiliza con más frecuencia en el quirófano. En prácticamente todos los quirófanos de todas las especialidades hay un aparato de electrocirugía.

En función del circuito eléctrico (aparato/instrumento/paciente) se diferencia entre la técnica monopolar y la técnica bipolar. Para la electrocirugía monopolar se aplica un electrodo neutro al cuerpo del paciente para derivar la corriente alterna de alta frecuencia. En la técnica bipolar se cierra el circuito eléctrico a través de un instrumento bipolar, por ejemplo unas pinzas.

El objetivo de este folleto es minimizar los posibles riesgos de la electrocirugía monopolar en relación con la aplicación del electrodo neutro. Para proporcionar al paciente la máxima protección.



El flujo de la corriente en la electrocirugía monopolar

Los electrodos neutros convencionales se deben orientar hacia el quirófano.

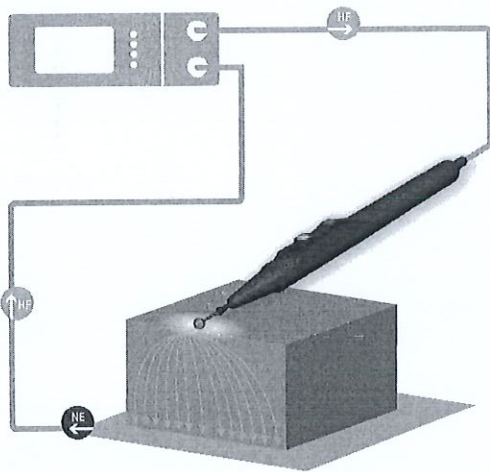

01

Circuito eléctrico cerrado en la electrocirugía monopolar. Distribución de la corriente en toda la superficie del EN con densidad de corriente baja

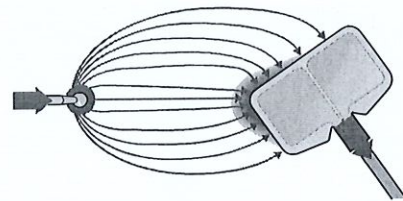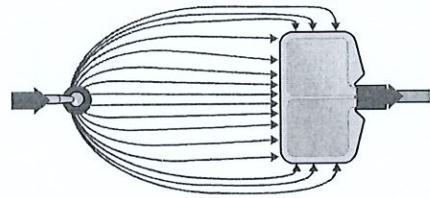

02

↑ Con esta orientación se reduce el efecto „leading edge“
 ↓ Elevado efecto „leading edge“ con una orientación asimétrica del EN

Con la técnica monopolar fluye corriente alterna en un circuito eléctrico: desde el instrumento a través del cuerpo del paciente hacia el electrodo neutro (denominado en los sucesivos EN) y desde allí de nuevo al aparato.

En el electrodo activo se transmite corriente de forma puntual con una elevada densidad de corriente. De este modo se produce un corte o una coagulación. En el punto de salida del EN no se producen efectos térmicos dignos de mención cuando la corriente es derivada a través de todo el EN de gran superficie con una densidad de corriente baja.

DIRECCIÓN DE APLICACIÓN DE UN ELECTRODO NEUTRO DE DOS SEGMENTOS


02

En el lado del EN próximo al campo quirúrgico se crea durante el flujo de corriente una densidad de corriente mayor, ya que la corriente elige el trayecto más corto con la menor resistencia. La distribución térmica desigual resultante en el EN también se denomina efecto „leading edge“.

Si el lado corto está dirigido hacia el campo quirúrgico, la densidad de corriente es mayor, pero la homogeneidad de la distribución térmica todavía es menor. Por ello, el lado largo del EN se debe orientar por principio hacia el campo quirúrgico. Esta orientación del lado largo („Long Edge“) permite reducir los picos térmicos (Fig. 02 ↑ y ↓).



Seguridad integrada en el sistema

Nuestro consejo de seguridad:
Evite el problema „leading edge“
utilizando un electrodo neutro NESSY-Ω[®].

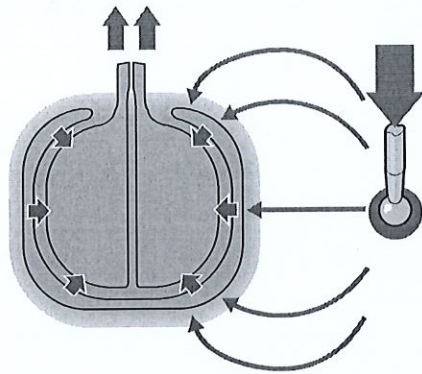

03

Distribución uniforme de la densidad de corriente y de la producción de calor en las dos superficies del EN

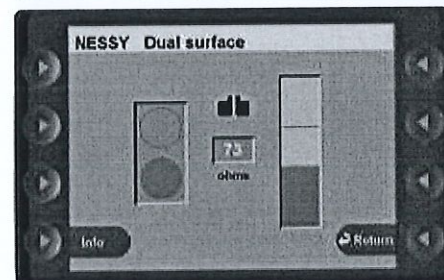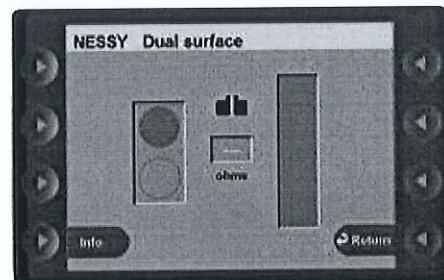

04

↑ Semáforo rojo: se interrumpe la activación si el EN no está aplicado correctamente

↓ Semáforo verde: es posible la activación con una resistencia de paso entre 20 y 120 ohmios

NESSY[®] COMPARA LAS DENSIDADES DE CORRIENTE DE LAS DOS SUPERFICIES DE LOS ELECTRODOS


03,04

La sigla NESSY[®] es el acrónimo del término alemán „Neutralelektroden-Sicherheitssystem“ que significa „sistema de seguridad para electrodos neutros“. El sistema NESSY[®] integrado en los sistemas VIO[®] comprueba la correcta colocación en toda su superficie del EN de dos segmentos y compara de forma continua las corrientes que fluyen a través de ambas superficies. Si el EN no se ha aplicado correctamente, se producirá una asimetría de la corriente. El riesgo: picos de calor parciales por densidades de corriente aumentadas.


En caso de pequeñas diferencias, la activación es posible. En el caso de grandes diferencias existe el riesgo de una necrosis tisular térmica.

NESSY[®] interrumpirá la activación y emitirá un aviso acústico (indicación en pantalla: semáforo rojo ↑). Para evitar necrosis térmicas, la función de electrocirugía solo se podrá volver a activar cuando se haya corregido la posición del EN.

El concepto de seguridad NESSY-Ω[®]

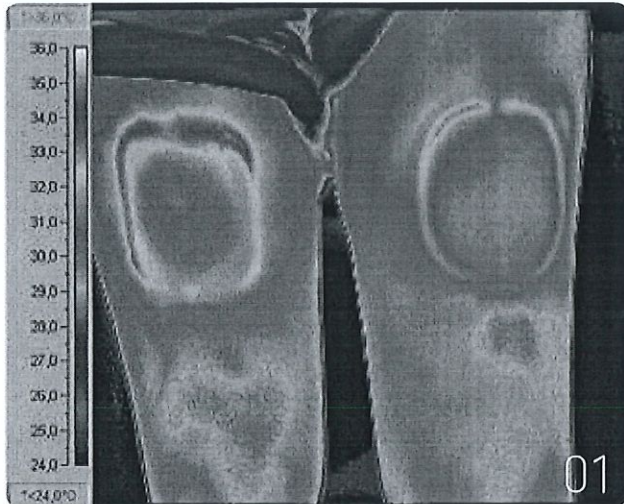

Comparación térmica entre un EN convencional y el electrodo NESSY Ω[®] (derecha):
distribución homogénea de la corriente
(aplicación en el muslo derecho e izquierdo)

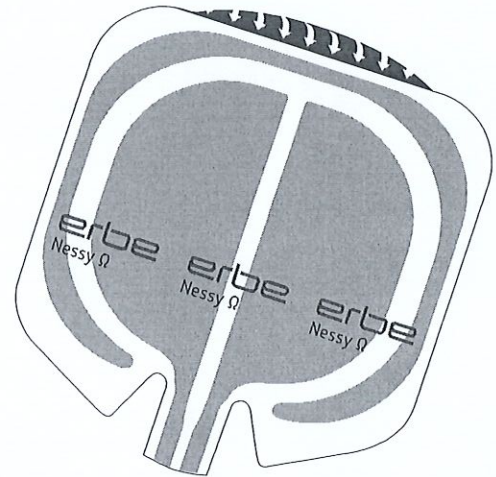

NESSY Ω[®] con el anillo equipotencial exterior sin contacto

MÁXIMA SEGURIDAD Y APLICACIÓN INDEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN CON NESSY Ω[®]

01

El electrodo neutro NESSY Ω[®] se puede colocar sin necesidad de tener en cuenta la orientación con respecto al campo quirúrgico. El anillo equipotencial exterior sin contacto transmite la corriente uniformemente a las superficies de contacto interiores, evitando así el efecto „leading edge” indeseado.

Una ventaja adicional: NESSY Ω[®] es más pequeño que los EN convencionales. Por eso también se puede utilizar y aplicar fácilmente en pacientes pequeños. Por consiguiente, NESSY Ω[®] se utiliza de forma universal para niños y adultos.


Los dos elementos, NESSY Ω[®] y el sistema de seguridad para electrodos neutros, representan el máximo de seguridad en la electrocirugía monopolar.

LAS VENTAJAS DE NESSY Ω[®] DE UN VISTAZO

- Se evitan en gran medida densidades de corriente elevadas y el calentamiento parcial, a pesar de una superficie del EN pequeña
- Aplicación independiente de la dirección
- Adecuado para adultos y niños
- Capa de contacto hipoalérgica
- Gracias al fino material de base, el EN se adapta perfectamente a la forma del cuerpo

Indicaciones


para una aplicación segura de la electrocirugía

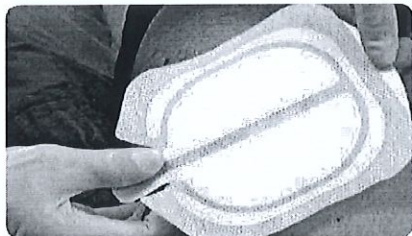

Seleccionar un electrodo neutro adecuado



Aplicar el electrodo neutro sin pliegues

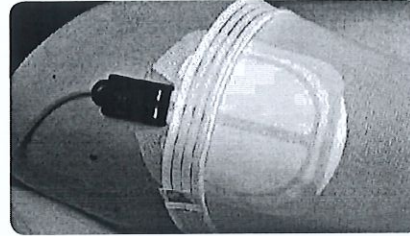

El electrodo neutro se puede aplicar debajo de la media antitrombosis

1. POSICIONAR AL PACIENTE DE FORMA AISLADA

- Posicione al paciente seco sobre una cubierta de mesa de quirófano eléctricamente aislada.
- Preste atención a que los apoyabrazos dispongan de una cobertura aislada.
- Retire todos los objetos corporales (piercings, anillos, cadenas, relojes, pulseras, prótesis dentales extraíbles); no es suficiente pegar una gasa sobre ellos.
- Posicione los brazos y las piernas de forma aislada del cuerpo flexionándolos o colocando paños; evite el contacto piel-piel en los pliegues cutáneos o mamarios (colocando gasas secas).
- El paciente no debe tocar objetos eléctricamente conductores (soportes para infusión, tubos).

2. SELECCIONAR UN ELECTRODO NEUTRO (EN) ADECUADO

- Es preferible utilizar EN divididos autoadhesivos que electrodos no divididos y de silicona.
- En el caso de lactantes, utilice EN adecuados.
- Recomendamos utilizar el electrodo NESSY Ω , que se puede colocar en cualquier dirección.
- Utilice EN divididos siempre que sea posible, ya que solo estos pueden ser monitorizados por el sistema de seguridad.

3. SELECCIONAR LA POSICIÓN PARA EL ELECTRODO NEUTRO (EN)

- Es posible aplicar los EN sobre el muslo, el brazo o el costado.
- Coloque los EN lo más cerca posible del campo quirúrgico a una distancia mínima de 15 cm.
- La corriente monopolar no se debe conducir a través de "cuellos de botella" eléctricos del cuerpo (p. ej. codos, rodillas).
- Si fuera posible, los EN deben ser colocados sobre tejidos con buena conducción eléctrica (tejido muscular).
- No aplique los EN sobre tejido adiposo, óseo o articulaciones, pliegues cutáneos o en la cabeza.
- Si fuera posible, aplique los EN sobre tejidos sanos. Evite las cicatrices, las hemorragias y los tatuajes.
- El paciente no debe estar acostado sobre los electrodos neutros, los cables o la conexión de estos.
- Cuando cambie al paciente de posición, procure que los EN y el cable no se suelten y no queden debajo del paciente.

Pacientes con implantes activos o pasivos:

- En los pacientes con marcapasos cardíaco u otros implantes conductores, utilice siempre que sea posible instrumentos bipolares.
- Si utiliza instrumentos monopolares, aplique el EN a cierta distancia del implante, de forma que la trayectoria de la corriente no pase por encima de este. Minimice el valor del efecto (tensión) y la limitación de potencia (vatios máx.).

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ADHESIÓN

- No pegue el EN sobre vello. Rasure la zona de aplicación del EN.
- La zona de aplicación del EN debe estar seca y libre de grasa.

5. APLICACIÓN CORRECTA DEL ELECTRODO NEUTRO

- No recorte el EN.
- Aplique los EN alargados siempre con el lado largo hacia el campo quirúrgico.
- Aplique los EN en toda su superficie y sin pliegues; evite la formación de burbujas de aire.
- En los pacientes que lleven una media antitrombosis: el EN se puede aplicar debajo de la media. El conector y el cable no se deben cubrir.
- Utilice los EN autoadhesivos solo una vez.

6. EVITAR LA IGNICIÓN DE SUSTANCIAS INFLAMABLES

- Los desinfectantes no deben fluir por debajo del paciente.
- Cubra al paciente solo cuando se haya secado el desinfectante y se haya evaporado el gas inflamable.
- Evite utilizar gases inflamables en el campo quirúrgico (p. ej. gases anestésicos o endógenos).

ATENCIÓN: Esta lista de comprobación no sustituye la indicación de uso.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EC DECLARATION OF CONFORMITY | DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

im Sinne des Anhanges II der EG-Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG und des Anhanges VI der EG-Richtlinie 2011/65/EU

according to Annex II of Directive 93/42/EEC concerning Medical Devices and according to Annex VI of Directive 2011/65/EU

suivant Annexe II des Directives Européennes relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE et suivant Annexe VI des Directives Européennes 2011/65/UE

Hersteller: Erbe Elektromedizin GmbH
Manufacturer: Waldhörnlestraße 17
Fabricant: D 72072 Tübingen

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
Hereby we declare under our sole responsibility, that the product
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Neutralelektrode zum Einmalgebrauch / Disposable neutral electrode / Electrode neutre à usage unique

REF	LOT
20193-082	≥00950 / ≥160616-0818
20193-083	≥00950 / ≥160616-0818
20193-084	≥00950 / ≥160616-0818

Medizinprodukt der Klasse **IIb**
Medical Device of Class / Dispositifs Médicaux de Classe

den Bestimmungen der nachstehenden Richtlinien entspricht.
meets the requirements of the following directives.
correspond aux arrêtés des Directives mentionnées ci-après.

Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte und Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011

Directive 93/42/EEC of the Council of June 14, 1993 for Medical Devices and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011

Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 Juin 1993 relative aux dispositifs médicaux et Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011



Dekra Certification GmbH
 Handwerkstraße 15
 D 70565 Stuttgart

CE 0124

Tübingen, 25.05.2021

Ort, Datum / Place, Date / Lieu, Date

Benannte Stelle / Notified Body / Organisme notifié
 93/42/EWG / 93/42/EEC / 93/42/CEE

26.05.2024

20193083.M16/21

Gültig bis / Valid until / Valide jusqu'à

Peter Stein
 (Leiter des Qualitätswesens / VP Quality assurance / Chef du Service qualité)

VO_0135_Konformitätserklärung mehrsprachig nach Anhang II

Anhang zur Konformitätserklärung Nr. 20193083.M16/21
 Appendix for Declaration of Conformity No. 20193083.M16/21
 Annexe à la Déclaration de Conformité n° 20193083.M16/21

Die in der Konformitätserklärung aufgeführten Neutral-Elektroden können mit folgenden Hochfrequenz-Chirurgiegeräten verwendet werden:

The disposable neutral electrodes cited in the declaration of conformity can be used with the following electrosurgical units:

Les électrodes indifférentes figurant dans la déclaration de conformité sont compatibles avec les bistouris électriques suivants:

Neutralelektroden Nr.:	Gerätetypen / Type of Unit / Modèles											
Disposable Neutral Electrodes No.:												
Electrode Indifférente n:	E	A	V	VF	S	O	OE	M	MM	C	AR	B
20193-082	X,1)	X,3)	X,2)	X,7)	X,3)	X,2)	X,7)	X,5)	X,6)	X,7)	X,6)	X,7)
20193-083	X,4)		X	X		X	X		X	X	X	X
20193-084	X,4)		X	X		X	X		X	X	X	X

Legende: / Legend: / Légende:

- E** ERBE VIO® 3, VIO® 300 D, VIO® 200 D, VIO® 300 S, VIO® 200 S, VIO® 100 C, VIO® 50C, VIO® dV, ICC 350, ICC 300, ICC 200, ICC 50, ICC 80, HF 120, HF 300, ACC 450/451, ACC 430, ACC 410
- A** Aesculap GN 300, GN 370, GN 640
- V** Valleylab Force 1C, Force 2, Force 4, Force 10, Force 20, Force 30, Force 40, Force 300, Force FX,
- VF** Valleylab Force EZ, Force Triad, FT 10
- S** STORZ autocon 350, autocon 200, autocon 50, autocon II 400, autocon II 200, autocon II 80
- O** Olympus PSD 60
- OE** Olympus ESG 100, ESG 300, ESG 400
- M** Martin ME200, ME MB2,
- MM** Martin Maxium
- C** ConMED System 5000
- AR** Arthrex OPES
- B** Bowa ARC 400
- X** Neutral-Elektrode verwendbar / Disposable neutral electrode usable / Electrode indifférente compatible avec
- 1)** Mit Anschlusskabel Nr.: / with connecting cable no.: / avec câble raccordement n °:
20194-057, 20194-058, 20194-061, 20194-065, 20194-077, 20194-078, 20194-079, 20194-080, 20194-083 oder / or / ou 20194-087
- 2)** Mit Anschlusskabel Nr.: / with connecting cable no.: / avec câble raccordement n °:
20194-061, 20194-080, 20194-085 oder / or / ou 20194-087
- 3)** Mit Anschlusskabel Nr.: / with connecting cable no.: / avec câble raccordement n °:
20194-057, 20194-058, 20194-077 oder / or / ou 20194-078
- 4)** Nur mit internationaler NE-Buchse / For international NE connector only / Uniquement pour sortie pour électrode neutre internationale
- 5)** Mit Anschlusskabel Nr.: / with connecting cable no.: / avec câble raccordement n °:
20194-063 oder / or / ou 20194-081
- 6)** Mit Anschlusskabel Nr.: / with connecting cable no.: / avec câble raccordement n °:
20194-077, 20194-078, 20194-079, 20194-080, 20194-081 20194-085 20194-086 oder / or / ou 20194-087
- 7)** Mit Anschlusskabel Nr.: / with connecting cable no.: / avec câble raccordement n °:
20194-079, 20194-080, 20194-085, 20194-086 oder / or / ou 20194-087

20193083.M16/21

Gara Fernández Hernández

De: Gara Fernández Hernández
Enviado el: martes, 18 de junio de 2024 8:27
Para: Lorenzo Galán
CC: Susana Aguilar Castellano; Jose Manuel Jorge Pérez; Inmaculada Bolaños; Angel Martín; Daniel Manso; Emma Duarte; Miguel Hernández González; Carmelo Salas
Asunto: RE: Cambio de referencia- Se mantiene el precio 925216
Datos adjuntos: CAMBIO DE REFERENCIA 925216 ELECTRODO.xlsx; AUTORIZACION CAMBIO 925216.pdf

Hola buenos días

En el día de ayer se ha dado autorización para el cambio en nuestro sistema del siguiente material 925216 electrodo , no existe cambio de precio sino de referencia , también debemos de actualizar la denominación que tenemos de dicho producto

Centro Solicitante: HOSPITEN SUR/RAMBLA/BELLEVUE Y LANZAROTE			
PROVEEDOR			
SAP	DENOMINACION ANTIGUA	DENOMINACION NUEVA	ANTIGUA RFA
925216	ELECTRODO 20193-070	ELECTRODO C/LENGÜETA DE CONTACTO 85CM	20193-070 2
VIGENCIA TARIFA 31/12/2024 PRECIOS SIN EL 3% DE IGIC			
Observaciones: EL CODIGO SAP 925216 CAMBIA SU REFERENCIA POR DEJAR DE FABRICARSE Y LA PROPIA MARCA NOS INDICA CUAL ES EL ELECTRODO ALTERNATIVO SIN CAMBIO DE COSTE DE MATERIAL			

Pongo en copia a los centro que utilizan dicho material, por si tuvieran pedidos pendiente de servir por este cambio de referencia procedan al cambio en el pedidos .

Saludos

De: Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>
Enviado el: lunes, 3 de junio de 2024 14:52
Para: Inmaculada Bolaños <inmaculada.bolanos@hospiten.com>; Maria Isabel Alonso Rodriguez <isabel.alonso@hospiten.com>
CC: Susana Aguilar Castellano <saguilar@hospiten.com>; Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>; Víctor Rodríguez González <victor.rodriguez@hospiten.com>
Asunto: RV: Cambio de referencia- Se mantiene el precio

Buenas tardes,
Isabel, por favor pongámonos con esta gestión.