

2024-2024

Centro Solicitante: HOSPITEN ROCA

PROPUESTA INCLUSION	
BBRAUN MEDICAL	COSTE
CAJA	UND

PROVEEDOR

SAP DENOMINACION

RFA PREST

CREAR	CATETER PERIFERICO SEGURIDA DIFICIL ACCESO G18	4251620-01	50	300,00 €	6,00 €
CREAR	CATETER PERIFERICO SEGURIDA DIFICIL ACCESO G20	4251621-01	50	300,00 €	6,00 €

721948
721949

VIGENCIA TARIFA 31/12/2024
PRECIOS SIN EL 3% DE IGIC

A rellenar por el centro, Marcar con una X si el Material Sanitario es NO facturable.		
	ADESLAS	SANITAS
Amb.		
Hosp.		

El Centro Hospitalario se responsabilizará que dicho material sea facturado al paciente y/o Entidad Aseguradora Pública o Privada, con especial atención a pacientes de Entidades Aseguradoras las cuales requieran consentimiento y autorización previa antes de su uso o aplicación.
Si el paciente es asegurado de entidades quienes tienen acuerdos con proveedores, previamente la Dirección o Administración del Hospital deberá verificar las marcas y/o proveedores homologados por la Entidad.
En caso que el paciente pertenezca a Entidades Aseguradora Públicas o Privadas con quienes tengamos "Tarifa de Prestación Cerrada", antes de dar conformidad la Dirección del hospital deberá analizar el coste del material junto con la tarifa de prestación.

GRUPO: CT (Material Cateteres , sondas, tubos).
CLASE: CT04 (Cateteres).
CARACTERISTICAS: CT0401 (Cateter periferico).

Informe y/o Gestión realizada por:
Gara Fernandez Hernandez

FIGO...



USO ACTUAL	
DIREX	GASTO ANUAL
COSTE UNIDAD	

PROPUESTA INCLUSION	
BBRAUN MEDICAL	GASTO ANUAL
COSTE UNID	

PROVEEDOR	SAP DENOMINACION	RFA	en-sep 2024	PREST 2024	estimado 2024	DENOMINACION	RFA	PREST	CAJA	COSTE UNID	GASTO ANUAL
824736	CATETER VENOSO CENTRAL 5FR 2VIAS 70CM	PS01672	10	20	20	CATETER PERIFERICO SEGURIDA DIFICIL ACCESO G18	4251620-01	50	300,00 €	6,00 €	120,00 €
						CATETER PERIFERICO SEGURIDA DIFICIL ACCESO G20	4251621-01	50	300,00 €	6,00 €	- €

[Handwritten signature]
 12/11/2024

MODELO 1. ADMISIÓN DE NUEVOS MATERIALES

PROPUESTA DE NUEVO MATERIAL HOSPITALARIO PARA SU INCLUSIÓN EN LA GUÍA HOSPITALARIA DE HOSPITEN


1. Nombre y referencia material: Introcac Safety Ref. 4251621-01 y Ref. 4251620-01
2. Nombre comercial: Cateter perfusivo de seguridad 620-1.1x64mm
618-1.3x64mm
3. Laboratorio: B. BRAUN
4. Presentación:
5. Aplicación:
6. Descripción del producto: Cateter perfusivo de seguridad mayor longitud del cateter para evitar extravasaciones, pérdida del cateter por manipulación, obtiene el drenaje de la perfusión en zona mas amplia de vaso con mayor flujo sanguíneo
7. Reséñese la acción diagnóstica/terapéutica principal y el uso terapéutico del material que justifique su inclusión: Administración de medicación intravenosa
8. Materiales de uso actual en Hospiten código SAP: Cateter vía perfusiva seguridad 628 1,30x30mm - 924403 29
620 1,10x30mm - 924404 058
9. Razones clínicas por las cuales este material es superior a los citados anteriormente: Mayor seguridad y confort del paciente
10. ¿Qué materiales considera usted podrían retirarse de la Guía reseñados anteriormente? Ninguno


42516201
924403 29
924404 058
42165201 50
2/21/00 29
2023 0158
2024
15.000


A rellenar por el centro. Marcar con una x si el MATERIAL SANITARIO es NO facturable.

	Adeslas	DKV	Sanitas			
Amb	<input type="checkbox"/>					
Hosp	<input type="checkbox"/>					

FECHA: 24/10/2024

DR./SERVICIO SOLICITANTE

Dirección enfermería - Roca
Fdo.: Dr.

Director-Gerente

Fdo.:
VICENTE DIAZ DIAZ

VºBº Director Médico
Dr. Mohamed Fariña Molina
DIRECTOR MÉDICO
Nº Colegiado 353507181
Fdo.: Dr.


Gara Fernández Hernández


De: Vicente Díaz
Enviado el: viernes, 8 de noviembre de 2024 8:40
Para: Gara Fernández Hernández
CC: Mohamed Fariña Molina; María Correa; Steffan Romay Robertsson; Jose Manuel Jorge Pérez
Asunto: RE: Sol Alta Mat. CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD

Buenos Días.

Conforme con la solicitud de alta.

Saludos.

Vicente Díaz
Director Gerente Hospiten Roca



 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.


De: Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>
Enviado el: viernes, 8 de noviembre de 2024 8:15
Para: Vicente Díaz <vicente.diaz@hospiten.com>
Asunto: RV: Sol Alta Mat. CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD

Hola buenos días Vicente

Solo es a titulo recordatorio , es de conformidad por su parte o por el contrario queda desestimado

Saludos

Gara Fernández Hernández
Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department



Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>
Enviado el: lunes, 4 de noviembre de 2024 18:09
Para: Vicente Díaz <vicente.diaz@hospiten.com>
CC: Mohamed Fariña Molina <MFARINAM@hospiten.com>; María Correa <maria.correa@hospiten.com>; Steffan Romay Robertsson <steffan.romay@hospiten.com>; Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>
Asunto: RE: Sol Alta Mat. CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD

Hola buenas tardes

Teniendo en cuenta el nuevo código proporcionado el consumo de roca de dicho material es de 2 caja (20 unidades) en lo que llevamos del 2024, adjuntamos el estudio con este nuevo código para su consideración si procedemos al alta de los dos catéteres periféricos de BBraun medical.

SAP	PROVEEDOR	DENOMINACION	RFA	PREST	en-sep 2024	estimado 2024	USO ACTUAL		DENOMINACION	RF.
							DIREX			
							COSTE UNIDAD	GASTO ANUAL		
824736	CATETER VENOSO CENTRAL 5FR 2VIAS 70CM		PS01672	10	20	20	35,00 €	700,00 €		
									CATETER PERIFERICO SEGURIDA DIFICIL ACCESO G18	42516;
									CATETER PERIFERICO SEGURIDA DIFICIL ACCESO G20	42516;

Quedo a la espera de tu conformidad para el dar de alta este material solicitado por el centro.

Saludos

Gara Fernández Hernández
Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department

Pasión y vocación
al servicio del progreso
de la salud



 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>

Enviado el: lunes, 4 de noviembre de 2024 18:03

Para: Vicente Díaz <vicente.diaz@hospiten.com>

CC: Mohamed Fariña Molina <MFARINAM@hospiten.com>; María Correa <maria.correa@hospiten.com>; Steffan Romay Robertsson <steffan.romay@hospiten.com>; Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>

Asunto: RE: Sol Alta Mat. CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD

Hola buenas tardes

Vuelvo hacer el estudio con el código proporcionado para ver la repercusión y se lo envío

saludos

Gara Fernández Hernández

Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department

Pasión y vocación
al servicio del progreso
de la salud



 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Vicente Díaz <vicente.diaz@hospiten.com>

Enviado el: lunes, 4 de noviembre de 2024 16:27

Para: Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>

CC: Mohamed Fariña Molina <MFARINAM@hospiten.com>; María Correa <maria.correa@hospiten.com>; Steffan Romay Robertsson <steffan.romay@hospiten.com>; Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>

Asunto: RE: Sol Alta Mat. CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD

Buenas tardes.

La idea no es sustituir el catéter 924403 por este. La solicitud de alta es para darle uso solo con aquellos pacientes que tengan vías difíciles.


Quizás el catéter a sustituir sería el **824736**:

824736 CATETER VENOSO CENTRAL 5FR 2VIAS 70CM

Saludos.

Vicente Díaz

Director Gerente Hospiten Roca



 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>

Enviado el: martes, 29 de octubre de 2024 16:09

Para: Vicente Díaz <vicente.diaz@hospiten.com>

CC: Mohamed Fariña Molina <MFARINAM@hospiten.com>; María Correa <maria.correa@hospiten.com>; Steffan Romay Robertsson <steffan.romay@hospiten.com>; Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>

Asunto: RE: Sol Alta Mat. CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD

Hola buenas tardes Vicente

Hemos realizado el estudio económico con los materiales que nos indican en la solicitud de alta material que es el material de uso actual y el coste de este catéter que solicitan es un 934% mas caro que el material de


uso actual , las unidades consumidas en el 2024 es de 15.000 unidades de enero a septiembre hemos realizado una estimación y nos sale aproximadamente que este año 2024 el consumo total llegara a unas 20.000 unidades con el precio actual del catéter actual seria de 11.600€ de gasto sin embargo si la tendencia del Hospital es a consumir este nuevo catéter y sustituir el de uso actual el gasto de la clínica se incrementaría considerablemente pasado a 120.000€ solo en este producto.

Dejo a su consideración si creamos dicho material en el sistema , adjuntamos análisis económico

SAP	PROVEEDOR DENOMINACION	RFA	PREST	en-sep 2024	estimado 2024	USO ACTUAL		DENOMINACION
						BBRAUN MEDICAL		
						COSTE UNIDAD	GASTO ANUAL	
924403	CATETER VIA PERIFERICA SEGURIDAD G28 1,30X30MM	425167901	50			0,58 €	- €	
924404	CATETER VIA PERIFERICA SEGURIDAD G20 1,10X30MM	42165201	50	15000	20000	0,58 €	11.600,00 €	CATETER PERIFERICO SEGURIDA DIFICIL ACCI CATETER PERIFERICO SEGURIDA DIFICIL ACCI

saludos

Gara Fernández Hernández
Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department



⚠ Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Steffan Romay Robertsson <steffan.romay@hospiten.com>
Enviado el: viernes, 25 de octubre de 2024 11:49
Para: Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>; Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>
CC: Vicente Díaz <vicente.diaz@hospiten.com>; Mohamed Fariña Molina <MFARINAM@hospiten.com>; María Correa <maria.correa@hospiten.com>
Asunto: Sol Alta Mat. CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD

Buenos días.

Se solicita alta de material CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD de las Ref: 4251621-01 y 4251620-01 de B. BRAUN.


Se adjunta solicitud de alta de material firmado.

Almacenes: 12AD, 1202, 1203, 1204, 12UR, 12UV, 12RA, 12QU, 12EN, 12CN Y 42AG

Muchas gracias.

Saludos

Steffan Romay Robertsson
Responsable Dpto. de Compras Hospiten Roca



 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.



OFERTA

10/2024/1/2690

B. Braun Medical SA
Carretera de Terrassa, 121
Dirección Postal: Apartado 6
E-08191 Rubí (Barcelona)
Tel.: 935866200*
Fax: 935881096

Su referencia:

ATN. Jose Manuel Jorge Pérez

Haga referencia en sus comunicaciones:

Referencia: 10/2024/1/2690
Fecha oferta: 29/10/2024
Válida hasta: 27/01/2025
Su contacto: Ana Victoria Cruz
Medical (02)
672109923


HOSPITAL RAMBLA SLU
(Farmacia)
Rb General Franco, 115
38001 Santa Cruz de Tenerife
STA. CRUZ TENERIFE

Cod. Prod	Denominación Producto	Presentación	Caja/Ud	Precio
4251620-01	INTROCAN SAFETY DEEP ACCESS G18 1,3X64	ca/50	Unidad	6,000000
4251621-01	INTROCAN SAFETY DEEP ACCESS G20 1,1 X 64	ca/50	Unidad	6,000000

Aplica a toda la oferta:

Impuestos NO Incluidos

Vigencia: desde 29/10/2024 hasta 31/12/2024



→ Acceso profundo

Introcán Safety® Deep Access

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO LARGO, DE INSERCIÓN ECOGUIADA, CON SISTEMA DE SEGURIDAD ANTI-PINCHAZOS DE ACTIVACIÓN PASIVA



Introcán Safety® Deep Access es un catéter periférico que proporciona acceso al tejido intravascular e incorpora un mecanismo de seguridad contra pinchazos de aguja de activación automática. Diseñado para pacientes de difícil acceso intravenoso (DIVA), permite el acceso a venas más profundas gracias a su mayor longitud (G18-22 x 64 mm / 21/2 pulgadas; G24 x 32 mm / 11/4 pulgadas). Se recomienda que los catéteres intravenosos de mayor longitud se coloquen bajo guía ecográfica. Se suministra como un producto estéril y no pirogénico.

Indicaciones y contraindicaciones

Dispositivo de un solo uso para acceso intravascular y tisular, toma de muestras de sangre, control de presión arterial o administración líquidos, productos farmacéuticos, sangre y hemoderivados por vía intravascular. También está indicado en terapias de infusión subcutánea y administración a través de inyectores de potencia hasta 300 PSI.

Introcán Safety® Deep Access no debe utilizarse en pacientes con hipersensibilidad conocida a ninguno de los materiales empleados.

Componentes

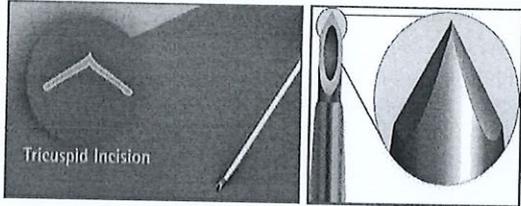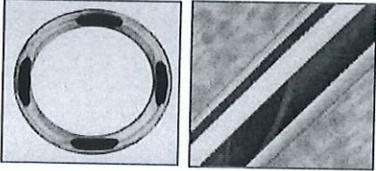- Aguja de acero inoxidable grado médico siliconada y pulido electrónico altamente visible bajo ultrasonido. Bisel trifacetado de corte trasero que reduce la fuerza de penetración de la aguja y ayuda a reducir el orificio de inserción. La mínima transición entre ésta y la punta cónica del catéter, garantizan una inserción cómoda y atraumática.

- Cánula de pared muy fina permite un diámetro interior mayor aumentando el flujo.
- Sistema de doble confirmación de punción exitosa: a través de la cánula y cámara transparente para visualización de sangre con tapón y filtro hidrófugo.
- Catéter intravenoso fabricado en Poliuretano Certón®, termosensible y resistente a acodaduras.
- Pestaña anti-rotación. Mantiene el catéter y la aguja juntos, evitando su movimiento.
- Cuatro líneas radiopacas paralelas, incrustadas en el material del catéter que ayudan a identificar en catéter con rayos X en caso de desprendimiento.

- Apto para administración a través de inyectores de potencia hasta 300 PSI.
- Conexiones y asidero diseñados ergonómicamente para permitir técnica de punción con una sola mano. Con pestaña indicadora de la posición del bisel que permite avanzar el catéter de forma higiénica reduciendo el riesgo de contaminación por contacto.

- Puede estar colocado por un período menor igual o menor a 30 días, plazo sujeto a las Directrices de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), y/o los protocolos institucionales u hospitalarios.
- Cumple con:
 - ISO 10555-1: Normas de Packaging: clara identificación del producto, fabricante, lote y expiración, entre otros.
 - ISO 10555-5: Normas de codificación: Color según el Gauge, longitud, flujo, Código barras, etc.
- Conexiones de seguridad Luer-Lock.
- Respetuoso con el medio ambiente. Al no contener PVC en su composición no desprende sustancias tóxicas en su destrucción.
- Exento de látex y DEHP.
- Envase unitario estéril de fácil apertura.

Código	Gauge	Longitud mm	Ø Catéter mm	Flujo por gravedad (ml/min)	Código de colores
4251620-01	INTROCAN SAFETY WL PUR 18GX64MM	64	1.3	85	Verde
4251621-01	INTROCAN SAFETY WL PUR 20GX64MM	64	1.1	51	Rosa
4251622-01	INTROCAN SAFETY WL PUR 22GX64MM	64	0.9	24	Azul
4251623-01	INTROCAN SAFETY WL PUR 24GX32MM	32	0.7	17	Amarillo

Datos de producto

- Unidad de venta: c/50 udes
- Caducidad 5 años
- Método esterilización: EO





Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder
für Gesundheitsschutz
bei Arzneimitteln und
Medizinprodukten
www.zlg.de
ZLG-BS-244.10.08



Product Service

EC Certificate

Full Quality Assurance System

Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex II excluding (4)
(Devices in Class IIa, IIb or III)

No. G1 012974 0607 Rev. 02

Manufacturer:

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Str. 1
34212 Melsungen
GERMANY

Product Category(ies):

Active medical devices for fluid management:

- Volumetric infusion pumps
- Infusion syringe pumps
- Elastomeric Pumps
- Control & organisation units and systems made out of it
- Irrigation Pump and accessories
- Enteral feeding pumps
- Pump for negative pressure wound therapy
- Non-active medical devices (sterile and non-sterile) for:
- Injection, infusion, transfusion and nutrition
- Anaesthesia, emergency, intensive and home care
- Disinfecting, cleaning, rinsing
- Irrigation
- Cryotherapy
- Configured customized sets
- Medical devices for wound care
- Medical Gloves
- Sterile solutions (Irrigation Solutions)
- Sterile products for urology and gastroenterology:
- Catheters, catheter kits, drainage and irrigation kits, urological stents, nephrostomy kits, cystometry kits, accessories

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system for design, manufacture and final inspection of the respective devices / device categories in accordance with MDD Annex II. This quality assurance system conforms to the requirements of this Directive and is subject to periodical surveillance. For marketing of class III devices an additional Annex II (4) certificate is mandatory. See also notes overleaf.

Report No.:

713181267

Valid from:

2020-06-09

Valid until:

2024-05-26

Date,

2020-07-17

Christoph Dicks
Head of Certification/Notified Body

Page 1 of 1

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TUV®

Gara Fernández Hernández

De: Jesús Gaviño Serrano <jesus.gavino@bbraun.com>
Enviado el: martes, 29 de octubre de 2024 12:40
Para: Gara Fernández Hernández; Ana Victoria Cruz Bolanos; Yolanda de Miguel Hernández
CC: Jose Manuel Jorge Pérez
Asunto: RE: PETICION DE PRESUPUESTO GRUPO HOSPITEN
Datos adjuntos: Oferta Introcán Deep Access.pdf; G1 012974 0607 Rev. 02.pdf; ISDA_Ficha Técnica_Gama completa.pdf

AVISO: Este correo es externo a la organización. No acceda a enlaces o descargue adjuntos salvo que conozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

Buenas tardes

Adjunto oferta, ficha técnica y certificado CE de los productos solicitados.
La fecha estimada de entrega actual es de 10 días

Saludos

Jesús Gaviño Serrano

De: Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>
Enviado el: martes, 29 de octubre de 2024 10:37
Para: Jesús Gaviño Serrano <jesus.gavino@bbraun.com>; Ana Victoria Cruz Bolanos <ana_victoria.cruz@bbraun.com>; Yolanda de Miguel Hernández <yolanda.de_miguel@bbraun.com>
CC: Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>
Asunto: PETICION DE PRESUPUESTO GRUPO HOSPITEN

CAUTION: This email originated from outside the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Hola buenos días

Ruego que por favor, nos haga llegar en la mayor brevedad posible, la siguiente información que a continuación pasó a detallar para el Grupo Hospiten.

- 1- Estimación Entrega.
- 2- Presentación.
- 3- Ficha Técnica o Catalogo.
- 4- Certificado Registro Sanitario de dicho material.
- 5- Certificados CE, de calidad, medido Ambiente y/o seguridad, dependiendo del tipo de producto o material.
- 5- Vigencia Tarifa como mínimo 31 de Diciembre 2023

6- Los precios a presentar en este Departamento Central, deberán ser precios puestos en la puerta del hospital. Se entiende como precios puestos en la puerta del hospital, con impuestos, transportes, aduanas, etc.. incluidos.

7- Marca y modelo.

8- Presupuesto del siguiente material que a continuación paso a detallar:

INTROCAN SAFETY CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD RFA 4251621-01 Y RFA 4251620-01

saludos

Gara Fernández Hernández

Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department

Avenida Marítima, 3
38003 Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias Spain
T (+34) 922 629 470

hospiten.com

 **Hospiten**

Prevención anual del cáncer de mama

Prevenir cada año para sonreír mucho más

 **Hospiten**



 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

Este correo y cualquier archivo enviado con él son confidenciales y exclusivamente para el uso de la persona a quien va dirigida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique y proceda a su destrucción. Todas las opiniones que se presentan son exclusivamente de su autor y no representan necesariamente las de Hospiten Gestión A.I.E. La publicación no autorizada, uso, difusión, transmisión, impresión o copia de este mensaje de correo electrónico y sus archivos adjuntos está estrictamente prohibida. En cumplimiento de la normativa de protección de datos, le informamos que los datos relativos al destinatario del presente correo son tratados por parte de Hospiten Gestión A.I.E. con fines de contacto profesional basado en el interés legítimo para el mantenimiento de la relación entre remitente y destinatario. Los datos se conservarán mientras se mantenga dicha relación y no se solicite su supresión y, en su caso, durante los plazos legales de aplicación). Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito, adjuntando copia del DNI o documento identificativo al Responsable, en la dirección Plaza 25 de julio, Apartado de correos 10681, 38004 Santa Cruz de Tenerife, o mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: protecciondedatos@hospiten.com, adjuntando copia de DNI u otro documento identificativo, así como a reclamar

Gara Fernández Hernández

De: Gara Fernández Hernández
Enviado el: martes, 29 de octubre de 2024 16:09
Para: Vicente Díaz
CC: Mohamed Fariña Molina; María Correa; Steffan Romay Robertsson; Jose Manuel Jorge Pérez
Asunto: RE: Sol Alta Mat. CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD
Datos adjuntos: ESTUDIO DE AGUAS OFERTA ECONO DISMA NOVIEMBRE.xlsx; solicitud alta cateter.pdf

Hola buenas tardes Vicente

Hemos realizado el estudio económico con los materiales que nos indican en la solicitud de alta material que es el material de uso actual y el coste de este catéter que solicitan es un 934% mas caro que el material de uso actual , las unidades consumidas en el 2024 es de 15.000 unidades de enero a septiembre hemos realizado una estimación y nos sale aproximadamente que este año 2024 el consumo total llegara a unas 20.000 unidades con el precio actual del catéter actual seria de 11.600€ de gasto sin embargo si la tendencia del Hospital es a consumir este nuevo catéter y sustituir el de uso actual el gasto de la clínica se incrementaría considerablemente pasado a 120.000€ solo en este producto.

Dejo a su consideración si creamos dicho material en el sistema , adjuntamos análisis económico

							USO ACTUAL		
PROVEEDOR							BBRAUN MEDICAL		
SAP	DENOMINACION	RFA	PREST	en-sep 2024	estimado 2024	COSTE UNIDAD	GASTO ANUAL	DENOMINACION	
924403	CATETER VIA PERIFERICA SEGURIDAD G28 1,30X30MM	425167901	50			0,58 €	- €		
924404	CATETER VIA PERIFERICA SEGURIDAD G20 1,10X30MM	42165201	50	15000	20000	0,58 €	11.600,00 €		
								CATETER PERIFERICO SEGURIDA DIFICIL ACCE	
								CATETER PERIFERICO SEGURIDA DIFICIL ACCE	

saludos

Gara Fernández Hernández
 Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department



Pasión y vocación
al servicio del progreso
de la salud



Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Steffan Romay Robertsson <steffan.romay@hospiten.com>

Enviado el: viernes, 25 de octubre de 2024 11:49

Para: Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>; Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>

CC: Vicente Díaz <vicente.diaz@hospiten.com>; Mohamed Fariña Molina <MFARINAM@hospiten.com>; María Correa <maria.correa@hospiten.com>

Asunto: Sol Alta Mat. CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD

Buenos días.

Se solicita alta de material CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD de las Ref: 4251621-01 y 4251620-01 de B. BRAUN.

Se adjunta solicitud de alta de material firmado.

Almacenes: 12AD, 1202, 1203, 1204, 12UR, 12UV, 12RA, 12QU, 12EN, 12CN Y 42AG

Muchas gracias.

Saludos

Steffan Romay Robertsson
Responsable Dpto. de Compras Hospiten Roca



Pasión y vocación
al servicio del progreso
de la salud

 Hospiten



 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

Gara Fernández Hernández

De: Ana Victoria Cruz Bolanos <ana_victoria.cruz@bbraun.com>
Enviado el: martes, 29 de octubre de 2024 18:10
Para: Gara Fernández Hernández
CC: Yolanda de Miguel Hernández; Jesús Gaviño Serrano
Asunto: RE: PETICION DE PRESUPUESTO GRUPO HOSPITEN

AVISO: Este correo es externo a la organización. No acceda a enlaces o descargue adjuntos salvo que conozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

Buenas tardes Gara,

Mi nombre es Ana, creo que no hemos tenido oportunidad de conocernos, soy delegada especialista en terapia de infusión en laboratorios BBRAUN.

Permíteme presentar de forma breve el catéter del cual solicitan oferta económica;

INTROCAN DEEP ACCESS es un catéter periférico, pero no debemos compararlo con un catéter periférico normal, como si lo son los que nos compran habitualmente.

Este catéter es de uso en pacientes DIVA (de difícil acceso), se trata de un catéter periférico, pero su colocación es exclusiva con guía ecográfica, podríamos decir que se asemeja más a un mini midline, siendo el precio de estos últimos bastante superior a nuestro Introcan Deep Access.

El tiempo de permanencia que estos catéteres nos permiten estar en la vena del paciente es de 30 días, lo que nos reduce considerablemente el uso de apósitos, otro tipo de catéteres o cualquier otro material necesario para una nueva canalización de la vena.

El uso de este tipo de catéteres, por norma general, es limitado en el hospital, cada caja trae 50/u, estoy convencida de que estas unidades no llegarían a ser semestrales, por no decir anuales, y en cualquier caso, si el fungible llegara defectuoso, caducase o se encontraran con cualquier otra incidencia, el laboratorio lo reemplazaría como se ha hecho en anteriores ocasiones.

Si lo desea, mañana puedo ponerme en contacto y ampliar la información que considere.

Saludos

Ana Victoria Cruz Bolaños
Delegada de Ventas Especialista en Terapia de Infusión
(+34) 672109923
ana_victoria.cruz@bbraun.com

De: Jesús Gaviño Serrano <jesus.gavino@bbraun.com>
Enviado el: martes, 29 de octubre de 2024 14:26
Para: Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>; Ana Victoria Cruz Bolanos <ana_victoria.cruz@bbraun.com>; Yolanda de Miguel Hernández <yolanda.de_miguel@bbraun.com>
Asunto: Re: PETICION DE PRESUPUESTO GRUPO HOSPITEN

Buenas tardes.

Es el precio del catéter mini Midline Deep Access, precio unitario

Saludos

Jesús Gaviño Serrano

De: Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>

Enviado: Tuesday, October 29, 2024 2:04:17 PM

Para: Jesús Gaviño Serrano <jesus.gavino@bbraun.com>; Ana Victoria Cruz Bolanos <ana_victoria.cruz@bbraun.com>; Yolanda de Miguel Hernández <yolanda.de_miguel@bbraun.com>

Asunto: RE: PETICION DE PRESUPUESTO GRUPO HOSPITEN

CAUTION: This email originated from outside the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Hola Jesus

El coste de 6€ es el precio de la caja???

saludos

Gara Fernández Hernández

Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department

Avenida Marítima, 3
38003 Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias Spain
T (+34) 922 629 470

hospiten.com



Prevención anual del cáncer de mama

Prevenir cada año para sonreír mucho más



Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

Este correo y cualquier archivo enviado con él son confidenciales y exclusivamente para el uso de la persona a quien va dirigida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique y proceda a su destrucción. Todas las opiniones que se presentan son exclusivamente de su autor y no representan necesariamente las de Hospiten Gestión A.I.E. La publicación no autorizada, uso, difusión, transmisión, impresión o copia de este mensaje

de correo electrónico y sus archivos adjuntos está estrictamente prohibida. En cumplimiento de la normativa de protección de datos, le informamos que los datos relativos al destinatario del presente correo son tratados por parte de Hospiten Gestión A.I.E. con fines de contacto profesional basado en el interés legítimo para el mantenimiento de la relación entre remitente y destinatario. Los datos se conservarán mientras se mantenga dicha relación y no se solicite su supresión y, en su caso, durante los plazos legales de aplicación). Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito, adjuntando copia del DNI o documento identificativo al Responsable, en la dirección Plaza 25 de julio, Apartado de correos 10681, 38004 Santa Cruz de Tenerife, o mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: protecciondedatos@hospiten.com, adjuntando copia de DNI u otro documento identificativo, así como a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es).

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you have received this email in error please send it back to the person that sent it to you. Any views or opinions presented are solely those of its author and do not necessarily represent those of Hospiten Gestión A.I.E. Unauthorized publication, use, dissemination, forwarding, printing or copying of this email and its associated attachments is strictly prohibited.

De: Jesús Gaviño Serrano <jesus.gavino@bbraun.com>

Enviado el: martes, 29 de octubre de 2024 12:40

Para: Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>; Ana Victoria Cruz Bolanos <ana_victoria.cruz@bbraun.com>; Yolanda de Miguel Hernández <yolanda.de_miguel@bbraun.com>

CC: Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>

Asunto: RE: PETICION DE PRESUPUESTO GRUPO HOSPITEN

AVISO: Este correo es externo a la organización. No acceda a enlaces o descargue adjuntos salvo que conozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

Buenas tardes

Adjunto oferta, ficha técnica y certificado CE de los productos solicitados.
La fecha estimada de entrega actual es de 10 días

Saludos

Jesús Gaviño Serrano

De: Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>

Enviado el: martes, 29 de octubre de 2024 10:37

Para: Jesús Gaviño Serrano <jesus.gavino@bbraun.com>; Ana Victoria Cruz Bolanos <ana_victoria.cruz@bbraun.com>; Yolanda de Miguel Hernández <yolanda.de_miguel@bbraun.com>

CC: Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>

Asunto: PETICION DE PRESUPUESTO GRUPO HOSPITEN

CAUTION: This email originated from outside the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Hola buenos días

Ruego que por favor, nos haga llegar en la mayor brevedad posible, la siguiente información que a continuación pasó a detallar para el Grupo Hospiten.

1- Estimación Entrega.

2- Presentación.

3- Ficha Técnica o Catalogo.

4- Certificado Registro Sanitario de dicho material.

5- Certificados CE, de calidad, medido Ambiente y/o seguridad, dependiendo del tipo de producto o material.

5- Vigencia Tarifa como mínimo 31 de Diciembre 2023

6- Los precios a presentar en este Departamento Central, deberán ser precios puestos en la puerta del hospital. Se entiende como precios puestos en la puerta del hospital, con impuestos, transportes, aduanas, etc.. incluidos.

7- Marca y modelo.

8- Presupuesto del siguiente material que a continuación paso a detallar:

INTROCAN SAFETY CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD RFA 4251621-01 Y RFA 4251620-01

saludos

Gara Fernández Hernández

Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department


Avenida Marítima, 3
38003 Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias Spain
T (+34) 922 629 470

hospiten.com



Prevenção anual del
cáncer de mama

Prevenir cada año para sonreír mucho más



 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

Este correo y cualquier archivo enviado con él son confidenciales y exclusivamente para el uso de la persona a quien

Gara Fernández Hernández

De: Gara Fernández Hernández
Enviado el: martes, 12 de noviembre de 2024 11:50
Para: Lorenzo Galán
CC: Steffan Romay Robertsson; Jose Manuel Jorge Pérez
Asunto: RV: Sol Alta Mat. CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD
Datos adjuntos: SOLICITUD DE ALTA CATETER PERIFERICO ACCESO DIFICL.xlsx

Hola buenas tardes

En el día de hoy se ha dado autorización para la creación del siguiente material solicitado por el centro hospitalario CATETER PERIFERICO SEGURIDAD DIFICIL ACCESO DE G18 Y G20.

Almacenes: 12AD, 1202, 1203, 1204, 12UR, 12UV, 12RA, 12QU, 12EN, 12CN Y 42AG

Centro Solicitante: HOSPITEN ROCA				
PROVEEDOR				PROPUESTA INCL
				BBRAUN MEDI
				COSTE
SAP	DENOMINACION	RFA	PREST	CAJA
CREAR	CATETER PERIFERICO SEGURIDA DIFICIL ACCESO G18	4251620-01	50	300,00 €
CREAR	CATETER PERIFERICO SEGURIDA DIFICIL ACCESO G20	4251621-01	50	300,00 €
VIGENCIA TARIFA 31/12/2024				
PRECIOS SIN EL 3% DE IGIC				

El Centro Hospitalario se responsabilizará que dicho material sea facturado al paciente y/o Entidad Aseguradora Pública o Privada, con especial atención a pacientes de Entidades Aseguradoras las cuales requieran consentimiento y autorización previa antes de su uso o aplicación.

Si el paciente es asegurado de Entidades quienes tienen acuerdos con proveedores, previamente la Dirección o Administración del Hospital deberá verificar las marcas y/o proveedores homologados por la Entidad. En caso de que el paciente pertenezca a Entidades Aseguradoras Públicas o Privadas con quienes tengamos "Tarifa de Prestación Cerrada", antes de dar conformidad la Dirección del Hospital deberá analizar el coste del material junto con la tarifa de prestación.

Saludos

De: Vicente Díaz <vicente.diaz@hospiten.com>
Enviado el: viernes, 8 de noviembre de 2024 8:40
Para: Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>
CC: Mohamed Fariña Molina <MFARINAM@hospiten.com>; María Correa <maria.correa@hospiten.com>; Steffan Romay Robertsson <steffan.romay@hospiten.com>; Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>
Asunto: RE: Sol Alta Mat. CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD

Buenos Días.