

2025-0104

Centro Solicitante: HOSPITEN ROCA

PROPUESTA INCLUSION		
BRAUN MEDICAL	COSTE	UNIDAD
CAJA		

PROVEEDOR

SAP DENOMINACION

RFA PREST

CREAR APOSITO FIACION CATETER ANESTESIA EPIDURAL	4511200	25	75,00 €	3,00 €
--	---------	----	---------	--------

72224

VIGENCIA TARIFA 31/12/2025  
PRECIOS SIN EL 3% DE IGIC

A rellenar por el centro, Marcar con una X si el Material Sanitario es NO facturabile.			
	ADESLAS	DKV	SANITAS
Amb.			
Hosp.			

El Centro Hospitalario se responsabilizará que dicho material sea facturado al paciente y/o Entidad Aseguradora Pública o Privada, con especial atención a pacientes de Entidades Aseguradoras las cuales requieran consentimiento y autorización previa antes de su uso o aplicación.


Si el paciente es asegurado de entidades quienes tienen acuerdos con proveedores, previamente la Dirección o Administración del Hospital deberá verificar las marcas y/o proveedores homologados por la Entidad.

En caso que el paciente pertenezca a Entidades Aseguradora Públicas o Privadas con quienes tengamos "Tarifa de Prestación Cerrada", antes de dar conformidad la Dirección del hospital deberá analizar el coste del material junto con la tarifa de prestación.

GRUPO: MC (Material Curas).  
CLASE: MC02 (Aposito).  
CARACTERISTICAS: MC0201 (Aposito no activo).

Informe y/o Gestión realizada por:  
Gara Fernandez Hernandez

Fdo. 

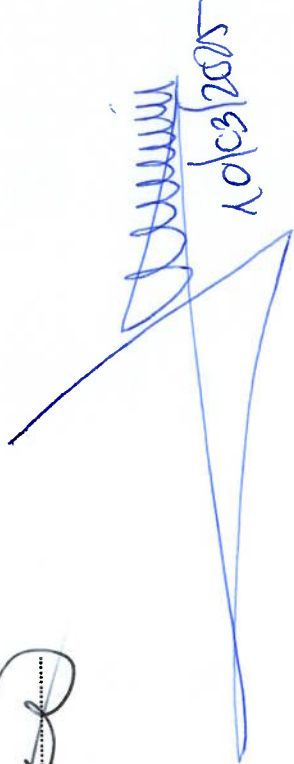  
10/03/2025

ROCA

Vecindario

**MODELO 1. ADMISIÓN DE NUEVOS MATERIALES**

C/ Baganvilla, 1  
Avda. de Canarias, 54  
Gran Canaria, España  
HOSPITALARIA DE HOSPITEN  
T +34 928 769 004  
F +34 928 769 004  
roca@hospiten.com

1. Nombre y referencia material: **FIXACIÓN DE CATETER PERIFIX / Ref. 4511200**
2. Nombre comercial: **PERIFIX**
3. Laboratorio: **BRAUN**
4. Presentación: **1 CASA = 25 UNIDADES.**
5. Aplicación:

**TUO DE DOLOR POSTOPERATORIO**  
**Aposito giratorio a todo anestesia epidural**

6. Descripción del producto:  
**SISTEMA DE FIJACIÓN DE CATETER FARIJAC**

7. Reseñese la acción diagnóstica/terapéutica principal y el uso terapéutico del material que justifique su inclusión:  
**SISTEMA DE FIJACIÓN ASOCIADO A LOS BLOQUES CONTINUOS DE ANESTESIA REGIONAL**

8. Materiales de uso actual en Hospiten código SAP:  
**NINGUNO**

9. Razones clínicas por las cuales este material es superior a los citados anteriormente:

10. ¿Qué materiales considera usted podrían retirarse de la Guía reseñados anteriormente?  
**NINGUNO**

A rellenar por el centro. Marcar con una x si el MATERIAL SANITARIO es NO facturable.

	Adeslas	DKV	Sanitas			
Amb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hosp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FECHA: **03/03/2025**

DR./SERVICIO SOLICITANTE

**Dra. Tanaya Canciano Chirino**  
N.º Col. 35/08/36342  
3/03/2025

Fdo.: Dr.

Director Gerente

78481078H  
VICENTE ANDRES DIAZ  
(C:B35665991)  
Firmado digitalmente por  
78481078H VICENTE ANDRES DIAZ  
(C:B35665991)  
Fecha: 2025.03.03  
15:06:11 Z

Fdo.:

VºBº Director Médico

FARIÑA MOLINA MOHAMED - 49496106Z  
Digitally signed by FARIÑA MOLINA MOHAMED - 49496106Z  
DN: cn=ES, serialNumber=DCE5-49496106Z, givenName=MOHAMED, sn=FARIÑA MOLINA, cn=FARIÑA MOLINA MOHAMED - 49496106Z  
Date: 2025.03.03 16:43:54 Z

Fdo.: Dr.

## Gara Fernández Hernández

---

**De:** Vicente Díaz  
**Enviado el:** viernes, 7 de marzo de 2025 12:36  
**Para:** Gara Fernández Hernández  
**CC:** Mohamed Fariña Molina; Jose Manuel Jorge Pérez; Steffan Romay Robertsson  
**Asunto:** RE: Sol. Alta Mat. FIJACION DE CATETER PERIFIX Ref. 4511200


Conforme.

---

**Vicente Díaz**  
Director Gerente Hospiten Roca



Construyendo un ecosistema  
de bienestar alrededor de  
las personas



Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

---

**De:** Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>  
**Enviado el:** viernes, 7 de marzo de 2025 10:10  
**Para:** Vicente Díaz <vicente.diaz@hospiten.com>  
**CC:** Mohamed Fariña Molina <MFARINAM@hospiten.com>; Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>; Steffan Romay Robertsson <steffan.romay@hospiten.com>  
**Asunto:** RV: Sol. Alta Mat. FIJACION DE CATETER PERIFIX Ref. 4511200

Buenos días

Adjunto solicitud por parte del Servicio Anestesia junto con coste económico con lo solicitado APOSITO FIJACION CATETER ANESTESIA EPIDURAL para su consideración y conformidad como responsable económico del Centro.

P.D. La Dirección del Centro Hospitalario dispondrá de 15 días para poder dar autorización a esta solicitud, de lo contrario esta Central entenderá que esta solicitud NO es de su afirmación. Posteriormente esta Central Corporativa procederá a la cancelación y/o desestimar dicha solicitud

<b>Centro Solicitante: HOSPITEN ROCA</b>					
<b>PROVEEDOR</b>				<b>PROPUESTA INCLUS</b>	
				<b>BRAUN MEDICA</b>	
				<b>COSTE</b>	
<b>SAP</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>RFA</b>	<b>PREST</b>	<b>CAJA</b>	<b>UNID</b>
<b>CREAR</b>	<b>APOSITO FIJACION CATETER ANESTESIA EPIDURAL</b>	<b>4511200</b>	<b>25</b>	<b>75,00 €</b>	
<b>VIGENCIA TARIFA 31/12/2025</b>					
<b>PRECIOS SIN EL 3% DE IGIC</b>					

Ruego su conformidad para proceder a la autorización por parte de la Dirección de Compras.

Muchas Gracias.!!

**Gara Fernández Hernández**  
Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department



Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

**De:** Steffan Romay Robertsson <[steffan.romay@hospiten.com](mailto:steffan.romay@hospiten.com)>  
**Enviado el:** viernes, 7 de marzo de 2025 10:01  
**Para:** Gara Fernández Hernández <[gara.fernandez@hospiten.com](mailto:gara.fernandez@hospiten.com)>  
**Asunto:** RV: Sol. Alta Mat. FIJACION DE CATETER PERIFIX Ref. 4511200

Buenos días Gara.

Reenvío respuesta de la compañera de quirófano sobre la cuestión planteada.

Saludos


---


**Steffan Romay Robertsson**  
Responsable Dpto. de Compras Hospiten Roca

---



Construyendo un ecosistema  
de bienestar alrededor de  
las personas



 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

---

**De:** Sandra Fleitas Sánchez <[sandra.fleitas@hospiten.com](mailto:sandra.fleitas@hospiten.com)>  
**Enviado:** viernes, 7 de marzo de 2025 9:46  
**Para:** Steffan Romay Robertsson <[steffan.romay@hospiten.com](mailto:steffan.romay@hospiten.com)>  
**Asunto:** RE: Sol. Alta Mat. FIJACION DE CATETER PERIFIX Ref. 4511200

Buenos días,

Antes estos catéteres se fijaban con un apósito normal de vías.

El apósito que están pidiendo es más seguro y específico de dicho catéter que va colocado en la columna sin riesgo a que se descoloque.

Saludos.


---


**Sandra Fleitas Sánchez**  
Hospiten Roca

---



Construyendo un ecosistema  
de bienestar alrededor de  
las personas



 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

---

**De:** Steffan Romay Robertsson <[steffan.romay@hospiten.com](mailto:steffan.romay@hospiten.com)>

**Enviado:** viernes, 7 de marzo de 2025 7:31

**Para:** Sandra Fleitas Sánchez <[sandra.fleitas@hospiten.com](mailto:sandra.fleitas@hospiten.com)>

**Cc:** María Correa <[maria.correa@hospiten.com](mailto:maria.correa@hospiten.com)>

**Asunto:** RV: Sol. Alta Mat. FIJACION DE CATETER PERIFIX Ref. 4511200

Buenos días Sandra.

Desde la central precisan respuesta para el alta del material FIJACIÓN DE CATATER PERIFIX. Si conoces el material de uso actual, con que me pases el SAP es suficiente. De lo contrario, necesitamos que la Dra. nos indique como ha estado solucionando el problema hasta ahora.


Saludos


---

**Steffan Romay Robertsson**  
Responsable Dpto. de Compras Hospiten Roca



Construyendo un ecosistema  
de bienestar alrededor de  
las personas



 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.



**De:** Gara Fernández Hernández <[gara.fernandez@hospiten.com](mailto:gara.fernandez@hospiten.com)>

**Enviado:** jueves, 6 de marzo de 2025 13:40

**Para:** Steffan Romay Robertsson <[steffan.romay@hospiten.com](mailto:steffan.romay@hospiten.com)>; Jose Manuel Jorge Pérez <[josemanuel.jorge@hospiten.com](mailto:josemanuel.jorge@hospiten.com)>

**Cc:** María Correa <[maria.correa@hospiten.com](mailto:maria.correa@hospiten.com)>

**Asunto:** RE: Sol. Alta Mat. FIJACION DE CATETER PERIFIX Ref. 4511200

Hola Steffan buenos dias

Con respecto a esta solicitud necesitamos por favor código sap del material de uso actual, o como se ha estado solventando hasta el momento cuando un paciente a requerido de dicho material

Saludos


---

**Gara Fernández Hernández**

Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department



Construyendo un ecosistema  
de bienestar alrededor de  
las personas



Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

---

**De:** Steffan Romay Robertsson <[steffan.romay@hospiten.com](mailto:steffan.romay@hospiten.com)>

**Enviado el:** martes, 4 de marzo de 2025 7:24

**Para:** Jose Manuel Jorge Pérez <[josemanuel.jorge@hospiten.com](mailto:josemanuel.jorge@hospiten.com)>; Gara Fernández Hernández <[gara.fernandez@hospiten.com](mailto:gara.fernandez@hospiten.com)>

**CC:** Vicente Díaz <[vicente.diaz@hospiten.com](mailto:vicente.diaz@hospiten.com)>; Mohamed Fariña Molina <[MFARINAM@hospiten.com](mailto:MFARINAM@hospiten.com)>; María Correa <[maria.correa@hospiten.com](mailto:maria.correa@hospiten.com)>

**Asunto:** Sol. Alta Mat. FIJACION DE CATETER PERIFIX Ref. 4511200

Buenos días.

Solicitamos el alta de FIJACIÓN DE CATETER PERIFIX con Ref. 4511200 de BRAUN

Se adjunta:

- Solicitud de alta de material.
- Ficha técnica.

**Almacenes: 12AD y 12QU**

Muchas gracias.

Saludos


---

**Steffan Romay Robertsson**  
Responsable Dpto. de Compras Hospiten Roca


---

 **Hospiten**

Construyendo un ecosistema  
de bienestar alrededor de  
las personas

 **Hospiten**



 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.



OFERTA  
03/2025/1/4644

B. Braun Medical SA  
Carretera de Terrassa, 121  
Dirección Postal: Apartado 6  
E-08191 Rubí (Barcelona)  
Tel.: 935866200\*  
Fax: 935881096

Su referencia:

ATN. .

Haga referencia en sus comunicaciones:

HOSPITAL RAMBLA SLU  
(Compras)  
Rb Santa Cruz, 115  
38001 Santa Cruz de Tenerife  
STA. CRUZ TENERIFE

Referencia: 03/2025/1/4644  
Fecha oferta: 06/03/2025  
Válida hasta: 04/06/2025  
Su contacto: Yolanda De Miguel  
Anestesia (01)  
628942008

Cod. Prod	Denominación Producto	Presentación	Caja/Ud	Precio
4511200	FIJACION DE CATETER PERIFIX	ca/25	Unidad	3,000

Aplica a toda la oferta:

Impuestos NO Incluidos


Vigencia: desde 01/02/2025 hasta 31/01/2026

Und

BORRADOR

# Fijación de Catéter Perifix®

Seguridad y confort para sus pacientes

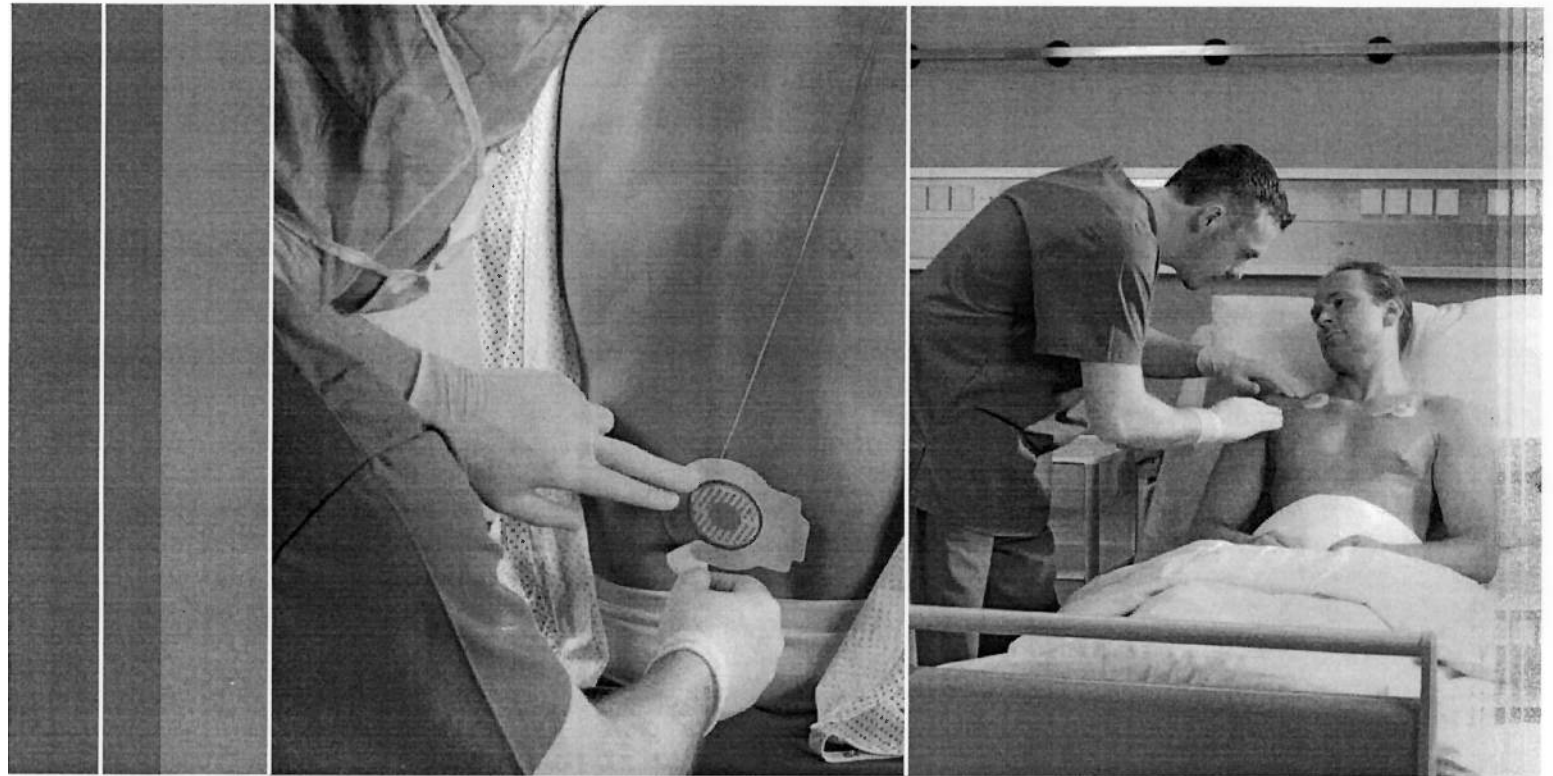

Anestesia Regional

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

# Fijación de Catéter Perifix®

El anillo de fijación está diseñado para fijar firmemente el catéter a la piel del paciente sin causar irritación. Combina la facilidad en su manejo con la seguridad del catéter, evitando riesgos de movilización o migración del mismo.

El apósito adhesivo externo está formado por un cuerpo central transpirable (no adhesivo) y una lámina exterior circular, adhesiva y transparente.

El cuerpo central transpirable permite alejar la humedad del lugar de punción, a la vez que examinar fácilmente el catéter. La lámina circular adhesiva ofrece un adecuado sellado y protección del punto de punción, a la vez que permite cambiar fácilmente el apósito sin riesgo de movilización por desplazamiento del anillo de fijación.




Gracias a las características y prestaciones del sistema de fijación de catéter Perifix® el examen del punto de punción se lleva a cabo de forma fácil y sencilla.

Con un diseño plano, al igual que el resto de componentes Perifix®, se asegura el máximo nivel de confort para sus pacientes.



Anillo de fijación

Apósito adhesivo externo

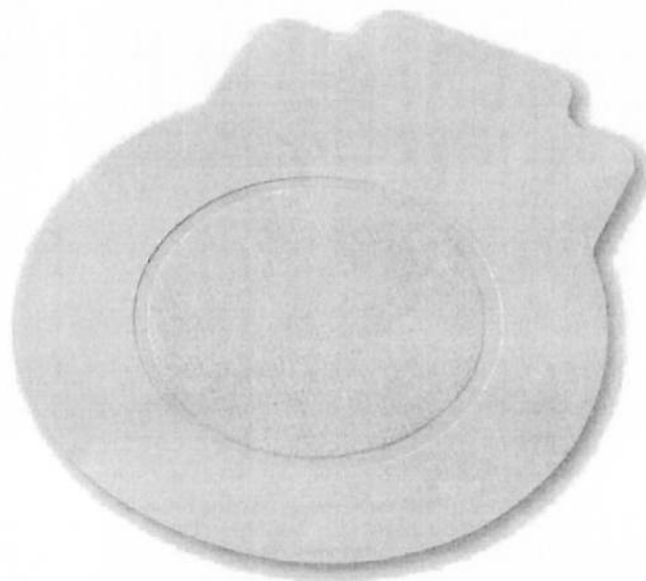

## Ventajas

### Anillo de fijación

- fácil y segura fijación evitando la migración del catéter.


### Apósito adhesivo externo

- adecuada protección del punto de punción
- parte central no adhesiva con anillo transpirable
- fácil de cambiar sin riesgo de movilización por desplazamiento.


Descripción	Referencia	Ud. venta
Fijación de Catéter Perifix®	4511200	c/25

# Fijación de Catéter Perifix®


La manera fácil y segura de fijar un catéter

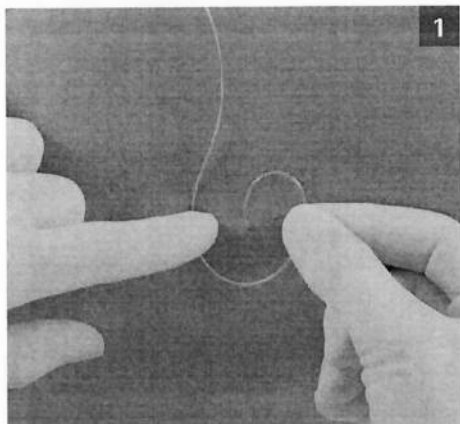


1 Caracolear el catéter alrededor del punto de punción.

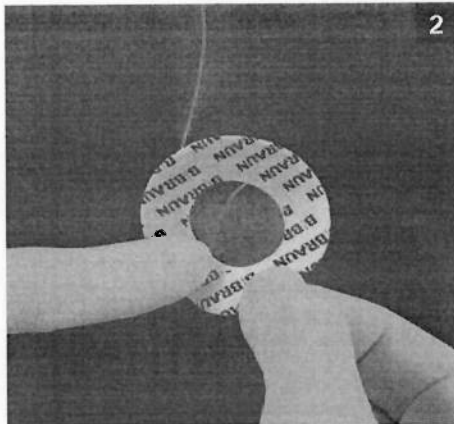


2 Pegar el anillo de fijación por encima del catéter de forma que el punto de punción quede centrado.

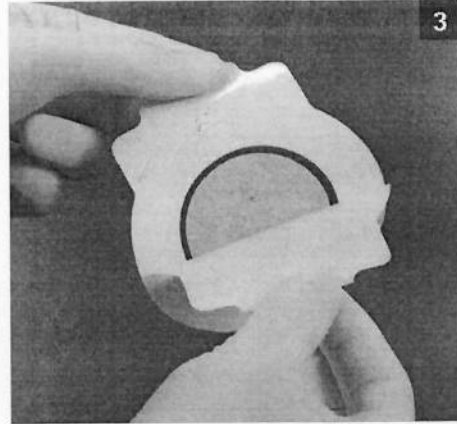


3 Despegar la lámina protectora del apósito adhesivo externo.

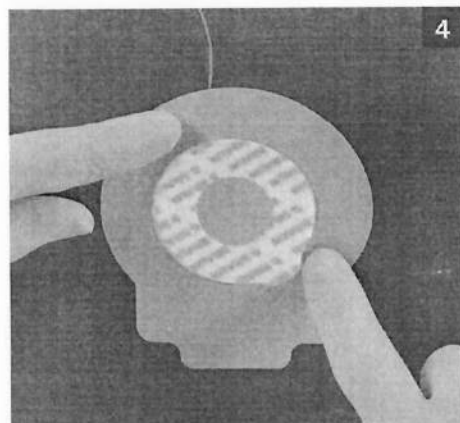


4 Pegar el apósito adhesivo, centrado, por encima del anillo de fijación.

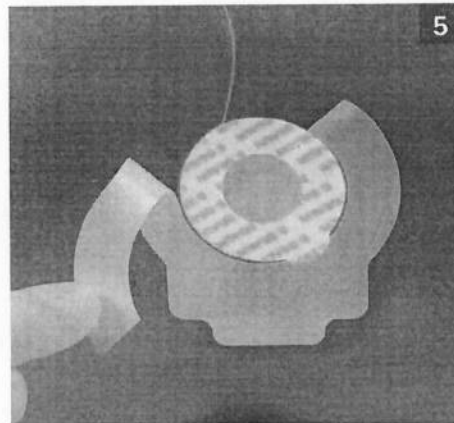

5 Buscar el corte del papel de la parte superior del apósito y estirar circularmente desde su punta.

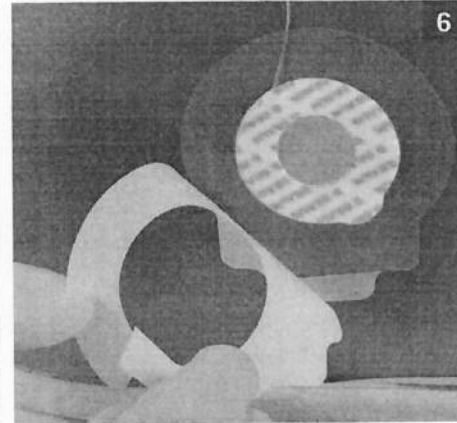

6 Terminar de retirar la cubierta superior del apósito.

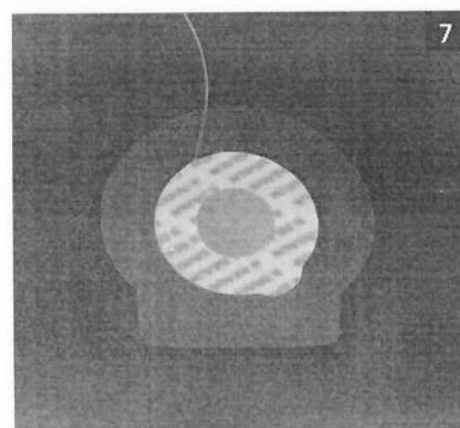

7 El punto de punción queda debidamente protegido y controlado visualmente.

## Ventajas

### Anillo de fijación

- fácil y segura fijación evitando la migración del catéter.

### Apósito adhesivo externo

- adecuada protección del punto de punción
- parte central no adhesiva con anillo transpirable
- fácil de cambiar sin riesgo de movilización por desplazamiento.



**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

## FIJACIÓN DE CATETER PERIFIX®

La fijación de catéter Perifix® es un sistema de fijación de catéteres asociados a los bloqueos continuos de las diferentes disciplinas de la anestesia regional.

Está formado por dos componentes: un anillo de fijación y el apósito adhesivo externo.

El anillo de fijación formado por espuma y un adhesivo acrílico hipoalergénico.

- Está diseñado para fijar firmemente el catéter a la piel de los pacientes sin causar irritación.
- Es cómodo, fácil de manipular, ergonómico y evita riesgos de movilización o migración del catéter.
- Su diseño plano al igual que Perifix® PinPad y el filtro Perifix® aseguran un máximo nivel de confort de los pacientes.

El apósito adhesivo externo presenta dos partes:

- Un cuerpo central transpirable (no adhesivo) que permite alejar la humedad del lugar de punción y examinar fácilmente el catéter y la punción
- Una lámina circular adhesiva transparente, externa al cuerpo central, que permite un adecuado sellado y protección del punto de punción, a la vez que cambiar fácilmente el apósito sin riesgo de movilización del catéter por desplazamiento del anillo.


Es apto para usar tanto en adultos como en pediatría.

Producto exento de látex.

Código de producto: 4511200

Envase unitario estéril

Unidad de venta: c/25

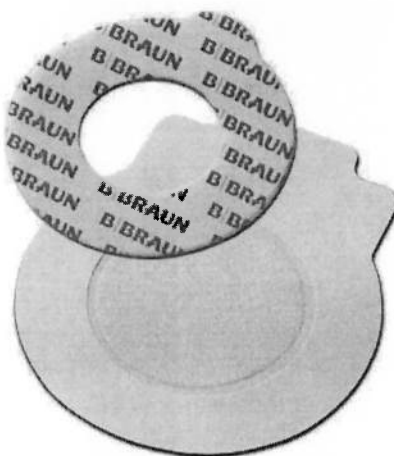



## EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III  
(Class I Devices in sterile condition, with measuring function or reusable surgical instruments)

**No. G11 012974 0626 Rev. 10**

**Manufacturer:** **B. Braun Melsungen AG**  
Carl-Braun-Str. 1  
34212 Melsungen  
GERMANY

SRN Manufacturer - DE-MF-000000201

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the manufacturer has established, documented and implemented a quality management system as described in Article 10 (9) of the Regulation (EU) 2017/745 on medical devices. Details on device categories covered by the quality management system are described on the following page(s).

The Report referenced below summarises the result of the assessment and includes reference to relevant CS, harmonized standards and test reports. The conformity assessment has been carried out according to Annex IX Chapter I and III of this regulation with a positive result. As applicable the involvement of the notified body is limited to the aspects relating to:

- establishing, securing and maintaining sterile conditions,
- conformity of the devices with the metrological requirements,
- reuse of the device, in particular cleaning, disinfection, sterilization, maintenance and functional testing and the related instructions for use.

The certified quality management system is subject to periodical surveillance by TÜV SÜD Product Service GmbH.

All applicable requirements of the Testing, Certification, Validation and Verification Regulations TÜV SÜD Group have to be complied with.

For details and certificate validity see: [www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G11 012974 0626 Rev. 10](http://www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G11_012974_0626_Rev.10)

**Report No.:** 713311455  
**Preceding Certificate No.:** G11 012974 0626 Rev. 09  
**Valid from:** 2024-10-07  
**Valid until:** 2026-12-14  
**Date of Initial Issuance:** 2021-12-15

Christoph Dicks  
Head of Certification/Notified Body

**Issue date:** 2024-10-07



## EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III  
 (Class I Devices in sterile condition, with measuring function or reusable surgical instruments)

**No. G11 012974 0626 Rev. 10**

**Classification:** Class I  
**Device Group:** A020102 - INFUSION AND IRRIGATION SYRINGES, SINGLE-USE  
**Device Properties:** MDS 1005.1 - Ethylene Oxide sterilization  
 MDS 1010 - Devices with a measuring function

**Classification:** Class I  
**Device Group:** A060304 - INTRA-OPERATION FLUID COLLECTION DEVICES  
**Device Properties:** MDS 1005.1 - Ethylene Oxide sterilization

**Classification:** Class I  
**Device Group:** M040102 - FIXING DRESSINGS  
**Device Properties:** MDS 1005.1 - Ethylene Oxide sterilization

**Classification:** Class I  
**Device Group:** A020101 - LOSS-OF-RESISTANCE SYRINGES  
**Device Properties:** MDS 1005.1 - Ethylene Oxide sterilization

**Classification:** Class I  
**Device Group:** A070501 - CAPS OR OBTURATORS, NON-PERFORABLE  
**Device Properties:** MDS 1005.1 - Ethylene Oxide sterilization

**Classification:** Class I  
**Device Group:** A020299 - REUSABLE SYRINGES - OTHER  
**Device Properties:** MDS 1010 - Devices with a measuring function

**Classification:** Class I  
**Device Group:** A020108 - ENTERAL FEEDING SYRINGES  
**Device Properties:** MDS 1005.1 - Ethylene Oxide sterilization  
 MDS 1010 - Devices with a measuring function

**Classification:** Class I  
**Device Group:** A0704 - SYSTEMS FOR RECONSTITUTION AND ADMINISTRATION OF PHARMACEUTICALS  
**Device Properties:** MDS 1005.1 - Ethylene Oxide sterilization  
 MDS 1005.2 - Sterilisation by irradiation





## EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III  
 (Class I Devices in sterile condition, with measuring function or reusable surgical instruments)

**No. G11 012974 0626 Rev. 10**

**Classification:** Class I  
**Device Group:** A030101 - INFUSION CONTROLLERS  
**Device Properties:** MDS 1005.1 - Ethylene Oxide sterilization  
 MDS 1005.2 - Sterilisation by irradiation  
 MDS 1010 - Devices with a measuring function

**Classification:** Class I  
**Device Group:** A010104 - NEEDLES FOR VIAL COLLECTION  
**Device Properties:** MDS 1005.1 - Ethylene Oxide sterilization

**Classification:** Class I  
**Device Group:** A040101 - ADMINISTRATION AND ASPIRATION FILTERS  
**Device Properties:** MDS 1005.1 - Ethylene Oxide sterilization

**Classification:** Class I  
**Device Group:** A020106 - INSULIN SYRINGES, SINGLE-USE  
**Device Properties:** MDS 1005.1 - Ethylene Oxide sterilization  
 MDS 1010 - Devices with a measuring function

**Classification:** Class I  
**Device Group:** A019001 - BLUNT NEEDLES  
**Device Properties:** MDS 1005.1 - Ethylene Oxide sterilization

**Classification:** Class I  
**Device Group:** A030103 - ENTERAL FEEDING CONTROLLERS  
**Device Properties:** MDS 1005.1 - Ethylene Oxide sterilization

**Classification:** Class I  
**Device Group:** A0199 - NEEDLES - OTHER  
**Device Properties:** MDS 1005.1 - Ethylene Oxide sterilization

**Classification:** Class I  
**Device Group:** A060301 - COLLECTION BAGS AND OTHER CONTAINERS  
 FOR DRAINAGES AND FISTULAS, SINGLE USE  
**Device Properties:** MDS 1005.1 - Ethylene Oxide sterilization



Benannt durch/Designated by  
 Zentralstelle der Länder  
 für Gesundheitsschutz  
 bei Arzneimitteln und  
 Medizinprodukten  
 www.zlg.de  
 BS-MDR-099



Product Service

## EU Quality Management System Certificate (MDR)

Pursuant to Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapters I and III  
 (Class I Devices in sterile condition, with measuring function or reusable surgical instruments)

**No. G11 012974 0626 Rev. 10**

**Classification:** Class I  
**Device Group:** A060303 - URINE COLLECTION SYSTEMS AND BAGS,  
 SINGLE-USE  
**Device Properties:** MDS 1005.1 - Ethylene Oxide sterilization  
 MDS 1010 - Devices with a measuring function

The validity of this certificate -  
 depends on conditions and/or  
 is limited to the following:

### Revision History:

Rev.	Dated	Report	Description
00	2021-12-15	713207236	-
01	2022-10-25	713230661	-
02	2023-03-29	713279829	Supplemented: Device(s)/group of device(s) added
03	2023-06-06	713282404	Supplemented: Device(s)/group of device(s) added
04	2023-06-08	713300468 / 713300479	Supplemented: Device(s)/group of device(s) added
05	2023-09-22	713270138	Supplemented: Device(s)/group of device(s) added
06	2023-10-27	713307156	Supplemented: Device(s)/group of device(s) added
07	2024-02-14	713315087 / 713316915 / 713316918 / 713316911 / 713316917 / 713316913	Supplemented: Device(s)/group of device(s) added
08	2024-04-19	713330451 / 713330449 / 713317014	Supplemented: Device(s)/group of device(s) added
09	2024-09-05	713339659	Supplemented: Device(s)/group of device(s) added
10	2024-10-07	713311455	Supplemented: Device(s)/group of device(s) added

## Gara Fernández Hernández

---

**De:** Yolanda de Miguel Hernández <yolanda.de\_miguel@bbraun.com>  
**Enviado el:** jueves, 6 de marzo de 2025 16:55  
**Para:** Gara Fernández Hernández  
**Asunto:** Re: SOLICITUD PPTO GRUPO HOSPITEN MUY URGENTE  
**Datos adjuntos:** Oferta-BERNENES464406-03-2025-15-48-58.pdf; Fijación de catéter PERIFIX 4511202.pdf

**AVISO: Este correo es externo a la organización. No acceda a enlaces o descargue adjuntos salvo que conozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.**

Buenas tardes  
Te adjunto información solicitada

Yolanda de Miguel  
Delegada de Anestesia y Nutrición  
BBraun Medical (Critical Care)  
628942008

---

**De:** Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>  
**Enviado:** Thursday, March 6, 2025 2:44:32 PM .  
**Para:** Jesús Gaviño Serrano <jesus.gavino@bbraun.com>; Yolanda de Miguel Hernández <yolanda.de\_miguel@bbraun.com>  
**Asunto:** SOLICITUD PPTO GRUPO HOSPITEN MUY URGENTE

**CAUTION:** This email originated from outside the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Hola buenos días

Ruego que por favor, nos haga llegar en la mayor brevedad posible, la siguiente información que a continuación pasó a detallar para el Grupo Hospiten.

- 1- Ficha Técnica o Catalogo.
- 2- Certificado Registro Sanitario de dicho material.
- 3 Certificados CE, de calidad, medido Ambiente y/o seguridad, dependiendo del tipo de producto o material.
- 4- Vigencia Tarifa como mínimo 31 de Diciembre 2025
- 5- Los precios a presentar en este Departamento Central, deberán ser precios puestos en la puerta del hospital. Se entiende como precios puestos en la puerta del hospital, con impuestos, transportes, aduanas, etc.. incluidos.
- 6- Presupuesto del siguiente material que a continuación paso a detallar:

FIJACIÓN DE CATETER PERIFIX 4511200

Gracias.

---

**Gara Fernández Hernández**  
Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department

---

Avenida Marítima, 3  
38003 Santa Cruz de Tenerife  
Islas Canarias Spain  
T (+34) 922 629 470


hospiten.com

An advertisement banner for Hospiten. On the left, white text on a dark background reads "Cirugía Endoscópica de Columna" and "Mínimamente invasiva, máxima recuperación". Below this, it says "Decidete. Es el momento de recuperar tu calidad de vida." and the Hospiten logo. On the right, a black and white photograph shows a person's hands holding their lower back, indicating pain or injury.

Cirugía Endoscópica de Columna  
Mínimamente invasiva, máxima recuperación

Decidete.  
Es el momento de recuperar tu calidad de vida.



 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

Este correo y cualquier archivo enviado con él son confidenciales y exclusivamente para el uso de la persona a quien va dirigida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique y proceda a su destrucción. Todas las opiniones que se presentan son exclusivamente de su autor y no representan necesariamente las de Hospiten Gestión A.I.E. La publicación no autorizada, uso, difusión, transmisión, impresión o copia de este mensaje de correo electrónico y sus archivos adjuntos está estrictamente prohibida. En cumplimiento de la normativa de protección de datos, le informamos que los datos relativos al destinatario del presente correo son tratados por parte de Hospiten Gestión A.I.E. con fines de contacto profesional basado en el interés legítimo para el mantenimiento de la relación entre remitente y destinatario. Los datos se conservarán mientras se mantenga dicha relación y no se solicite su supresión y, en su caso, durante los plazos legales de aplicación). Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito, adjuntando copia del DNI o documento identificativo al Responsable, en la dirección Plaza 25 de julio, Apartado de correos 10681, 38004 Santa Cruz de Tenerife, o mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: [protecciondedatos@hospiten.com](mailto:protecciondedatos@hospiten.com), adjuntando copia de DNI u otro documento identificativo, así como a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos: [www.aepd.es](http://www.aepd.es)).

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you have received this email in error please send it back to the person that sent it to you. Any views or opinions presented are solely those of its author and do not necessarily represent those of Hospiten Gestión A.I.E. Unauthorized publication, use, dissemination, forwarding, printing or copying of this email and its associated attachments is strictly prohibited.

## Gara Fernández Hernández

**De:** Gara Fernández Hernández  
**Enviado el:** lunes, 10 de marzo de 2025 12:20  
**Para:** Lorenz Galán  
**CC:** Steffan Romay Robertsson; Jose Manuel Jorge Pérez  
**Asunto:** RV: Sol. Alta Mat. FIJACION DE CATETER PERIFIX Ref. 4511200  
**Datos adjuntos:** SOLICITUD ALTA FIJACION CATETER PERIFIX.xlsx

Hola buenos días

En el día de hoy se ha dado autorización para la creación del siguiente material en Hospiten Roca ( se ha revisado la base de datos de Hospiten y el material de uso actual es un sistema totalmente diferente al que requiere el centro , este sistema es nuevo en nuestra base de datos)

ALMACEN: 12AD Y 12QU

Centro Solicitante: HOSPITEN ROCA				PROPUESTA INCLUSA	
PROVEEDOR				BRAUN MEDICAL	
				COSTE	
SAP	DENOMINACION	RFA	PREST	CAJA	UNIDAD
CREAR	APOSITO FIJACION CATETER ANESTESIA EPIDURAL	4511200	25	75,00 €	
VIGENCIA TARIFA 31/12/2025					
PRECIOS SIN EL 3% DE IGIC					

El Centro Hospitalario se responsabilizará que dicho material sea facturado al paciente y/o Entidad Aseguradora Pública o Privada, con especial atención a pacientes de Entidades Aseguradoras las cuales requieran consentimiento y autorización previa antes de su uso o aplicación.

Si el paciente es asegurado de Entidades quienes tienen acuerdos con proveedores, previamente la Dirección o Administración del Hospital deberá verificar las marcas y/o proveedores homologados por la Entidad. En caso de que el paciente pertenezca a Entidades Aseguradoras Públicas o Privadas con quienes tengamos "Tarifa de Prestación Cerrada", antes de dar conformidad la Dirección del Hospital deberá analizar el coste del material junto con la tarifa de prestación.

Saludos

---

**De:** Vicente Díaz <vicente.diaz@hospiten.com>  
**Enviado el:** viernes, 7 de marzo de 2025 12:36  
**Para:** Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>  
**CC:** Mohamed Fariña Molina <MFARINAM@hospiten.com>; Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>; Steffan Romay Robertsson <steffan.romay@hospiten.com>  
**Asunto:** RE: Sol. Alta Mat. FIJACION DE CATETER PERIFIX Ref. 4511200

Conforme.