

Centro Solicitante: Hospiten Rambla

PROPUESTA INCLUSION

PROVEEDOR

MEDICAL CANARIAS

PRECIO

SAP DENOMINACION

RFA

PREST

CAJA

UNIDAD

CREAR	FILTRO DESECHABLE P/ASPIRADOR MOD.ATMOS S351	443.0738.0	10	165,00 €	16,50 €
-------	--	------------	----	----------	---------

VIGENCIA TARIFA 31/12/2015

COMERCIANTE MINORISTA EXENTO IGIC.

MATERIAL EQUIVALENTE DE USO ACTUAL

SAP

DENOMINACION

PROVEEDOR

RFA

TARIFA PRESTACION

El Centro Hospitalario se responsabilizará que dicho material sea facturado al paciente y/o Entidad Aseguradora Pública o Privada, con especial atención a pacientes de Entidades Aseguradoras las cuales requieran consentimiento y autorización previa antes de su uso o aplicación.

Si el paciente es asegurado de entidades quienes tienen acuerdos con proveedores, previamente la Dirección o Administración del Hospital deberá verificar las marcas y/o proveedores homologados por la Entidad.

En caso que el paciente pertenezca a Entidades Aseguradora Públicas o Privadas con quienes tengamos "Tarifa de Prestación Cerrada", antes de dar conformidad la Dirección del hospital deberá analizar el coste del material junto con la tarifa de prestación.

GRUPO: Material Registro y Diagnóstico.

CLASE: Material para Diagnóstico.

CARACTERISTICAS: Instrumental Diagnóstico Desechable.

Informe y/o Gestión realizada por:

José Manuel Jorge Pérez.

Fdo.....



CONFORME  
DPTO. COMPRAS CENTRAL HOSPITEN

Fecha: 01/12/15  
D. José Ignacio Juanes

Centro Solicitante: Hospiten Rambla

PROVEEDOR

PROPUESTA INCLUSION

PROPUESTA INCLUSION

MEDICAL CANARIAS  
PRECIO  
CAJA UNIDAD

ATMOS  
PRECIO  
CAJA UNIDAD

SAP DENOMINACION

RFA

PREST

RFA

PREST

SAP	DENOMINACION	RFA	PREST	CAJA	UNIDAD	RFA	PREST	CAJA	UNIDAD
CREAR	FILTRO DESECHABLE P/ASPIRADOR MOD.ATMOS S351	443.0738.0	10	165,00 €	16,50 €	443.0738.0	10	250,00 €	25,00 €

### MODELO 1. ADMISIÓN DE NUEVOS MATERIALES

#### PROPUESTA DE NUEVO MATERIAL HOSPITALARIO PARA SU INCLUSIÓN EN LA GUÍA HOSPITALARIA DE HOSPITEN

1. Nombre material: filtro desechable
2. Nombre comercial: filtro bacteriano desechable referencia 443.0738.0
3. Laboratorio: ATMOS
4. Presentación: unidades
5. Aplicación: filtra las bacterias en el momento de la succión ( Ventosa)
6. Descripción del producto: filtro
7. Reséñese la acción diagnóstica/terapéutica principal y el uso terapéutico del material que justifique su inclusión: recogida de bacterias a la hora de aspirar
8. Materiales de uso actual en Hospiten: no lo tenemos
9. Razones clínicas por las cuales este material es superior a los citados anteriormente: es un material de nuevo uso incorporado a un aparataje nuevo en el servicio
10. ¿Qué materiales considera usted podrían retirarse de la Guía reseñados anteriormente? ninguno

FECHA: 29-10-2015

Fdo.: Dr.

  
Dr. ROSENDO MILVAN GARCIA,  
INTECORTISTA ORTODONTICO,  
Especialista en Ortodoncia y Ortognatodisciplina

  
VoBo  
Dr. Miguel Ángel  
DENTODIAGNÓSTICO  
Especialista en Ortodoncia

**Jose Manuel Jorge Pérez**

---

**De:** Lourdes Marrero  
**Enviado el:** martes, 03 de noviembre de 2015 9:45  
**Para:** Jose Manuel Jorge Pérez; Víctor Rodríguez González  
**CC:** Inmaculada Bolaños  
**Asunto:** 425 FILTRO DESECHABLE 443.0738.0  
**Datos adjuntos:** 425 FILTRO DESECHABLE 443.0738.0.pdf

Presupuesto Nº 271/15  
MEDICAL CANARIAS, S.A.  
Esperanto, Edif. Daniel 2  
39280 Tegueste (Tenerife)  
Teléfono: (922) 54.48.53  
Fax: (922) 54.49.53  
E-Mail: [medicalcanarier@intercom.es](mailto:medicalcanarier@intercom.es)

A: HOSPITEN GESTIÓN  
D. JOSE MANUEL JORGE

Fecha: 13/11/15  
Tema: Presupuesto: FILTROS BACTERIANOS

**NCR13/11/15**

Estimado Señor,

En relación a su solicitud de presupuesto de los filtros bacterianos , ref. 443.0738.0 ,  
enviamos , presentación , plazo de entrega y precio de los mismos:

Referencia	Descripción	Importe Unitario(€)
443.0738.0	Filtro bacteriano desechable ,no autoclavable para aspirador Atmos Record 55 , Atmos S 351	16,50

**Nota: pedido mínimo 10 unidades**

Plazo de entrega: 2 semanas

Validez de la oferta : hasta el 31 de diciembre de 2015  
COMERCIANTE MINORISTA EXENTO DE IGIC

Atentamente,

MEDICAL CANARIAS S.A.

## Jose Manuel Jorge Pérez

---

**De:** Damián Pérez [dp@medicalcanarias.com]  
**Enviado el:** viernes, 13 de noviembre de 2015 11:18  
**Para:** Jose Manuel Jorge Pérez  
**Asunto:** RV: SOLICITUD PPTO GRUPO HOSPITEN MUY URGENTE  
**Datos adjuntos:** S\_351\_Natal\_spanisch.pdf; FILTROS BACTERIANOS PARA ASPIRADOR ATMOS (11-11-15).docx

Buenos días Jose Manuel,

Disculpa el retraso pero no tenía cotización del fabricante (Atmos).

Te adjunto oferta y catálogo (en la primera página puede verse el filtro solicitado y en la página 6 la referencia con la descripción).

Un saludo,

**Damián Pérez**  
**Movil: 686 949702**  
**E-mail: [dp@medicalcanarias.com](mailto:dp@medicalcanarias.com)**  
**MEDICAL CANARIAS S.A.**  
**TELF: +34 922 544853**  
**FAX : +34 922 544953**

*Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario, quedando prohibida según la legislación vigente la utilización o divulgación sin autorización. Por ello, si por error ha recibido este correo, comuníquenoslo inmediatamente por esta misma vía y proceda a destruirlo.*

*En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, Medical Canarias S.A. le informa que sus datos han sido incorporados a un fichero automatizado con la finalidad de prestar y ofrecer nuestros servicios. Los datos recogidos serán almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con empresas ni entidades ajenas a Medical Canarias S.A. Si considera conveniente, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a través de una comunicación escrita dirigida a C/Olof Palme 31, bajo, 35010 Las Palmas de Gran canaria.*

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en tu mano

---

**De:** Jose Manuel Jorge Pérez [mailto:[josemanuel.jorge@hospiten.com](mailto:josemanuel.jorge@hospiten.com)]  
**Enviado el:** martes, 10 de noviembre de 2015 13:02

**Para:** Damián Pérez; Medical Canarias

**Asunto:** SOLICITUD PPTO GRUPO HOSPITEN MUY URGENTE

Buenos días

Ruego que por favor, nos haga llegar en la mayor brevedad posible, la siguiente información que a continuación pasó a detallar para el Grupo Hospiten.

- 1- Estimación Entrega.
- 2- Presentación.
- 3- Ficha Técnica o Catalogo.
- 4- Registro Sanitario.
- 5- Vigencia Tarifa como mínimo 31 de Diciembre 2015.
- 6- Los precios a presentar en este Departamento Central, deberán ser precios puestos en la puerta del hospital. Se entiende como precios puestos en la puerta del hospital, con impuestos, transportes, aduanas, etc.. incluidos.
- 7- Cotización del siguiente material que a continuación paso a detallar:

**FILTRO DESECHABLE (FILTRO BACTERIANO DESECHABLE RFA 443.0738.0)**

Saludos Cordiales.  
José Manuel Jorge  
Responsable Fungible y Prótesis.

**Jose Manuel Jorge Pérez**  
Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department



Avenida Marítima, 3  
38003 Santa Cruz de Tenerife  
Islas Canarias. España

T (+34) 922 629 470  
F (+34) 922 622 203

[www.hospiten.com](http://www.hospiten.com)



**Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.**

Este correo y cualquier archivo enviado con él son confidenciales y exclusivamente para el uso de la persona a quien va dirigida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor envíelo de vuelta a la persona que se lo envió a usted. Todas las opiniones que se presenten son exclusivamente de su autor y no representan necesariamente las de Hospiten Gestión A.I.E. La publicación no autorizada, uso, difusión, transmisión, impresión o copia de este mensaje de correo electrónico y sus archivos adjuntos está estrictamente prohibida.

En cumplimiento de la normativa de protección de datos, le informamos de que sus datos personales forman parte de un fichero propiedad de Hospiten Gestión A.I.E y son tratados con la única finalidad de mantenimiento de la relación adquirida con usted. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a Plaza 25 de julio. Apartado de correos 10681. Santa Cruz de Tenerife. 38004, o a través del correo electrónico SOLICITUDES\_ARCO@HOSPITEN.COM.

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you have received this email in error please send it back to the person that sent it to you. Any views or opinions presented are solely those of its author and do not necessarily represent those of Hospiten Gestión A.I.E. Unauthorized publication, use, dissemination, forwarding, printing or copying of this email and its associated attachments is strictly prohibited.

## **Jose Manuel Jorge Pérez**

---

**De:** Inmaculada Bolaños  
**Enviado el:** viernes, 27 de noviembre de 2015 10:28  
**Para:** Jose Manuel Jorge Pérez  
**CC:** Lourdes Marrero  
**Asunto:** RV: SOLICITUD FILTRO DESECHABLE P/ASPIRADOR MOD. ATMOS S351

Buenos días,

Remitimos conformidad de gerencia.

Saludos,

**De:** Alicia Fernaud Alberto  
**Enviado el:** viernes, 27 de noviembre de 2015 10:27  
**Para:** Inmaculada Bolaños  
**CC:** Lourdes Marrero  
**Asunto:** RE: SOLICITUD FILTRO DESECHABLE P/ASPIRADOR MOD. ATMOS S351

Buenos días;  
Por mi parte de acuerdo.  
Un saludo,  
Alicia

**De:** Inmaculada Bolaños  
**Enviado el:** jueves, 26 de noviembre de 2015 18:08  
**Para:** 'Alicia Fernaud Alberto'  
**CC:** Lourdes Marrero  
**Asunto:** RV: SOLICITUD FILTRO DESECHABLE P/ASPIRADOR MOD. ATMOS S351

Alicia, te agradecería que cuando puedas revises esta solicitud puesto que la esta reclamando el servicio.

Gracias y saludos,

**De:** Jose Manuel Jorge Pérez  
**Enviado el:** viernes, 13 de noviembre de 2015 12:42  
**Para:** Lourdes Marrero; Inmaculada Bolaños  
**Asunto:** RV: SOLICITUD FILTRO DESECHABLE P/ASPIRADOR MOD. ATMOS S351

Buenos días  
Adjunto correo a efectos de vuestro conocimiento e información.

### **Observaciones:**

Por favor, se requiere la información que se detalla en mi correo del día 10 de Noviembre, además del número de pedido y año de la compra del nuevo Aspirador compra por Inversión.

Saludos Cordiales.  
José Manuel Jorge  
Responsable Fungible y Prótesis.

**De:** Jose Manuel Jorge Pérez  
**Enviado el:** viernes, 13 de noviembre de 2015 12:41  
**Para:** Alicia Fernaud Alberto  
**Asunto:** SOLICITUD FILTRO DESECHABLE P/ASPIRADOR MOD. ATMOS S351

Buenos días

Adjunto solicitud por parte del Servicio de Ginecología y Dr. Arriaga junto con ppto y estudio económico de lo solicitado (FILTRO DESECHABLE P/ASPIRADOR MOD. ATMOS S351) para su consideración y conformidad como responsable económico del Centro.

**Observaciones:**

Por favor, se requiere la información que se detalla en mi correo del día 10 de Noviembre, además del número de pedido y año de la compra del nuevo Aspirador compra por Inversión.

Ruego su conformidad para proceder a la autorización por parte de la Dirección de Compras.

Muchas gracias.

Saludos Cordiales.

José Manuel Jorge

Responsable Fungible y Prótesis.

**De:** Jose Manuel Jorge Pérez

**Enviado el:** martes, 10 de noviembre de 2015 12:58

**Para:** Lourdes Marrero; Inmaculada Bolaños

**Asunto:** RV: 425 FILTRO DESECHABLE 443.0738.0

Buenos días

En función de la solicitud que hemos recibido en el Departamento, respecto al material que se detalla en fichero adjunto (FILTRO DESECHABLE RFA 443.0738.0), necesitamos que nos hagan llegar la siguiente información que paso a detallar a continuación:

- Código Sap del material de uso actual, o bien que técnica se emplea por el material solicitado.
- En el caso de que realmente no estemos empleando nada al respecto por el material solicitado. Necesitamos que nos indiquen como estamos recibiendo el problema en el hospital cuando realmente es necesario el material solicitado.

Muchas gracias.

Saludos Cordiales.

José Manuel Jorge

Responsable Fungible y Prótesis.

**De:** Lourdes Marrero

**Enviado el:** martes, 03 de noviembre de 2015 9:45

**Para:** Jose Manuel Jorge Pérez; Víctor Rodríguez González

**CC:** Inmaculada Bolaños

**Asunto:** 425 FILTRO DESECHABLE 443.0738.0

## **Jose Manuel Jorge Pérez**

---

**De:** Lourdes Marrero  
**Enviado el:** Viernes, 13 de noviembre de 2015 13:08  
**Para:** Jose Manuel Jorge Pérez  
Inmaculada Bolaños  
**CC:**  
**Asunto:** RV: SOLICITUD FILTRO DESECHABLE P/ASPIRADOR MOD. ATMOS S351

Te adjunto información del servicio, saludos

---

**De:** Ana Betty Torres Díaz  
**Enviado el:** viernes, 13 de noviembre de 2015 13:00  
**Para:** Lourdes Marrero  
**Asunto:** RE: SOLICITUD FILTRO DESECHABLE P/ASPIRADOR MOD. ATMOS S351

Hola buenos días, a día de hoy tenemos en el servicio ATMOS S 351 Natal, es un nuevo aparataje en nuestro departamento por lo que solicito los filtros de recambio , se usarían por cada paciente que tengamos que usar la Ventosa.

Anteriormente no usábamos dicho filtro ya que el aparato anterior no lo requería.  
Muchas gracias.  
Un saludo.

---

**From:** Lourdes Marrero  
**Sent:** Fri 11/13/2015 12:58 PM  
**To:** Ana Betty Torres Díaz  
**Cc:** Inmaculada Bolaños  
**Subject:** RV: SOLICITUD FILTRO DESECHABLE P/ASPIRADOR MOD. ATMOS S351

**De:** Jose Manuel Jorge Pérez  
**Enviado el:** viernes, 13 de noviembre de 2015 12:42  
**Para:** Lourdes Marrero; Inmaculada Bolaños  
**Asunto:** RV: SOLICITUD FILTRO DESECHABLE P/ASPIRADOR MOD. ATMOS S351

Buenos días  
Adjunto correo a efectos de vuestro conocimiento e información.

### **Observaciones:**

Por favor, se requiere la información que se detalla en mi correo del día 10 de Noviembre, además del número de pedido y año de la compra del nuevo Aspirador compra por Inversión.

Saludos Cordiales.  
José Manuel Jorge  
Responsable Fungible y Prótesis.

---

**De:** Jose Manuel Jorge Pérez  
**Enviado el:** viernes, 13 de noviembre de 2015 12:41  
**Para:** Alicia Fernaud Alberto  
**Asunto:** SOLICITUD FILTRO DESECHABLE P/ASPIRADOR MOD. ATMOS S351

Buenos días  
Adjunto solicitud por parte del Servicio de Ginecología y Dr. Arriaga junto con ppto y estudio económico de lo solicitado (FILTRO DESECHABLE P/ASPIRADOR MOD. ATMOS S351) para su consideración y conformidad como responsable económico del Centro.

### **Observaciones:**

Por favor, se requiere la información que se detalla en mi correo del día 10 de Noviembre, además del número de pedido y año de la compra del nuevo Aspirador compra por Inversión.

Ruego su conformidad para proceder a la autorización por parte de la Dirección de Compras.

Muchas gracias.

Saludos Cordiales.

José Manuel Jorge

Responsable Fungible y Prótesis.

---

**De:** Jose Manuel Jorge Pérez

**Enviado el:** martes, 10 de noviembre de 2015 12:58

**Para:** Lourdes Marrero; Inmaculada Bolaños

**Asunto:** RV: 425 FILTRO DESECHABLE 443.0738.0

Buenos días

En función de la solicitud que hemos recibido en el Departamento, respecto al material que se detalla en fichero adjunto (FILTRO DESECHABLE RFA 443.0738.0), necesitamos que nos hagan llegar la siguiente información que paso a detallar a continuación:

- Código Sap del material de uso actual, o bien que técnica se emplea por el material solicitado.
- En el caso de que realmente no estemos empleando nada al respecto por el material solicitado. Necesitamos que nos indiquen como estamos recibiendo el problema en el hospital cuando realmente es necesario el material solicitado.

Muchas gracias.

Saludos Cordiales.

José Manuel Jorge

Responsable Fungible y Prótesis.

---

**De:** Lourdes Marrero

**Enviado el:** martes, 03 de noviembre de 2015 9:45

**Para:** Jose Manuel Jorge Pérez; Víctor Rodríguez González

**CC:** Inmaculada Bolaños

**Asunto:** 425 FILTRO DESECHABLE 443.0738.0

## **Jose Manuel Jorge Pérez**

---

**De:** Ana Betty Torres Diaz  
**Enviado el:** viernes, 27 de noviembre de 2015 9:45  
**Para:** Jose Manuel Jorge Perez; Lourdes Marrero; Inmaculada Bolaños  
**Asunto:** RE: 424 FILTRO DESECHABLE

Hola buenos dias, confirmo la referencia del material solicitado : Filtro de la entrada de aire ; Protege de particulas superiores a 0'5 , venta por unidades, referencia MU04472.

Anteriormente no se utilizaba este material ya que no teniamos una Incubadora de este calibre , con lo que no teniamos codigo SAP.

EL aparataje que hoy tenemos en el Servicio necesita el cambio mensual de dicho filtro que estamos solicitando.

Atentamente : Ana Betty.

---

**De:** Jose Manuel Jorge Pérez  
**Enviado el:** mar 10/11/2015 12:37  
**Para:** Lourdes Marrero; Inmaculada Bolaños  
**Asunto:** RV: 424 FILTRO DESECHABLE

Buenos días  
Necesitamos que nos indiquen si la referencia MU04472 es la que realmente necesitan del Filtro Desechable solicitado, muchas gracias.

Saludos Cordiales.  
José Manuel Jorge  
Responsable Fungible y Prótesis.

---

**De:** Jose Manuel Jorge Pérez  
**Enviado el:** lunes, 09 de noviembre de 2015 13:58  
**Para:** Lourdes Marrero; Inmaculada Bolaños  
**Asunto:** RV: 424 FILTRO DESECHABLE

Buenos días

En función de la solicitud que hemos recibido en el Departamento, respecto al material que se detalla en fichero adjunto (FILTRO DESECHABLE), necesitamos que nos hagan llegar la siguiente información que paso a detallar a continuación:

- Referencia del Filtro que se solicita.
- Código Sap del material de uso actual, o bien que técnica se emplea por el material solicitado.
- En el caso de que realmente no estemos empleando nada al respecto por el material solicitado. Necesitamos que nos indiquen como estamos recibiendo el problema en el hospital cuando realmente es necesario el material solicitado.
- Detalle y/o mayor detalle del equipo que necesita el material solicitado.

Muchas gracias.

Saludos Cordiales.  
José Manuel Jorge  
Responsable Fungible y Prótesis.

---

**De:** Lourdes Marrero  
**Enviado el:** martes, 03 de noviembre de 2015 9:42  
**Para:** Jose Manuel Jorge Pérez; Víctor Rodríguez González  
**CC:** Inmaculada Bolaños  
**Asunto:** 424 FILTRO DESECHABLE



## **Jose Manuel Jorge Pérez**

---

**De:** Inmaculada Bolaños

**Enviado el:** viernes, 27 de noviembre de 2015 9:26

**Para:** Jose Manuel Jorge Pérez; Lourdes Marrero

**CC:** Ana Betty Torres Diaz

**Asunto:** RE: 425 FILTRO DESECHABLE 443.0738.0

**Datos adjuntos:** filtros atmos.pdf

Buenos días Jose,

Tras hablar con Betty supervisora de paritorio comentarte que:

- No hay código SAP porque es una máquina nueva
- Se usaba otro aparato que no tenía filtros.
- En este caso son varios filtros, los cuales están compuestos por las referencias:
  - . Filtro bacteriano desechable ref 443.0738.0
  - . Depósito de seguridad ref 444.0646.0
  - . Filtro bacteriano desechable 2 ref 340.0054.0

Adjuntamos hoja del manual en el que aparecen.

Pongo a Betty en copia por si quiere añadir algo.

Saludos,

**De:** Jose Manuel Jorge Pérez

**Enviado el:** martes, 10 de noviembre de 2015 12:58

**Para:** Lourdes Marrero; Inmaculada Bolaños

**Asunto:** RV: 425 FILTRO DESECHABLE 443.0738.0

Buenos días

En función de la solicitud que hemos recibido en el Departamento, respecto al material que se detalla en fichero adjunto (FILTRO DESECHABLE RFA 443.0738.0), necesitamos que nos hagan llegar la siguiente información que paso a detallar a continuación:

- Código Sap del material de uso actual, o bien que técnica se emplea por el material solicitado.
- En el caso de que realmente no estemos empleando nada al respecto por el material solicitado. Necesitamos que nos indiquen como estamos recibiendo el problema en el hospital cuando realmente es necesario el material solicitado.

Muchas gracias.

Saludos Cordiales.

José Manuel Jorge

Responsable Fungible y Prótesis.

**De:** Lourdes Marrero

**Enviado el:** martes, 03 de noviembre de 2015 9:45

**Para:** Jose Manuel Jorge Pérez; Víctor Rodríguez González

**CC:** Inmaculada Bolaños

**Asunto:** 425 FILTRO DESECHABLE 443.0738.0

## 9.0

# Piezas de recambio y accesorios



### 9.2 Accesorios

#### 9.2.1 Depósitos

Descripción	REF
Depósito de secreciones vidrio, graduado, 1,5 l	444.0032.0
Tapa para depósito de secreciones*	444.0015.0
Boquilla doble para tapa del depósito (Incluso reductor de tubo 10/6 mm)*	444.0012.0
Filtro en línea	443.0738.0

#### 9.2.2 Accesorios para facilitar el manejo

Descripción	REF
Soporte pequeño de plástico blanco para fijar tubos	444.0450.0
Carro para obstetricia (Kit, sin posibilidad de integrar el seguro electrónico contra el rebose)	320.0070.0
Pedal regulador electrónico, impermeable IPX8 protección AP	444.0452.0

#### 9.2.3 Combinación de filtro

Configuración estándar:	
Filtros bacterianos, desechables:	443.0738.0
Version desechable alternativa: Recomendada como protección de sobrellenado para otras intervenciones quirúrgicas.	
Depósito de seguridad completo, incl. adaptador para filtro bacteriano:	444.0646.0
Filtros bacterianos, desechables:	340.0054.0



# PRESUPUESTO 227

Fecha: 10-11-15  
Agencia: ATMOS Mataro d  
Almacén: ATMOS Mataro d

## ATMOS MEDICA, S.L.

CIF/NIF: B42023289  
Torrent de la Prega,ta. 27  
Mataró  
08304 Barcelona  
Tel: 937193580  
atmos@atmosmed.es

Fax: 937414672

## CLIENTE 003801 CLINICA DEL SUR S.L.U

CIF/NIF: B38031241  
HOSPITEN GESTION - AV. MARITIMA 3  
SANTA CRUZ DE TENERIFE  
38003 Sta. Cruz de Tenerife  
Tel.: Fax  
Juan pedro

### CONCEPTOS

Ref.	Descripción	Cantidad	Precio	% Dto.	% IVA	Total
442 DT3111	Filtro bacteriano, desech., R55 S 351	1,0	25,00	21,0		25,00

### DESCUENTOS

% Dcto. Esp.      % Dcto. P.P.

### I.V.A.

% IVA      Total IVA  
21,0      5,25

### TOTALES

Portes      0,00  
TOTAL Euro      30,25

FORMA DE PAGO: 785D ES9621000379910200221870

**Jose Manuel Jorge Pérez**

---

**De:** Rovira Palaez, Montse [M.Rovira@atmosmed.es]  
**Enviado el:** martes, 10 de noviembre de 2015 14:18  
**Para:** Jose Manuel Jorge Pérez  
**Asunto:** RV: SOLICITUD PPTO GRUPO HOSPITEN MUY URGENTE  
**Datos adjuntos:** PPTO227 HOSPITEN.pdf; S\_351\_Natal\_spanisch.pdf

**Importancia:** Alta

Buenos Días,

Adjunto la camifirras Ppto. del materia solicitado:

Tenga en cuenta que se han añadido los 12,00 EUR. que es el importe mínimo.  
Con lo que para cantidades superiores el precio se reduciría.

La presentación del material es unitaria, y al ser un material desechable no tiene ficha técnica.

Le adjuntamos catalogo donde pueden encontrar Referencia, y descripción (Pág. 6).  
La Ilustración de puede ver en la Pag. 1 (Filtro 443.07380.0 conectado al tubo del equipo)

Plazo de entrega: 5-7 días.

Saludos cordiales,

Montse Rovira  
ATMOS MEDICA, S.L.  
C/ Torrent d'en Pregonia, 27  
08304 Melard (Barcelona)  
Tel. 0034 902193590  
Fax 0034 937414672  
mrovira@atmosmed.es  
[www.atmosmed.es](http://www.atmosmed.es)

Tiempos para  
una nueva perspectiva



 **ATMOS® iView**  
— El sistema perfecto  
para ver y trabajar



**De:** Jose Manuel Jorge Pérez [mailto:[josemanuel.jorge@hospiten.com](mailto:josemanuel.jorge@hospiten.com)]  
**Enviado el:** martes, 10 de noviembre de 2015 14:03  
**Para:** Rovira, Montse; Daniel  
**Asunto:** RV: SOLICITUD PPTO GRUPO HOSPITEN MUY URGENTE  
**Importancia:** Alta

Buenos días  
Ruego que por favor, me pueda llegar en la mayor brevedad posible, la siguiente información que a continuación pasó a detallar para el Grupo Hospitalar.

- 1- Estimación Entrega.
- 2- Presentación.
- 3- Ficha Técnica o Catálogo.
- 4- Registro Sanitario
- 5- Vigencia Tarifa como mínimo 31 de Diciembre 2015.
- 6- Los precios e presentar en este Departamento Central, deberán ser precios puestos en la puerta del hospital. Se entenderá como precios puestos en la puerta del hospital, con impuestos, transportes, aduanas, etc.. incluidos.
- 7- Cotización del siguiente material que a continuación paso a detallar:

**FILTRO DESECHABLE (FILTRO BACTERIANO DESECHABLE RFA 443.0738.0)**

Saludos Cordiales

José Manuel Jorge

Responsable Función y Protosis.

José Manuel Jorge

Dirección General de Asesoramiento del Compras y Purchasing Department



Agencia Promotora  
del Hospital de la Universidad  
de Las Palmas de Gran Canaria

AVDA. DE LAS PALMAS  
157, 35010 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA




**NOTA DE IMPORTANCIA: Responda de que es necesario**

Este correo electrónico y cualquier archivo adjunto que él contiene son propiedad de la persona a quien va dirigida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor no debe copiar, redistribuir o usar la información que se le proporciona en este correo electrónico. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, por favor no debe copiar, redistribuir o usar la información que se le proporciona en este correo electrónico. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, por favor no debe copiar, redistribuir o usar la información que se le proporciona en este correo electrónico.

En virtud de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de Información al Consumidor, se informa de que los datos de contacto de esta persona forman parte de un fichero propiedad de Hospiten Gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación o supresión de los datos de contacto de esta persona en el domicilio de Hospiten Gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 38004, o a través del correo electrónico [atencioncliente@hospiten.com](mailto:atencioncliente@hospiten.com).

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you have received this message in error, please notify the system manager. This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you have received this message in error, please notify the system manager. This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you have received this message in error, please notify the system manager.

**Equipos especiales de control electrónico y  
equipos universales de aspiración de alto  
rendimiento para ginecología y obstetricia**

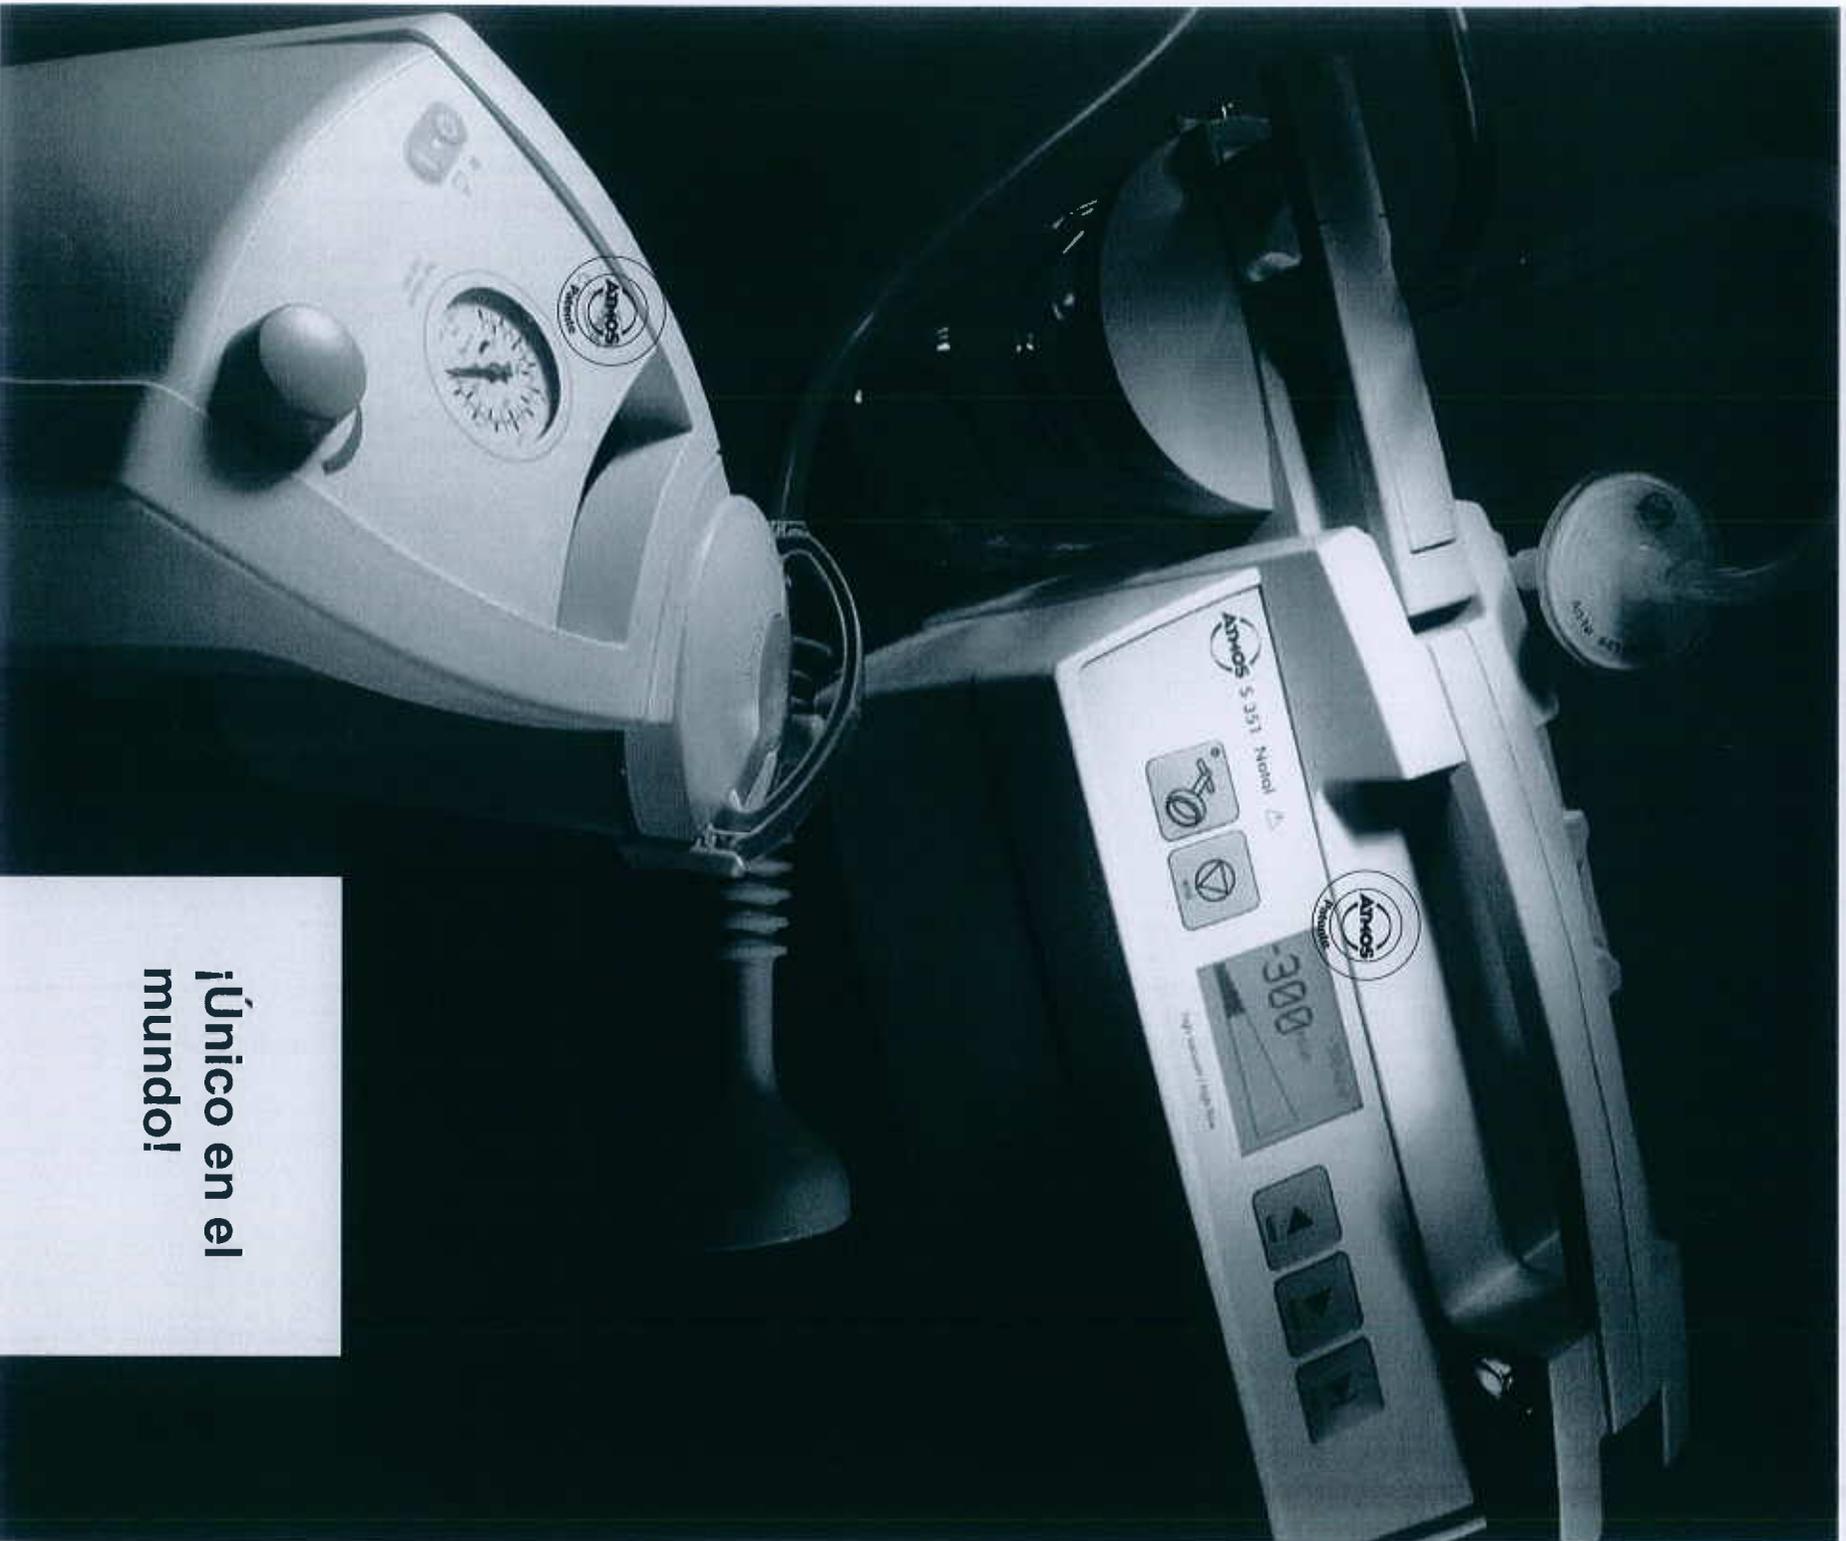

**¡Único en el  
mundo!**

# Equipo con control electrónico especial para extracción de vacío y ginecología

## ¿Qué es importante durante el parto?

Durante los últimos 35 años se ha incrementado el número de cesáreas, mientras que ha decrecido el número de partos por ventosa o fórceps. No obstante, en algunos casos es necesario el uso de estos dos últimos sistemas.

Con la **disminución del uso de estas técnicas también disminuye la experiencia del personal, de ahí que, un sistema sencillo de usar sea muy importante.**



ATMOS satisface el deseo de los ginecólogos con un **proceso de extracción por vacío, seguro y completamente automático.**

A diferencia del uso de fórceps donde se requiere una experiencia para no provocar traumas ni a la madre ni al niño, la aplicación de la extracción por vacío es rápida y fácil.

### Ventajas de la extracción por vacío:

El tiempo del parto con la copa de extracción viene a durar unos **6 minutos**, en cambio con los fórceps viene siendo de 15 a 20 minutos. El motivo de esta **mayor rapidez** radica que el vacío puede ser aplicado cuando el bebé se encuentra todavía en el fondo del canal.

Comparado con la cesárea, el sistema de succión nos **ahorra tiempo y dinero**, es decir, menor tiempo en quirófano, menor tiempo de hospitalización y tratamiento. En definitiva el proceso es mucho más natural.

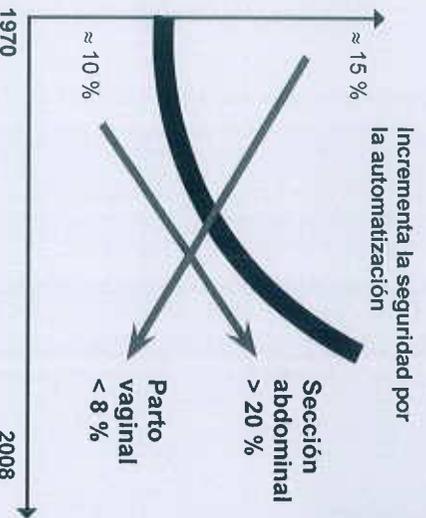

**10** Opcionalmente disponible:  
Set VE (Extracción de vacío) con pedal regulador y sistema de depósitos DDS.



**9** Tecnología de membrana de alto rendimiento, Generación de vacío y potencia de aspiración.

# Equipo con control electrónico especial para extracción de vacío y ginecología

## ¿Qué es importante durante el parto?

Durante los últimos 35 años se ha incrementado el número de cesáreas, mientras que ha decrecido el número de partos por ventosa o fórceps. No obstante, en algunos casos es necesario el uso de estos dos últimos sistemas.

Con la disminución del uso de estas técnicas también disminuye la experiencia del personal, de ahí que, un sistema sencillo de usar sea muy importante.



ATMOS satisface el deseo de los ginecólogos con un **proceso de extracción por vacío, seguro y completamente automático.**

A diferencia del uso de fórceps donde se requiere una experiencia para no provocar traumas ni a la madre ni al niño, la aplicación de la extracción por vacío es rápida y fácil.

### Ventajas de la extracción por vacío:

El tiempo del parto con la copa de extracción viene a durar unos **6 minutos**, en cambio con los fórceps viene siendo de 15 a 20 minutos. El motivo de esta **mayor rapidez** radica que el vacío puede ser aplicado cuando el bebé se encuentra todavía en el fondo del canal.

Comparado con la cesárea, el sistema de succión nos **ahorra tiempo y dinero**, es decir, menor tiempo en quirófano, menor tiempo de hospitalización y tratamiento. En definitiva el proceso es mucho más natural.

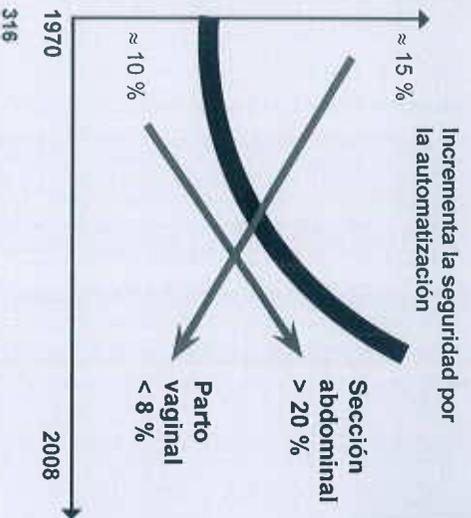

10

Opcionalmente disponible:  
Set VIE (EXtracción de vacío) con pedal regulador y sistema de depósitos DDS.



9

Tecnología de membrana de alto rendimiento. Generación de vacío y potencia de aspiración.

# Innovador y con control electrónico – ATMOS S 351 Natal ATMOS C 451 – potente y de fácil manejo



Medizintechnik

## ATMOS S 351 Natal



**1** Vacío y automatización con parámetros pre-seleccionables reducen errores en la aplicación.



**2** Pantalla de alta resolución con indicación de vacío deseado/real así como tiempo de generación y reducción de vacío



**3** Opcionalmente disponible, pedal regulador para la generación-reducción de vacío.



**4** El control electrónico asegura el máximo rendimiento con el mínimo ruido.



**5** El vacío con sensor monitorizado, el filtro bacteriano con indicación de cambio de filtro, y el control electrónico de sobrellenado derivan en un trabajo seguro con un fácil manejo.



## ATMOS C 451



**6** Botón de regulación de vacío sin pérdidas con protección para prevenir el derrame de líquidos



**7** Sin tubos, simple conexión del depósito de secreciones a la unidad con el sistema patentado ATMOS DDS (Direct Docking System).




**8** De fácil limpieza, moderno diseño y con un amplio y preciso vacuómetro.


## ATMOS S 351 Natal Sets de usuario

- ATMOS S 351 Natal
- Sets de usuario
  - Accesorios
  - Consumibles

- El vacío automático evita errores
- Máxima seguridad incluso en situaciones complicadas gracias al sensor de vacío monitorizado
- Máxima seguridad unida a un fácil manejo
- ¡Único en el mundo!

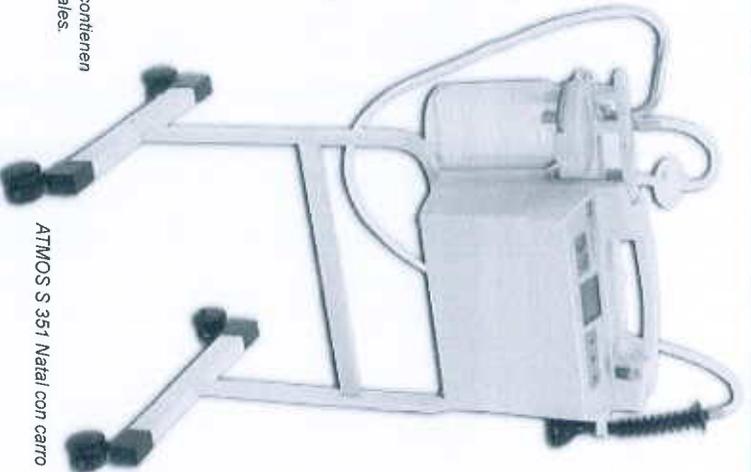

ATMOS S 351 Natal con carro

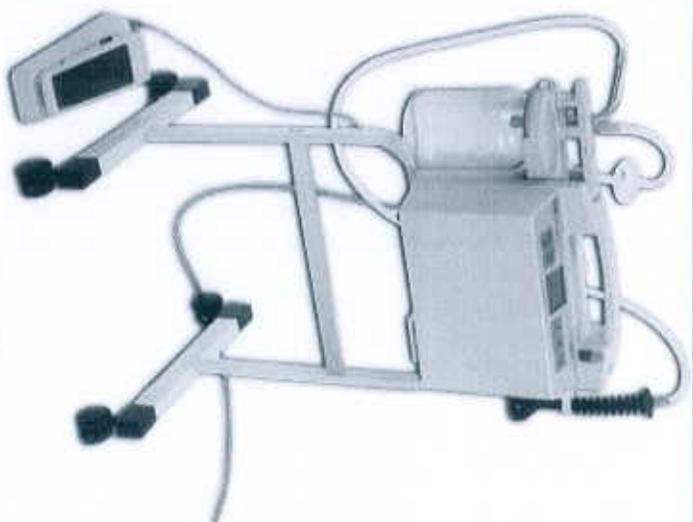

ATMOS S 351 Natal con carro y pedal regulador

Estas imágenes contienen funciones opcionales.

### El equipo especial controlado por microprocesador, para partos con ventosas de extracción, curetaje, y aspiración del tracto respiratorio

REF

#### Sets montados para Vd.

##### ATMOS S 351 Natal con carro

444.0481.0

Unidad para extracción de vacío controlada por microprocesador para partos con ventosas de extracción, también indicada para la liberación del tracto respiratorio, curetaje de succión y para mamas obstruidas. Generación y reducción de vacío automática, con parámetros de libre preselección, filtro bacteriano hidrofobo con indicador en caso de necesidad de cambio, control electrónico del nivel de llenado con protección anti-rebose, pre-selección de vacío con sólo pulsar un botón, display de alta resolución con indicación del vacío deseado / actual valores en mbar o kPa y temporizador con señal acústica.

Rendimiento de la bomba: 36± 2 l/min, vacío -90 kPa/-675mmHg. Accesorios: Depósito plástico 1,5 l (PSU) incl. tapa y boquilla doble, filtro en línea, tubo para ventosas de extracción (Verde), porta-tubos, 230 V ± 10 %, 50-60 Hz. Dimensiones (Al x An x F): 840 x 490 x 520 mm Set con carro Ref. 320.0070.0

##### ATMOS S. 351 Natal con carro y pedal

444.0482.0

Unidad para extracción de vacío controlada por microprocesador para partos con ventosas de extracción, también indicada para la liberación del tracto respiratorio, curetaje de succión y para mamas obstruidas. Generación y reducción de vacío automática, con parámetros de libre preselección, filtro bacteriano hidrofobo con indicador en caso de necesidad de cambio, control electrónico del nivel de llenado con protección anti-rebose, pre-selección de vacío con sólo pulsar un botón, display de alta resolución con indicación del vacío deseado / actual valores en mbar o kPa y temporizador con señal acústica.

Rendimiento de la bomba: 36± 2 l/min, vacío -90 kPa/675mmHg. Accesorios: Depósito plástico 1,5 l (PSU) incl. tapa y boquilla doble, filtro en línea, tubo para ventosas de extracción (Verde), porta-tubos, 230 V ± 10 %, 50-60 Hz. Dimensiones (Al x An x F): 840 x 490 x 520 mm. Set con carro y pedal.



## Accesorios para ATMOS S 351 Natal

Equipo de  
aspiración  
con control  
electrónico



Accesorios para ATMOS S 351 Natal		REF
① Carro con ruedas antiestáticas		444.0020.0
Rail estándar carro		444.0440.0
② Pedal de control electrónico, impermeable protección IPX 8, AP		444.0452.0
③ Tapa con soporte para rail estándar con electrodo sobrellenado y anti-salpicaduras		444.0015.0
Set de boquilla doble formado por boquilla doble y reductor de tubo		444.0012.0
Depósito 1,5 l, polisulfono, esterilizable a 136°C		444.0036.0



### Accesorios para extracción de vacío



④ Copa extracción (Malmström) esterilizable y autoclavable, Ø 40 mm, con empuñadura en cruz		404.0155.0
⑤ Copa extracción (Malmström) esterilizable y autoclavable, Ø 50 mm, con empuñadura en cruz		404.0156.0
⑥ Copa extracción (Malmström) esterilizable y autoclavable, Ø 60 mm, con empuñadura en cruz		404.0157.0



⑦ ATMOS-Copa extracción Silk silicona, esterilizable, Ø 50 mm		404.0194.0
⑧ ATMOS-Copa extracción Silk silicona, esterilizable, Ø 60 mm		404.0193.0



Accesorios para aspiración tracto respiratorio con ATMOS S 351 Natal	
Catéter aspiración, "Unomedical <sup>®</sup> ", CH 12 (blanco Ø 4 mm), recto, 1 apertura central, 2 aperturas laterales, long.: 50 cm, conector Ø 8 mm, (parte desechable esterilizada, no autoclavable), precio para 100 Uds.	000.0294.0
Catéter aspiración, "Unomedical <sup>®</sup> ", CH 14 no autoclavable, (verde Ø 4,7 mm) como el CH 12	000.0295.0
Catéter aspiración, "Unomedical <sup>®</sup> ", CH 16 no autoclavable, (naranja Ø 5,3 mm) como el CH 12	000.0296.0

## Accesorios y Consumibles para ATMOS S 351 Natal

ATMOS S 351 Natal

- Consumibles
- Equipo básico



REF

Accesorios para ATMOS S 351 Natal	REF
<b>Filtro bacteriano</b> desechable, no autoclavable, para ATMOS Record 55, ATMOS S 351. Cambio: 1 x por paciente	<b>443.0738.0</b>
<b>Tubo de extracción (Verde)</b> Ø 6.5 mm, precio por metro	<b>006.0010.0</b>
<b>Tubo de extracción (Verde), Ø 6.5 mm, L = 1.5 m</b>	<b>404.0146.0</b>
<b>Tubo de aspiración</b> silicona, Ø 10 mm, L = 2 m, (136°C) Cambio: después de 20 autoclaves	<b>000.0243.0</b>
<b>Tubo de aspiración</b> silicona, Ø 6 mm, L = 1.30 m, (136°C)	<b>000.0013.0</b>
<b>Empalme, finger tip</b> esterilizado, no autoclavable, precio unitario. Cambio: 1 x por paciente, con el mismo paciente: después de 2 o 3 días	<b>000.0347.0</b>
<b>Empalme, finger tip</b> esterilizado, no autoclavable, precio para 100 Uds. Cambio: 1 x por paciente, con el mismo paciente: después de 2 o 3 días	<b>000.0347.1</b>
<b>① Reductor de tubo</b> (a Ø 6 mm) para boquilla doble, autoclavable	<b>444.0013.1</b>
<b>② Colector de tejidos</b> , 300 ml desechable, no autoclavable. Cambio: 1 x por paciente	<b>340.0061.0</b>
<b>③ Colector de tejidos</b> , desechable, no autoclavable, 50 ml, para análisis con curetaje de abortos. Cambio: 1 x por paciente	<b>401.0555.0</b>
<b>④ ATMOS S 351 Natal</b>	<b>444.0490.0</b>

Unidad de aspiración controlada por microprocesador con display gráfico LCD, con indicación de vacío seleccionado/actual. Especialmente indicado para partos con ventosas de extracción, liberación del tracto respiratorio y curetaje de succión. Generación y reducción de vacío automático, preselección con botón, filtro bacteriano con indicación de cambio, control electrónico sobrellenado, indicación de vacío en mbar o kPa y temporizador con señal acústica. Rendimiento de la bomba 36 ± 2 l/min, vacío -90 kPa/-675mmHg. Accesorios: Depósito 1.5 l (Plástico), tapa y boquilla doble, filtro en línea, tubo verde para copas de extracción, porta-tubos 230 V ± 10 %, 50-60 Hz. Dimensiones (Al x An x F): 300 x 330 x 200 mm

ATMOS S 351 Natal equipo básico  
Estas imágenes contienen  
funciones opcionales



Las especificaciones técnicas son válidas en el momento de la impresión, y están sujetas a cambios.

Datos técnicos	ATMOS S 351 Natal
Rendimiento de la bomba:	36 ± 2 l/min
Vacío máx. a nivel del mar:	-90 kPa (-900 mbar / -675 mmHg)
Consumo:	máx. 135 W
Voltaje:	230 V ~ 50 Hz; voltaje especial : 115 V ~ 50/60 Hz
Funcionamiento:	Operación continua
Nivel acústico:	43,9 dB (A) @ 1m (Según ISO 7779)
Dimensiones (Al x An x F):	300 x 330 x 200 mm, sin carro; 840 x 490 x 520 mm, con carro
Peso:	10,2 kg; sin depósito ni carro
Clasificaciones:	Clase Prot. I; Grado de prot. Tipo B; Categoría de prot.: IPIX0; Clase: IIb. (Según apéndice IX 93/42/EEC)

Doc.compr.	Cl.	Soc. Proveedor	Nombre 1	OrgC	GCP	Fecha doc.	InPerVal	FinPerVal	CPag						
Pos.	Material	Texto breve		Nº material proveedor			Ctd.prev.	UMP	Prc.neto	Mon.	Cnt.UMA	UMB	Prc.net.A1	Mon.	Grupc
4600000701	WK	H005 11011	ATMOS MEDICA, S.L.	OC3	FAR	16.09.2005	16.09.2005	31.12.9999	ZP18						
10	941100	TUBO VERDE EXTRACC. 6.5MM LONG 1.5	40401460				1	UN	12,56	EUR	1	UN	12,56	EUR	C03

# Hospiten

HOSPITEN RAMBLA (Clinicas del Sur S.L.U.)  
Rambla de Santa Cruz, 115, Santa Cruz de Tenerife. (Tenerife)  
Teléfono: 922291600

R23/15  
80506396

## PEDIDO

Núm. pedido/fecha  
4500441538 / 13.07.2015  
Persona de contacto  
Rosario Dorta  
Nuestro número de identificación de IVA  
ESB38031241

MEDICAL CANARIAS, S.A.  
Esperanto, s/n Edificio Daniel, 2 Ca  
38280 Tegueste-SANTA CRUZ DE TENERIF  
Teléfono 922 544853  
Fax 922 544953

Proveedor: 30153

Cond.pago: Pagaré a cliente veinte dias Moneda: EUR

NUMERO OFERTA: 0181/15

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

ENVIAR EL MATERIAL A HOSPITEN RAMBLA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS A/A DE  
LOURDES MARRERO  
RAMBLA DE SANTA CRUZ N°115-38001 S/C DE TENERIFE

FACTURAR A: CLINICAS DEL SUR S.L.U. C.I.F.:B-38031241 RAMBLA DE SANTA CRUZ  
N°115-38001 S/C DE TENERIFE

Pos	Código	Descripción	Ref. Orig	Un	UMF	U/C	Prec. Unl	Bruto Total	Dcto	IGIC	Total
010	976128	ASPIRADOR QUIRURGICO S351 NATAL	444.0430.0	1	UN	1	4550,00	4.550,00	0,00%	0,00%	4550,00
020	976129	PEDAL CONTROL	444.0432.0	1	UN	1	587,00	587,00	0,00%	0,00%	587,00

Valor bruto total sin IGIC EUR 5137,00  
Descuento sobre bruto total 0,00%  
Valor neto total con IGIC 5137,00

### RESERVACIONES:

LAS IMPORTACIONES EN CANARIAS DEBEN REALIZARSE A NOMBRE DEL PROPIO PROVEEDOR COMO "SUJETO PASIVO" DE LA IMPORTACION.

SI EL PROVEEDOR NO TUVIERA "ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN CANARIAS" Y /O "ALTA DE ACTIVIDAD EN CANARIAS", Y TUVIERA QUE REALIZAR LA IMPORTACION EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL "CLIENTE" QUE SERIA CUALQUIERA DE LAS SOCIEDADES FISCALES DEL GRUPO HOSPITEN, ES REQUISITO IMPRESCINDIBLE PARA LIBERAR, EL PAGO AL PROVEEDOR LA PRESENTACION DE LA FACTURA COMERCIAL JUNTO CON LA DOCUMENTACION ADUANAL Y LA CARTA DE PAGO DEL IMPUESTO LIQUIDADO. **MODELO 032** EN CUYO CASO LA BASE IMPONIBLE LIQUIDADA DEBE DE COINCIDIR CON EL IMPORTE DE LA FACTURA COMERCIAL EMITIDA POR EL PROVEEDOR A CUALQUIERA DE LAS **SOCIEDADES FISCALES DE HOSPITEN EN CANARIAS.**

ROGAMOS DEN INSTRUCCIONES A SU TRANSPORTISTA PARA QUE ENTREGUEN EN EL CENTRO, JUNTO A LA MERCANCIA, COPIA DE LA DOCUMENTACION DE IMPORTACION EN CANARIAS DE NUESTRO PEDIDO: DUA IMPORTACION, FACTURA COMERCIAL Y MODELO 032. SIN DICHA DOCUMENTACION NO SE PODRA EMITIR PAGO DE LA FACTURA.

Enviar la factura a Hospiten Gestión, Avda. Marítima Nº 3, 38003 Santa Cruz de Tenerife

Re.solic.	CDS	Cé.	Centro	Pos.	I P	Material	Texto breve	Cantidad	UM	Valor total	T	Fe.entrega	GCP	Solicit.	Nº nec.	Prov.Desead	Org	Status
23	CA	44	HOSPITAL RAMBLA	20	U	ASPIRADOR QUIRURGICO	3351 NATAL	1	UN	4.550,00	3	30/06/2015	2	HOSPITAL RAMBLA	001506	HOSPITAL RAMBLA		
24	CA	44	HOSPITAL RAMBLA	20	U	PREL. CONTROL		1	UN	587,00	1	30/06/2015	2	HOSPITAL RAMBLA	001506	HOSPITAL RAMBLA		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		

M. Concha


73

5.137,00

Robo 2015 => 5.2006

800000 8396


Solicitud transmitida por

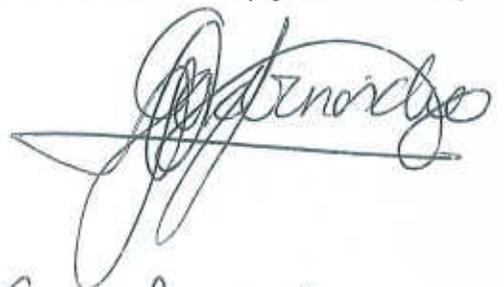

Sara Francisco

CONFORME  
DPTO. COMPRAS CENTRAL HOSPITAL

Fecha: 10/07/15  
D. José Ignacio [Signature]

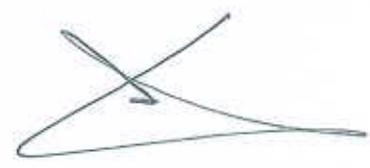

## **Jose Manuel Jorge Pérez**

---

**De:** Jose Manuel Jorge Pérez  
**Enviado el:** martes, 01 de diciembre de 2015 18:14  
**Para:** Lourdes Marrero; Inmaculada Bolaños  
**Asunto:** RV: SOLICITUD FILTRO DESECHABLE P/ASPIRADOR MOD. ATMOS S351  
**Datos adjuntos:** 425 FILTRO DESECHABLE 443.0738.0.pdf

Buenas tardes  
Adjunto correo a efectos de vuestro conocimiento e información.

Saludos Cordiales,  
José Manuel Jorge  
Responsable Fungible y Prótesis.

**De:** Jose Manuel Jorge Pérez  
**Enviado el:** martes, 01 de diciembre de 2015 18:14  
**Para:** Alicia Fernaud Alberto  
**CC:** Lorenzo Galán  
**Asunto:** RV: SOLICITUD FILTRO DESECHABLE P/ASPIRADOR MOD. ATMOS S351

Buenas tardes  
Informo que se ha procedido a la autorización y alta en la base de datos SAP "Productos hospitalarios Hospiten" al FILTRO DESECHABLE P/ASPIRADOR MOD. ATMOS S351 con referencia "Ver Detalle Fichero Adjunto" solicitada en correo adjunto.

### **FILTRO DESECHABLE P/ASPIRADOR MOD. ATMOS S351**

El Centro Hospitalario se responsabilizará que dicho material sea facturado al paciente y/o Entidad Aseguradora Pública o Privada, con especial atención a pacientes de Entidades Aseguradoras las cuales requieran consentimiento y autorización previa antes de su uso o aplicación.

Si el paciente es asegurado de Entidades quienes tienen acuerdos con proveedores, previamente la Dirección o Administración del Hospital deberá verificar las marcas y/o proveedores homologados por la Entidad.

En caso que el paciente pertenezca a Entidades Aseguradoras Públicas o Privadas con quienes tengamos "Tarifa de Prestación Cerrada", antes de dar conformidad la Dirección del Hospital deberá analizar el coste del material junto con la tarifa de prestación.

Saludos Cordiales,  
José Manuel Jorge  
Responsable Fungible y Prótesis.

**De:** Inmaculada Bolaños  
**Enviado el:** viernes, 27 de noviembre de 2015 10:28  
**Para:** Jose Manuel Jorge Pérez  
**CC:** Lourdes Marrero  
**Asunto:** RV: SOLICITUD FILTRO DESECHABLE P/ASPIRADOR MOD. ATMOS S351

Buenos días,  
Remitimos conformidad de gerencia.

Saludos,

**De:** Alicia Fernaud Alberto  
**Enviado el:** viernes, 27 de noviembre de 2015 10:27  
**Para:** Inmaculada Bolaños

**CC:** Lourdes Marrero

**Asunto:** RE: SOLICITUD FILTRO DESECHABLE P/ASPIRADOR MOD. ATMOS S351

Buenos días;

Por mi parte de acuerdo.

Un saludo,

Alicia

---

**De:** Inmaculada Bolaños

**Enviado el:** Jueves, 26 de noviembre de 2015 18:08

**Para:** 'Alicia Fernaud Alberto'

**CC:** Lourdes Marrero

**Asunto:** RV: SOLICITUD FILTRO DESECHABLE P/ASPIRADOR MOD. ATMOS S351

Alicia, te agradecería que cuando puedas revises esta solicitud puesto que la esta reclamando el servicio.

Gracias y saludos,

---

**De:** Jose Manuel Jorge Pérez

**Enviado el:** viernes, 13 de noviembre de 2015 12:42

**Para:** Lourdes Marrero; Inmaculada Bolaños

**Asunto:** RV: SOLICITUD FILTRO DESECHABLE P/ASPIRADOR MOD. ATMOS S351

Buenos días

Adjunto correo a efectos de vuestro conocimiento e información.

**Observaciones:**

Por favor, se requiere la información que se detalla en mi correo del día 10 de Noviembre, además del número de pedido y año de la compra del nuevo Aspirador compra por Inversión.

Saludos Cordiales.

José Manuel Jorge

Responsable Fungible y Prótesis.

---

**De:** Jose Manuel Jorge Pérez

**Enviado el:** viernes, 13 de noviembre de 2015 12:41

**Para:** Alicia Fernaud Alberto

**Asunto:** SOLICITUD FILTRO DESECHABLE P/ASPIRADOR MOD. ATMOS S351

Buenos días

Adjunto solicitud por parte del Servicio de Ginecología y Dr. Arriaga junto con ppto y estudio económico de lo solicitado (FILTRO DESECHABLE P/ASPIRADOR MOD. ATMOS S351) para su consideración y conformidad como responsable económico del Centro.

**Observaciones:**

Por favor, se requiere la información que se detalla en mi correo del día 10 de Noviembre, además del número de pedido y año de la compra del nuevo Aspirador compra por Inversión.

Ruego su conformidad para proceder a la autorización por parte de la Dirección de Compras.

Muchas gracias.

Saludos Cordiales.

José Manuel Jorge

Responsable Fungible y Prótesis.

---

**De:** Jose Manuel Jorge Pérez

**Enviado el:** martes, 10 de noviembre de 2015 12:58

**Para:** Lourdes Marrero; Inmaculada Bolaños

**Asunto:** RV: 425 FILTRO DESECHABLE 443.0738.0

Buenos días

En función de la solicitud que hemos recibido en el Departamento, respecto al material que se detalla en fichero adjunto (FILTRO DESECHABLE RFA 443.0738.0), necesitamos que nos hagan llegar la siguiente información que paso a detallar a continuación:

- Código Sap del material de uso actual, o bien que técnica se emplea por el material solicitado.
- En el caso de que realmente no estemos empleando nada al respecto por el material solicitado. Necesitamos que nos indiquen como estamos recibiendo el problema en el hospital cuando realmente es necesario el material solicitado.

Muchas gracias.

Saludos Cordiales.

José Manuel Jorge

Responsable Fungible y Prótesis.

---

**De:** Lourdes Marrero

**Enviado el:** martes, 03 de noviembre de 2015 9:45

**Para:** Jose Manuel Jorge Pérez; Víctor Rodríguez González

**CC:** Inmaculada Bolaños

**Asunto:** 425 FILTRO DESECHABLE 443.0738.0