

# Pack Nefrectomía Dr. Conde HOSPITEN

Ref. 97095612



## Características del Envasado:

- La caja externa de transporte es reforzada, resistente e incluye información sobre: denominación del producto, referencia comercial, código EAN, origen, número de lote y fecha de caducidad.
- La Bolsa Unitaria es plástico robusto con alta resistencia a las perforaciones, con sistema de apertura con pestaña de 15cm y Sistema de ventilación de OE (TIVEK®) en la parte superior del envase, que permite una adecuada aireación después de su esterilización.
- La Etiqueta Interna insertada en la bolsa unitaria es auto-adhesiva e incluye información sobre: denominación, composición, referencia comercial, código EAN, origen, método de esterilización, número de lote y fecha de caducidad.
- Cada etiqueta interna incluye Etiquetas Adhesivas con información sobre: código EAN, fecha de caducidad y número de lote.
- Método de esterilización: Óxido de Etileno. Único método que asegura la íntegra esterilización de dispositivos de diferentes masas y densidades.

\*Las unidades por caja son orientativas y pueden servir como referencia pero se recomienda no utilizarla como unidad de pedido, será definitiva cuando se lleve a cabo la producción tras contrato.

Componentes	Unid.
Cubremesas Estándar 150x190cm, Absorc. 75x190cm	1
Toallas de manos 47x38cm	2
Bata Quirúrgica Universal Talla L	1
Toallas de manos 47x38cm	4
Bata Quirúrgica Universal Talla XL	2
Funda Mesa Mayo 79x145cm, Abs.65x85cm	1
Bolsa Instrumental endoscópica 30x50cm, 3compart.	1
Funda de Cámara 18x250 cm, Punta Elástica	1
Solucion anti vaho con esponja	1
Contenedor de Aguja 20pcs Foam/Magnetico, amarillo	1
Compresa gasa 10x10cm 12p 17h RX 5pc	10
Compresa abd 45x45cm 17h 4p RX 5pc blanca	10
Sujetatubos velcro 2,5x30cm adhesivo	2
Apósito Post-quirúrgico 6x7cm Mepore	5
Cinta adhesiva 9x49cm	1
Bolsa de Plástico transp. 20cm, 30cm Ziplock	1
Hoja de bisturí nº11	1
Bisturí Eléctrico 320cm con botones	1
Hoja de bisturí nº20	1
Bandeja 25x14x5cm 1575ml Azul Polipropileno	1
Trocar Hasson con balón 12mm/100mm	1
Trocar óptico con balón 12mm/100mm	1
Trocar óptico con balón 5mm/100mm	3
Bolsa papel blanca 30x61x12.5cm	1
Paño envolvente 100x100cm verde	1
Tijera monopolar 5mm /33cm Metzenbaum	1
Pinza agarre fenestrada c/control cremallera 5mm/33cm	1
Toalla Secado de Campo 18x25cm blanca	4
Paño adhesivo 90x75cm reforzado	2
Sabana adhesiva 175x175cm reforzada	1
Sabana adhesiva 240x150cm reforzada	1

Unidades por caja\*: 6


Más información en [www.molnlycke.es](http://www.molnlycke.es)

Mölnlycke Health Care, Avenida de la Vega 15, Edif. 3 - 3ª Planta, Alcobendas (Madrid). Tel: 91 484 13 20  
Mölnlycke® es una marca, nombre y logotipo registrado globalmente por una o más empresas del grupo Mölnlycke Health Care. © 2017. Mölnlycke Health Care AB. Todos los derechos reservados.

  
**Mölnlycke®**



### INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

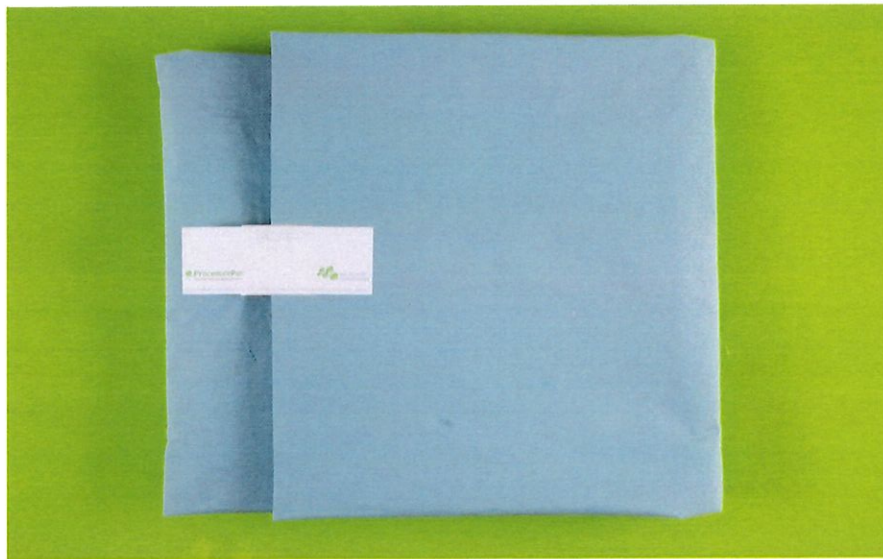

<b>REFERENCIA</b>	5200460-08
<b>DESCRIPCIÓN COMPLETA</b>	Cubremeras Estandar 150x190cm, Absorc. 75x190
<b>DESCRIPCIÓN ABREVIADA</b>	CUBREMESAS ESTANDAR 150X190CM
<b>PROVEEDOR</b>	Mölnlycke Health Care Klinipro
<b>FABRICANTE</b>	Mölnlycke Health Care
<b>Nº DE FABRICANTE</b>	5200460
<b>CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)</b>	I
<b>PESO NETO</b>	192
<b>UNIDAD DE PESO</b>	G
<b>LIBRE DE LATEX</b>	Componente libre de látex
<b>PVC</b>	NO
<b>FTALATOS</b>	NO
<b>PIROGÉNICO</b>	NO TESTADO
<b>ALUMINIUM POUCH</b>	NO
<b>POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA</b>	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	NO
<b>REPRESENTANTE AUTORIZADO</b>	
<b>ISO 13485</b>	27.11.2018
<b>ISO 9001</b>	15.9.2018





## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE



REFERENCIA	2308641-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Toallas de manos 47x38cm
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	TOALLAS DE MANOS 47x38CM
PROVEEDOR	IPS Converters Ltd.
FABRICANTE	IPS
Nº DE FABRICANTE	S003
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	I
PESO NETO	16,5
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	06.07.2017
ISO 13485	
ISO 9001	17.06.2018



## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE



REFERENCIA	63000621-01
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Bata Quirúrgica Universal Talla L
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	BATA QUIRURGICA UNIVERSAL L
PROVEEDOR	Copioumed International Inc.
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
Nº DE FABRICANTE	63000621
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	I
PESO NETO	123,107
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	DESCONOCIDO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	15.09.2018






## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE



REFERENCIA	2308641-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Toallas de manos 47x38cm
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	TOALLAS DE MANOS 47x38CM
PROVEEDOR	IPS Converters Ltd.
FABRICANTE	IPS
Nº DE FABRICANTE	S003
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	I
PESO NETO	16,5
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	06.07.2017
ISO 13485	
ISO 9001	17.06.2018



## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

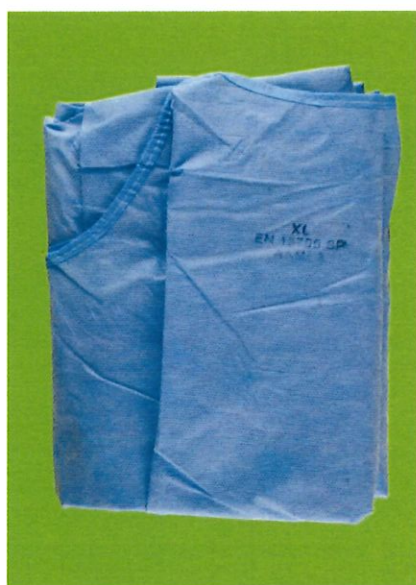

REFERENCIA	63000623-01
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Bata Quirúrgica Universal Talla XL
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	BATA QUIRURGICA UNIVERSAL XL
PROVEEDOR	Copioumed International Inc.
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
Nº DE FABRICANTE	63000623
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	I
PESO NETO	138
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	DESCONOCIDO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	15.09.2018





## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE



REFERENCIA	996106-07
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Funda Mesa Mayo 79x145cm, Abs.65x85cm
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	FUNDA MESA MAYO 79X145CM, ABS 65X85CM
PROVEEDOR	Mölnlycke Health Care S.A.
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
Nº DE FABRICANTE	996106
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	I
PESO NETO	150,5
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO TESTADO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	15.9.2018



## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE




<b>REFERENCIA</b>	815320-14
<b>DESCRIPCIÓN COMPLETA</b>	Bolsa Instrumental endoscópica 30x50cm,
<b>DESCRIPCIÓN ABREVIADA</b>	BOLSA INSTRUMENTAL 30X50CM
<b>PROVEEDOR</b>	Mölnlycke Health Care (Thailand)
<b>FABRICANTE</b>	Mölnlycke Health Care
<b>Nº DE FABRICANTE</b>	815320
<b>CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)</b>	I
<b>PESO NETO</b>	32
<b>UNIDAD DE PESO</b>	G
<b>LIBRE DE LATEX</b>	Componente libre de látex
<b>PVC</b>	NO
<b>FTALATOS</b>	NO
<b>PIROGÉNICO</b>	DESCONOCIDO
<b>ALUMINIUM POUCH</b>	NO
<b>POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA</b>	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	NO
<b>REPRESENTANTE AUTORIZADO</b>	
<b>ISO 13485</b>	27.11.2018
<b>ISO 9001</b>	15.9.2018





## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

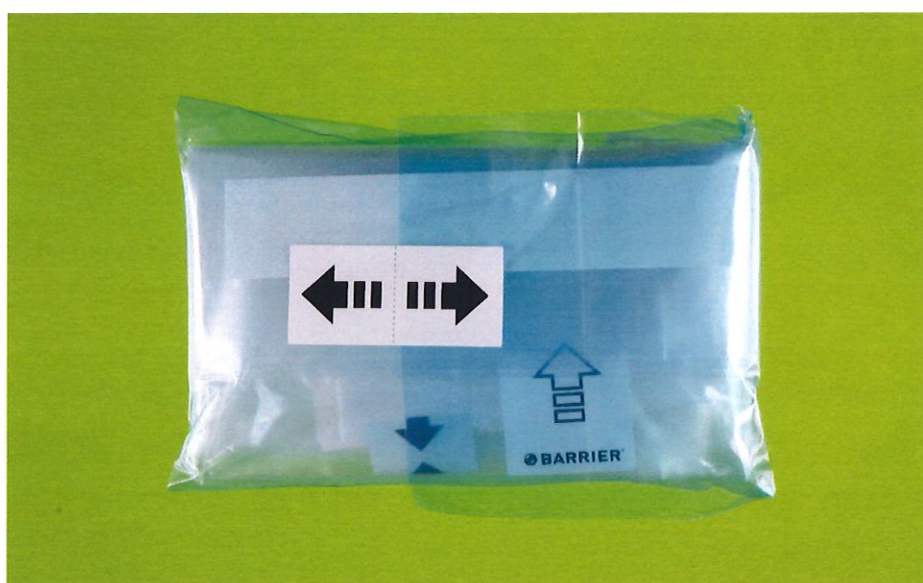

<b>REFERENCIA</b>	815333-14
<b>DESCRIPCIÓN COMPLETA</b>	Funda de Cámara 18x250 cm, Punta Elástico
<b>DESCRIPCIÓN ABREVIADA</b>	FUNDA DE CÁMARA 18X250 CM, PUNTA ELÁSTIC
<b>PROVEEDOR</b>	Mölnlycke Health Care (Thailand)
<b>FABRICANTE</b>	Mölnlycke Health Care
<b>Nº DE FABRICANTE</b>	815333
<b>CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)</b>	I
<b>PESO NETO</b>	46,5
<b>UNIDAD DE PESO</b>	G
<b>LIBRE DE LÁTEX</b>	Componente libre de látex
<b>PVC</b>	NO
<b>FTALATOS</b>	NO
<b>PIROGÉNICO</b>	DESCONOCIDO
<b>ALUMINIUM POUCH</b>	NO
<b>POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA</b>	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	NO
<b>REPRESENTANTE AUTORIZADO</b>	
<b>ISO 13485</b>	27.11.2018
<b>ISO 9001</b>	15.9.2018

## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE




<b>REFERENCIA</b>	2315127-00
<b>DESCRIPCIÓN COMPLETA</b>	Solucion anti vaho con esponja
<b>DESCRIPCIÓN ABREVIADA</b>	SOLUCION ANTI VAHO
<b>PROVEEDOR</b>	Aspen Medical Europe Limited
<b>FABRICANTE</b>	Aspen Surgical Products
<b>Nº DE FABRICANTE</b>	DF-3100B
<b>CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)</b>	Ila
<b>PESO NETO</b>	14,6
<b>UNIDAD DE PESO</b>	G
<b>LIBRE DE LATEX</b>	Componente libre de látex
<b>PVC</b>	NO
<b>FTALATOS</b>	NO
<b>PIROGÉNICO</b>	NO TESTADO
<b>ALUMINIUM POUCH</b>	NO
<b>POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA</b>	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	NO
<b>REPRESENTANTE AUTORIZADO</b>	ASPEN MEDICAL EUROPE
<b>ISO 13485</b>	10.06.2018
<b>ISO 9001</b>	






## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

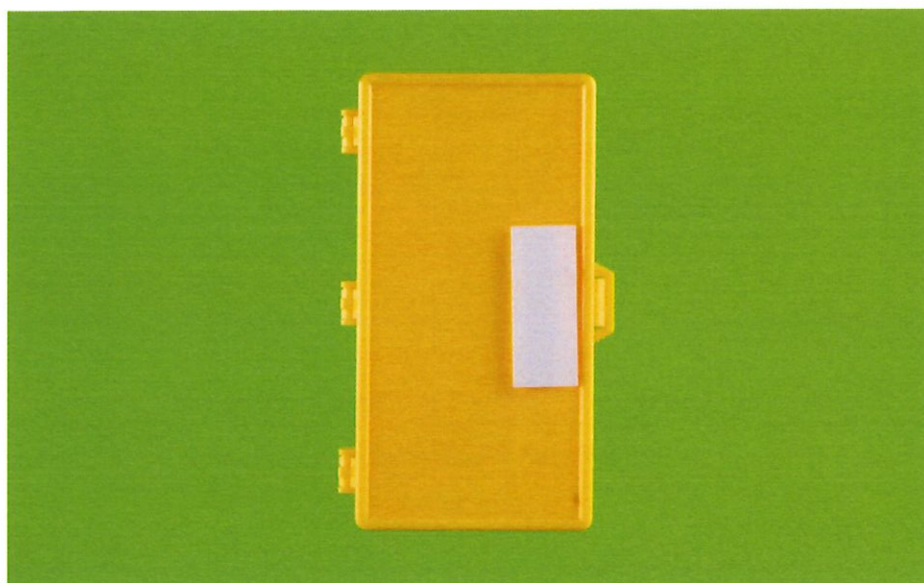

REFERENCIA	2319520-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Contenedor de Agujas 20pcs Foam/Magnetic
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	CONTENEDOR AGUJAS 20PCS FOAM/MAGNET
PROVEEDOR	GRI-Alleset Limited B.V.
FABRICANTE	GRI Medical & Electronic Techn
Nº DE FABRICANTE	33-02005Y
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	I
PESO NETO	50,4
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO TESTADO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	GRI-ALLESET LTD BV
ISO 13485	31.08.2020
ISO 9001	



## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

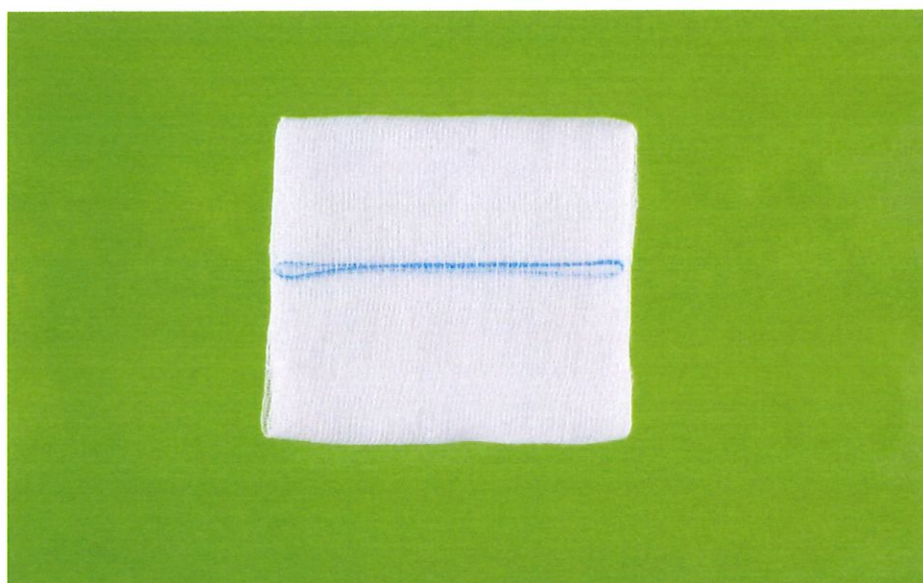

<b>REFERENCIA</b>	2312972-00
<b>DESCRIPCIÓN COMPLETA</b>	Compresa gasa 10x10cm 12p 17h RX 5pc
<b>DESCRIPCIÓN ABREVIADA</b>	COMPRESA 10X10CM 17H 12P XRD
<b>PROVEEDOR</b>	WINNER MEDICAL Co., Ltd. (CY)
<b>FABRICANTE</b>	Winner
<b>Nº DE FABRICANTE</b>	601-010494
<b>CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)</b>	Ila
<b>PESO NETO</b>	3
<b>UNIDAD DE PESO</b>	G
<b>LIBRE DE LATEX</b>	Componente libre de látex
<b>PVC</b>	NO
<b>FTALATOS</b>	NO
<b>PIROGÉNICO</b>	NO
<b>ALUMINIUM POUCH</b>	NO
<b>POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA</b>	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	NO
<b>REPRESENTANTE AUTORIZADO</b>	25.07.2017
<b>ISO 13485</b>	31.05.2020
<b>ISO 9001</b>	



## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE




REFERENCIA	2313039-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Compresa abd 45x45cm 17h 4p RX 5pc blanc
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	COMPRESA ABD 45X45CM 17H 4P RX
PROVEEDOR	WINNER MEDICAL Co., Ltd.
FABRICANTE	Winner
Nº DE FABRICANTE	601-010479
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	Ila
PESO NETO	19,4
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	25.07.2017
ISO 13485	31.05.2020
ISO 9001	





## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

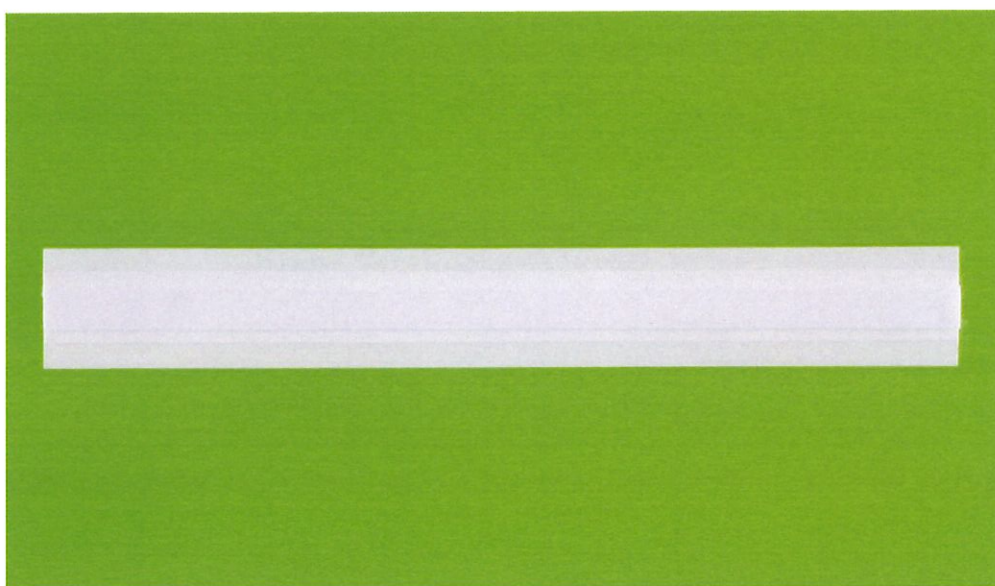

REFERENCIA	24098-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Sujetatubos velcro 2,5x30cm adhesivo
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	SUJETATUBOS VELCRO 2,5X30CM
PROVEEDOR	VELCRO EUROPE, S.A.
FABRICANTE	Velcro
Nº DE FABRICANTE	EE8000047010300
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	NON MEDICAL DEVICE
PESO NETO	4,3
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	DESCONOCIDO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	01.07.2018
ISO 9001	



## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE



REFERENCIA	670800-16
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Apósito Post-quirúrgico 6x7cm Mepore
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	APÓSITO POST-QUIR. 6X7CM MEPORE
PROVEEDOR	Mölnlycke Health Care AB
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
Nº DE FABRICANTE	670800
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	Ila
PESO NETO	0,75
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	15.9.2018

**INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE**



<b>REFERENCIA</b>	911500-00
<b>DESCRIPCIÓN COMPLETA</b>	Cinta adhesiva 9x49cm
<b>DESCRIPCIÓN ABREVIADA</b>	CINTA ADHESIVA 9X49CM
<b>PROVEEDOR</b>	Mölnlycke Health Care Klinipro
<b>FABRICANTE</b>	Mölnlycke Health Care
<b>Nº DE FABRICANTE</b>	381035, 381045
<b>CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)</b>	I
<b>PESO NETO</b>	7,833
<b>UNIDAD DE PESO</b>	G
<b>LIBRE DE LATEX</b>	Componente libre de látex
<b>PVC</b>	NO
<b>FTALATOS</b>	NO
<b>PIROGÉNICO</b>	NO TESTADO
<b>ALUMINIUM POUCH</b>	NO
<b>POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA</b>	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	NO
<b>REPRESENTANTE AUTORIZADO</b>	
<b>ISO 13485</b>	27.11.2018
<b>ISO 9001</b>	15.9.2018




## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE



REFERENCIA	2300929-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Bolsa de Plástico transp. 20cm, 30cm Zip
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	BOLSA PLÁSTICO 20X30CM C/CIERRE ZIP
PROVEEDOR	TART, s.r.o.
FABRICANTE	TART, s.r.o.
Nº DE FABRICANTE	SÁČEK SE ZIPLOCKEM 20 X 30 CM
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	NON MEDICAL DEVICE
PESO NETO	1,1
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	DESCONOCIDO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	
ISO 9001	20.03.2020



## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

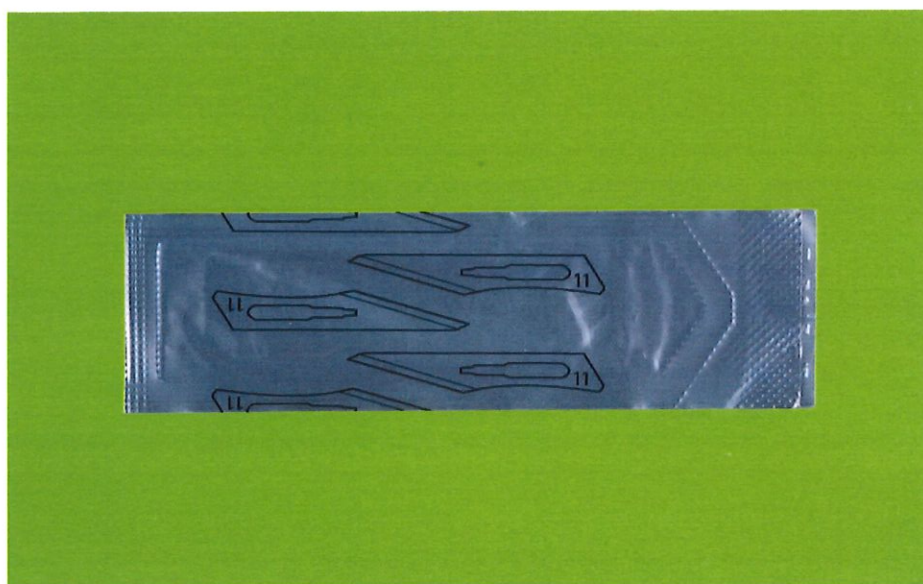

<b>REFERENCIA</b>	2301795-00
<b>DESCRIPCIÓN COMPLETA</b>	Hoja de bisturí nº11
<b>DESCRIPCIÓN ABREVIADA</b>	HOJA DE BISTURÍ N°11
<b>PROVEEDOR</b>	B. Braun Medical, s.ro.
<b>FABRICANTE</b>	Aesculap
<b>Nº DE FABRICANTE</b>	BB511
<b>CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)</b>	Ila
<b>PESO NETO</b>	1,1
<b>UNIDAD DE PESO</b>	G
<b>LIBRE DE LATEX</b>	Componente libre de látex
<b>PVC</b>	NO
<b>FTALATOS</b>	NO
<b>PIROGÉNICO</b>	NO TESTADO
<b>ALUMINIUM POUCH</b>	NO
<b>POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA</b>	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	NO
<b>REPRESENTANTE AUTORIZADO</b>	
<b>ISO 13485</b>	31.05.2020
<b>ISO 9001</b>	31.05.2017



## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE




<b>REFERENCIA</b>	2300039-00
<b>DESCRIPCIÓN COMPLETA</b>	Hoja de bisturí n°20
<b>DESCRIPCIÓN ABREVIADA</b>	HOJA DE BISTURÍ N°20
<b>PROVEEDOR</b>	SWANN MORTON LTD
<b>FABRICANTE</b>	Swann Morton LTD
<b>N° DE FABRICANTE</b>	206
<b>CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)</b>	Ila
<b>PESO NETO</b>	1,5
<b>UNIDAD DE PESO</b>	G
<b>LIBRE DE LATEX</b>	Componente libre de látex
<b>PVC</b>	NO
<b>FTALATOS</b>	NO
<b>PIROGÉNICO</b>	NO TESTADO
<b>ALUMINIUM POUCH</b>	NO
<b>POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA</b>	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	NO
<b>REPRESENTANTE AUTORIZADO</b>	20.09.2017
<b>ISO 13485</b>	28.02.2019
<b>ISO 9001</b>	






## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

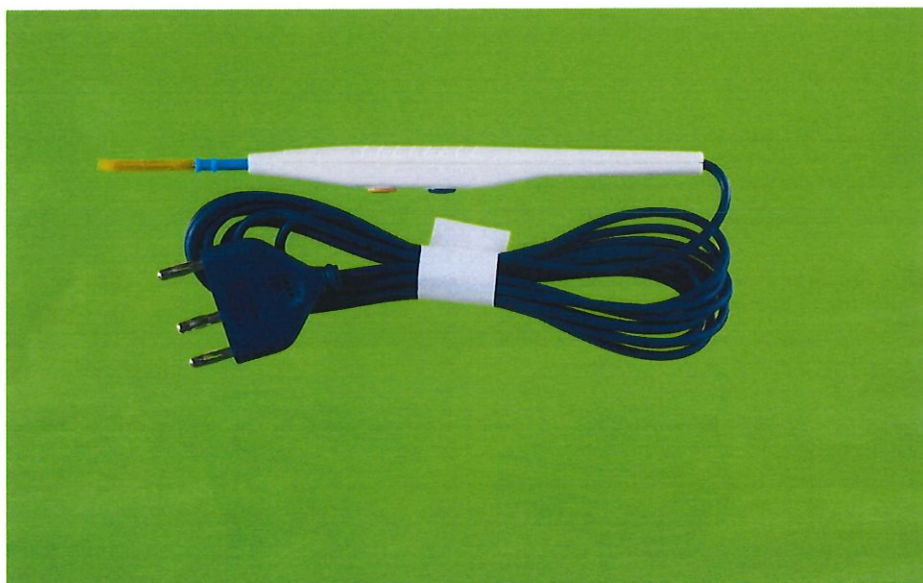

REFERENCIA	2302324-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Bisturí Eléctrico 320cm con botones
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	BISTURÍ ELÉCTRICO 320CM PUNTA PLANA
PROVEEDOR	FIAB SpA
FABRICANTE	Fiab SPA
Nº DE FABRICANTE	F4798B/BULK
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	IIb
PESO NETO	66,8
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	SI
FTALATOS	SI
PIROGÉNICO	NO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	SI
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	31.07.2018
ISO 9001	



## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

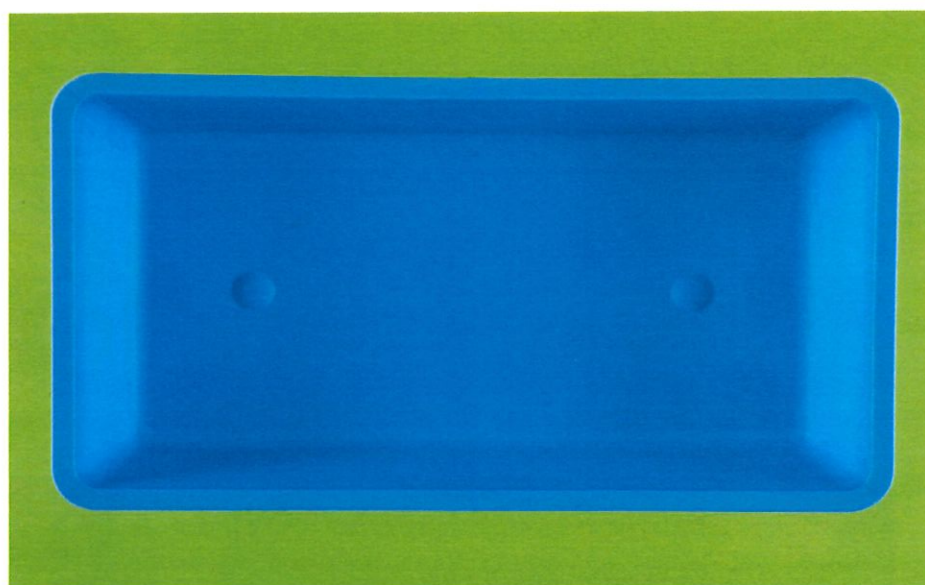

<b>REFERENCIA</b>	2314175-00
<b>DESCRIPCIÓN COMPLETA</b>	Bandeja 25x14x5cm 1575ml Azul Polipropil
<b>DESCRIPCIÓN ABREVIADA</b>	BANDEJA 25X14X5CM 1575ML AZUL POLIPROPIL
<b>PROVEEDOR</b>	GRI-Alleset Limited B.V.
<b>FABRICANTE</b>	GRI Medical & Electronic Techn
<b>Nº DE FABRICANTE</b>	15-0952
<b>CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)</b>	I
<b>PESO NETO</b>	34,9
<b>UNIDAD DE PESO</b>	G
<b>LIBRE DE LATEX</b>	Componente libre de látex
<b>PVC</b>	NO
<b>FTALATOS</b>	NO
<b>PIROGÉNICO</b>	NO TESTADO
<b>ALUMINIUM POUCH</b>	NO
<b>POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA</b>	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	NO
<b>REPRESENTANTE AUTORIZADO</b>	ALLESET HEALTHCARE SOLUTIONS
<b>ISO 13485</b>	31.08.2020
<b>ISO 9001</b>	



## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE



REFERENCIA	2321466-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Trocar Hasson con balón 12mm/100mm
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	TROCAR HASSON CON BALÓN 12MM/100MM
PROVEEDOR	Unimax Medical System Inc.
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
Nº DE FABRICANTE	1BT71210Z
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	Ila
PESO NETO	111,3
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	SI
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	SI
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	SI
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	15.09.2018



## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE



REFERENCIA	2321500-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Trocar óptico con balón 12mm/100mm
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	TROCAR ÓPTICO CON BALÓN 12MM/100MM
PROVEEDOR	Unimax Medical System Inc.
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
Nº DE FABRICANTE	1BT81210Z
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	Ila
PESO NETO	97,2
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	SI
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	SI
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	SI
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	15.09.2018




## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE



REFERENCIA	2321542-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Trocar óptico con balón 5mm/100mm
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	TROCAR ÓPTICO CON BALÓN 5MM/100MM
PROVEEDOR	Unimax Medical System Inc.
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
Nº DE FABRICANTE	1BT10510Z
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	Ila
PESO NETO	48,6
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	SI
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	SI
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	SI
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	15.09.2018

### INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

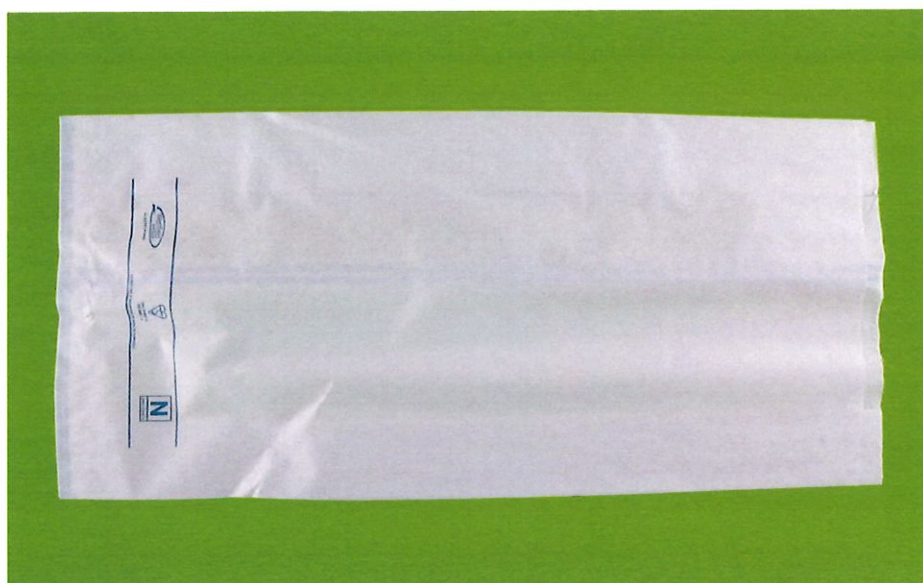


<b>REFERENCIA</b>	2305516-00
<b>DESCRIPCIÓN COMPLETA</b>	Bolsa papel blanca 30x61x12.5cm
<b>DESCRIPCIÓN ABREVIADA</b>	BOLSA PAPEL BLANCA 30X61X12.5CM
<b>PROVEEDOR</b>	Westfield Medical Ltd
<b>FABRICANTE</b>	Westfield Medical Ltd
<b>Nº DE FABRICANTE</b>	NPC
<b>CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)</b>	I
<b>PESO NETO</b>	32,3
<b>UNIDAD DE PESO</b>	G
<b>LIBRE DE LATEX</b>	Componente libre de látex
<b>PVC</b>	NO
<b>FTALATOS</b>	NO
<b>PIROGÉNICO</b>	NO
<b>ALUMINIUM POUCH</b>	NO
<b>POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA</b>	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	NO
<b>REPRESENTANTE AUTORIZADO</b>	20.11.2017
<b>ISO 13485</b>	13.01.2019
<b>ISO 9001</b>	20.07.2018






## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

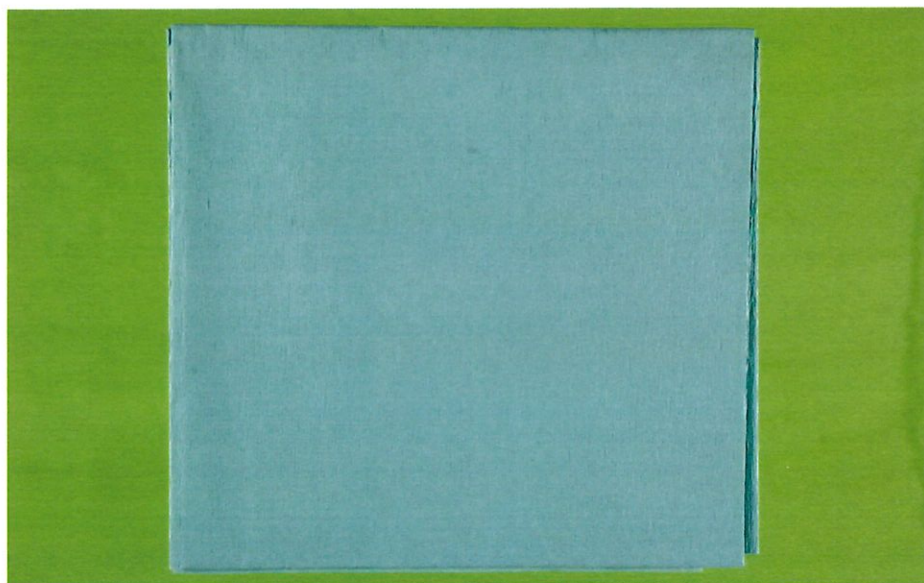

<b>REFERENCIA</b>	2313944-00
<b>DESCRIPCIÓN COMPLETA</b>	Paño envolvente 100x100cm verde
<b>DESCRIPCIÓN ABREVIADA</b>	PAÑO ENVOLVENTE 100X100CM VERDE
<b>PROVEEDOR</b>	Westfield Medical Ltd
<b>FABRICANTE</b>	Westfield Medical Ltd
<b>Nº DE FABRICANTE</b>	SDG1010
<b>CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)</b>	I
<b>PESO NETO</b>	57,8
<b>UNIDAD DE PESO</b>	G
<b>LIBRE DE LATEX</b>	Componente libre de látex
<b>PVC</b>	NO
<b>FTALATOS</b>	NO
<b>PIROGÉNICO</b>	NO
<b>ALUMINIUM POUCH</b>	NO
<b>POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA</b>	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	NO
<b>REPRESENTANTE AUTORIZADO</b>	20.11.2017
<b>ISO 13485</b>	13.01.2019
<b>ISO 9001</b>	20.07.2018




## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

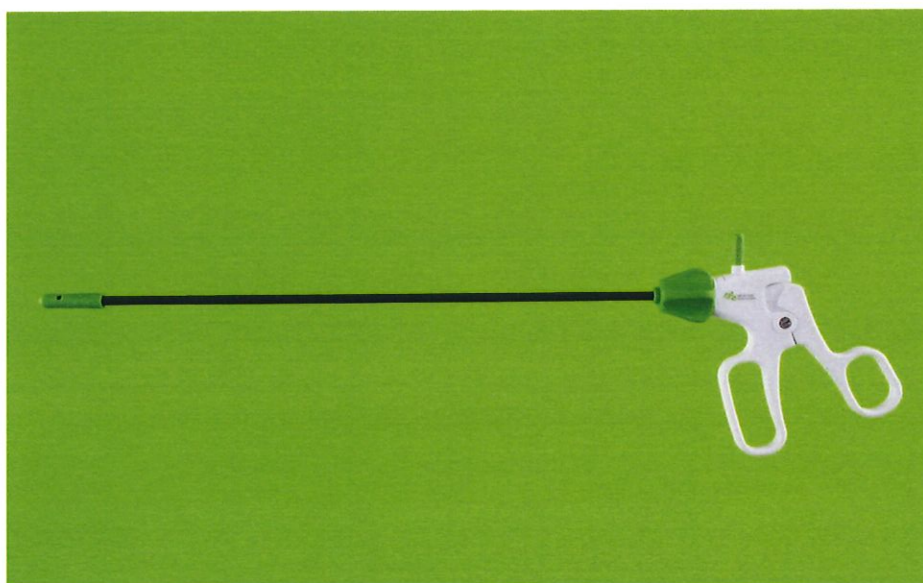

REFERENCIA	2319456-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Tijera monopolar 5mm /33cm Metzenbaum
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	TIJERA MONOPOLAR 5MM/33CM METZENBAUM
PROVEEDOR	Unimax Medical System Inc.
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
Nº DE FABRICANTE	899216(1MS53305Z)
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	IIb
PESO NETO	89,5
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO TESTADO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	SI
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	



## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE

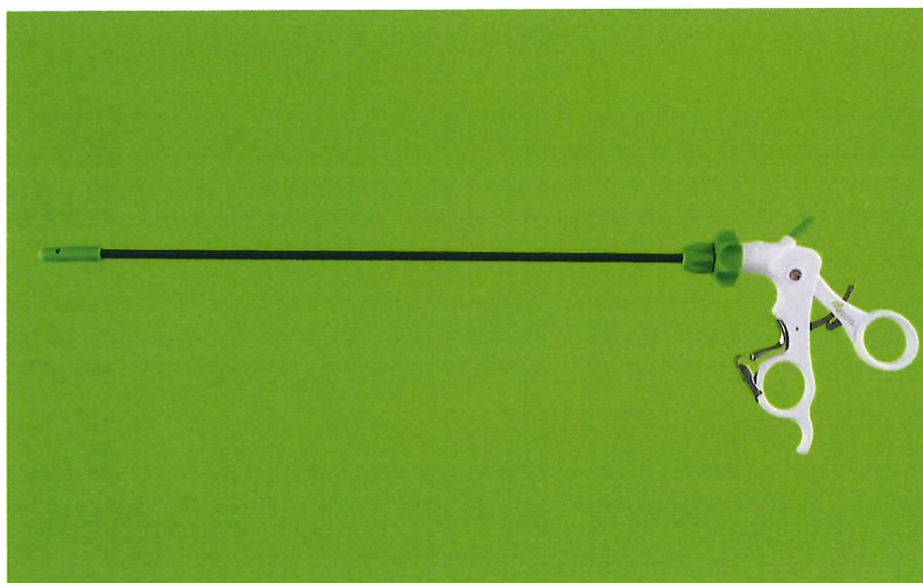

REFERENCIA	2319500-00
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Pinza agarre fenestrada c/control cremallera 5mm/33cm
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	PINZA AGARRE FENEST. CONTROL 5MM/33CM
PROVEEDOR	Unimax Medical System Inc.
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
Nº DE FABRICANTE	899215(1EJ73305Y)
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	IIb
PESO NETO	92,6
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO TESTADO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	SI
REPRESENTANTE AUTORIZADO	
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	





## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE



REFERENCIA	26153-20
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Toalla Secado de Campo 18x25cm blanca
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	TOALLA SECADO DE CAMPO 18X25CM BLANCA
PROVEEDOR	Finess Hygiene AB
FABRICANTE	Finess Hygiene
Nº DE FABRICANTE	71359
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	I
PESO NETO	5,4
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	DESCONOCIDO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	22.08.2017
ISO 13485	07.08.2017
ISO 9001	31.12.2017



## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE



REFERENCIA	910200-07
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Paño adhesivo 90x75cm reforzado
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	PAÑO ADHESIVO 90X75CM REFORZADO
PROVEEDOR	Mölnlycke Health Care S.A.
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
Nº DE FABRICANTE	706800
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	I
PESO NETO	57,613
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO TESTADO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	16.11.2017
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	15.9.2018



## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE



REFERENCIA	967772-07
DESCRIPCIÓN COMPLETA	Sabana adhesiva 175x175cm reforzada
DESCRIPCIÓN ABREVIADA	SABANA ADHESIVA 175X175CM REFORZ
PROVEEDOR	Mölnlycke Health Care S.A.
FABRICANTE	Mölnlycke Health Care
Nº DE FABRICANTE	967772
CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)	I
PESO NETO	225,417
UNIDAD DE PESO	G
LIBRE DE LATEX	Componente libre de látex
PVC	NO
FTALATOS	NO
PIROGÉNICO	NO TESTADO
ALUMINIUM POUCH	NO
POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA	
INSTRUCCIONES DE USO	NO
REPRESENTANTE AUTORIZADO	16.11.2017
ISO 13485	27.11.2018
ISO 9001	15.9.2018





## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE



<b>REFERENCIA</b>	967773-07
<b>DESCRIPCIÓN COMPLETA</b>	Sabana adhesiva 240x150cm reforzada
<b>DESCRIPCIÓN ABREVIADA</b>	SABANA ADHESIVA 240X150CM REFORZ
<b>PROVEEDOR</b>	Mölnlycke Health Care S.A.
<b>FABRICANTE</b>	Mölnlycke Health Care
<b>Nº DE FABRICANTE</b>	967773
<b>CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES (MDD)</b>	I
<b>PESO NETO</b>	268,958
<b>UNIDAD DE PESO</b>	G
<b>LIBRE DE LATEX</b>	Componente libre de látex
<b>PVC</b>	NO
<b>FTALATOS</b>	NO
<b>PIROGÉNICO</b>	NO TESTADO
<b>ALUMINIUM POUCH</b>	NO
<b>POSIBILIDAD BOLSA EXTERNA</b>	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	NO
<b>REPRESENTANTE AUTORIZADO</b>	16.11.2017
<b>ISO 13485</b>	27.11.2018
<b>ISO 9001</b>	15.9.2018